

FIG. 1

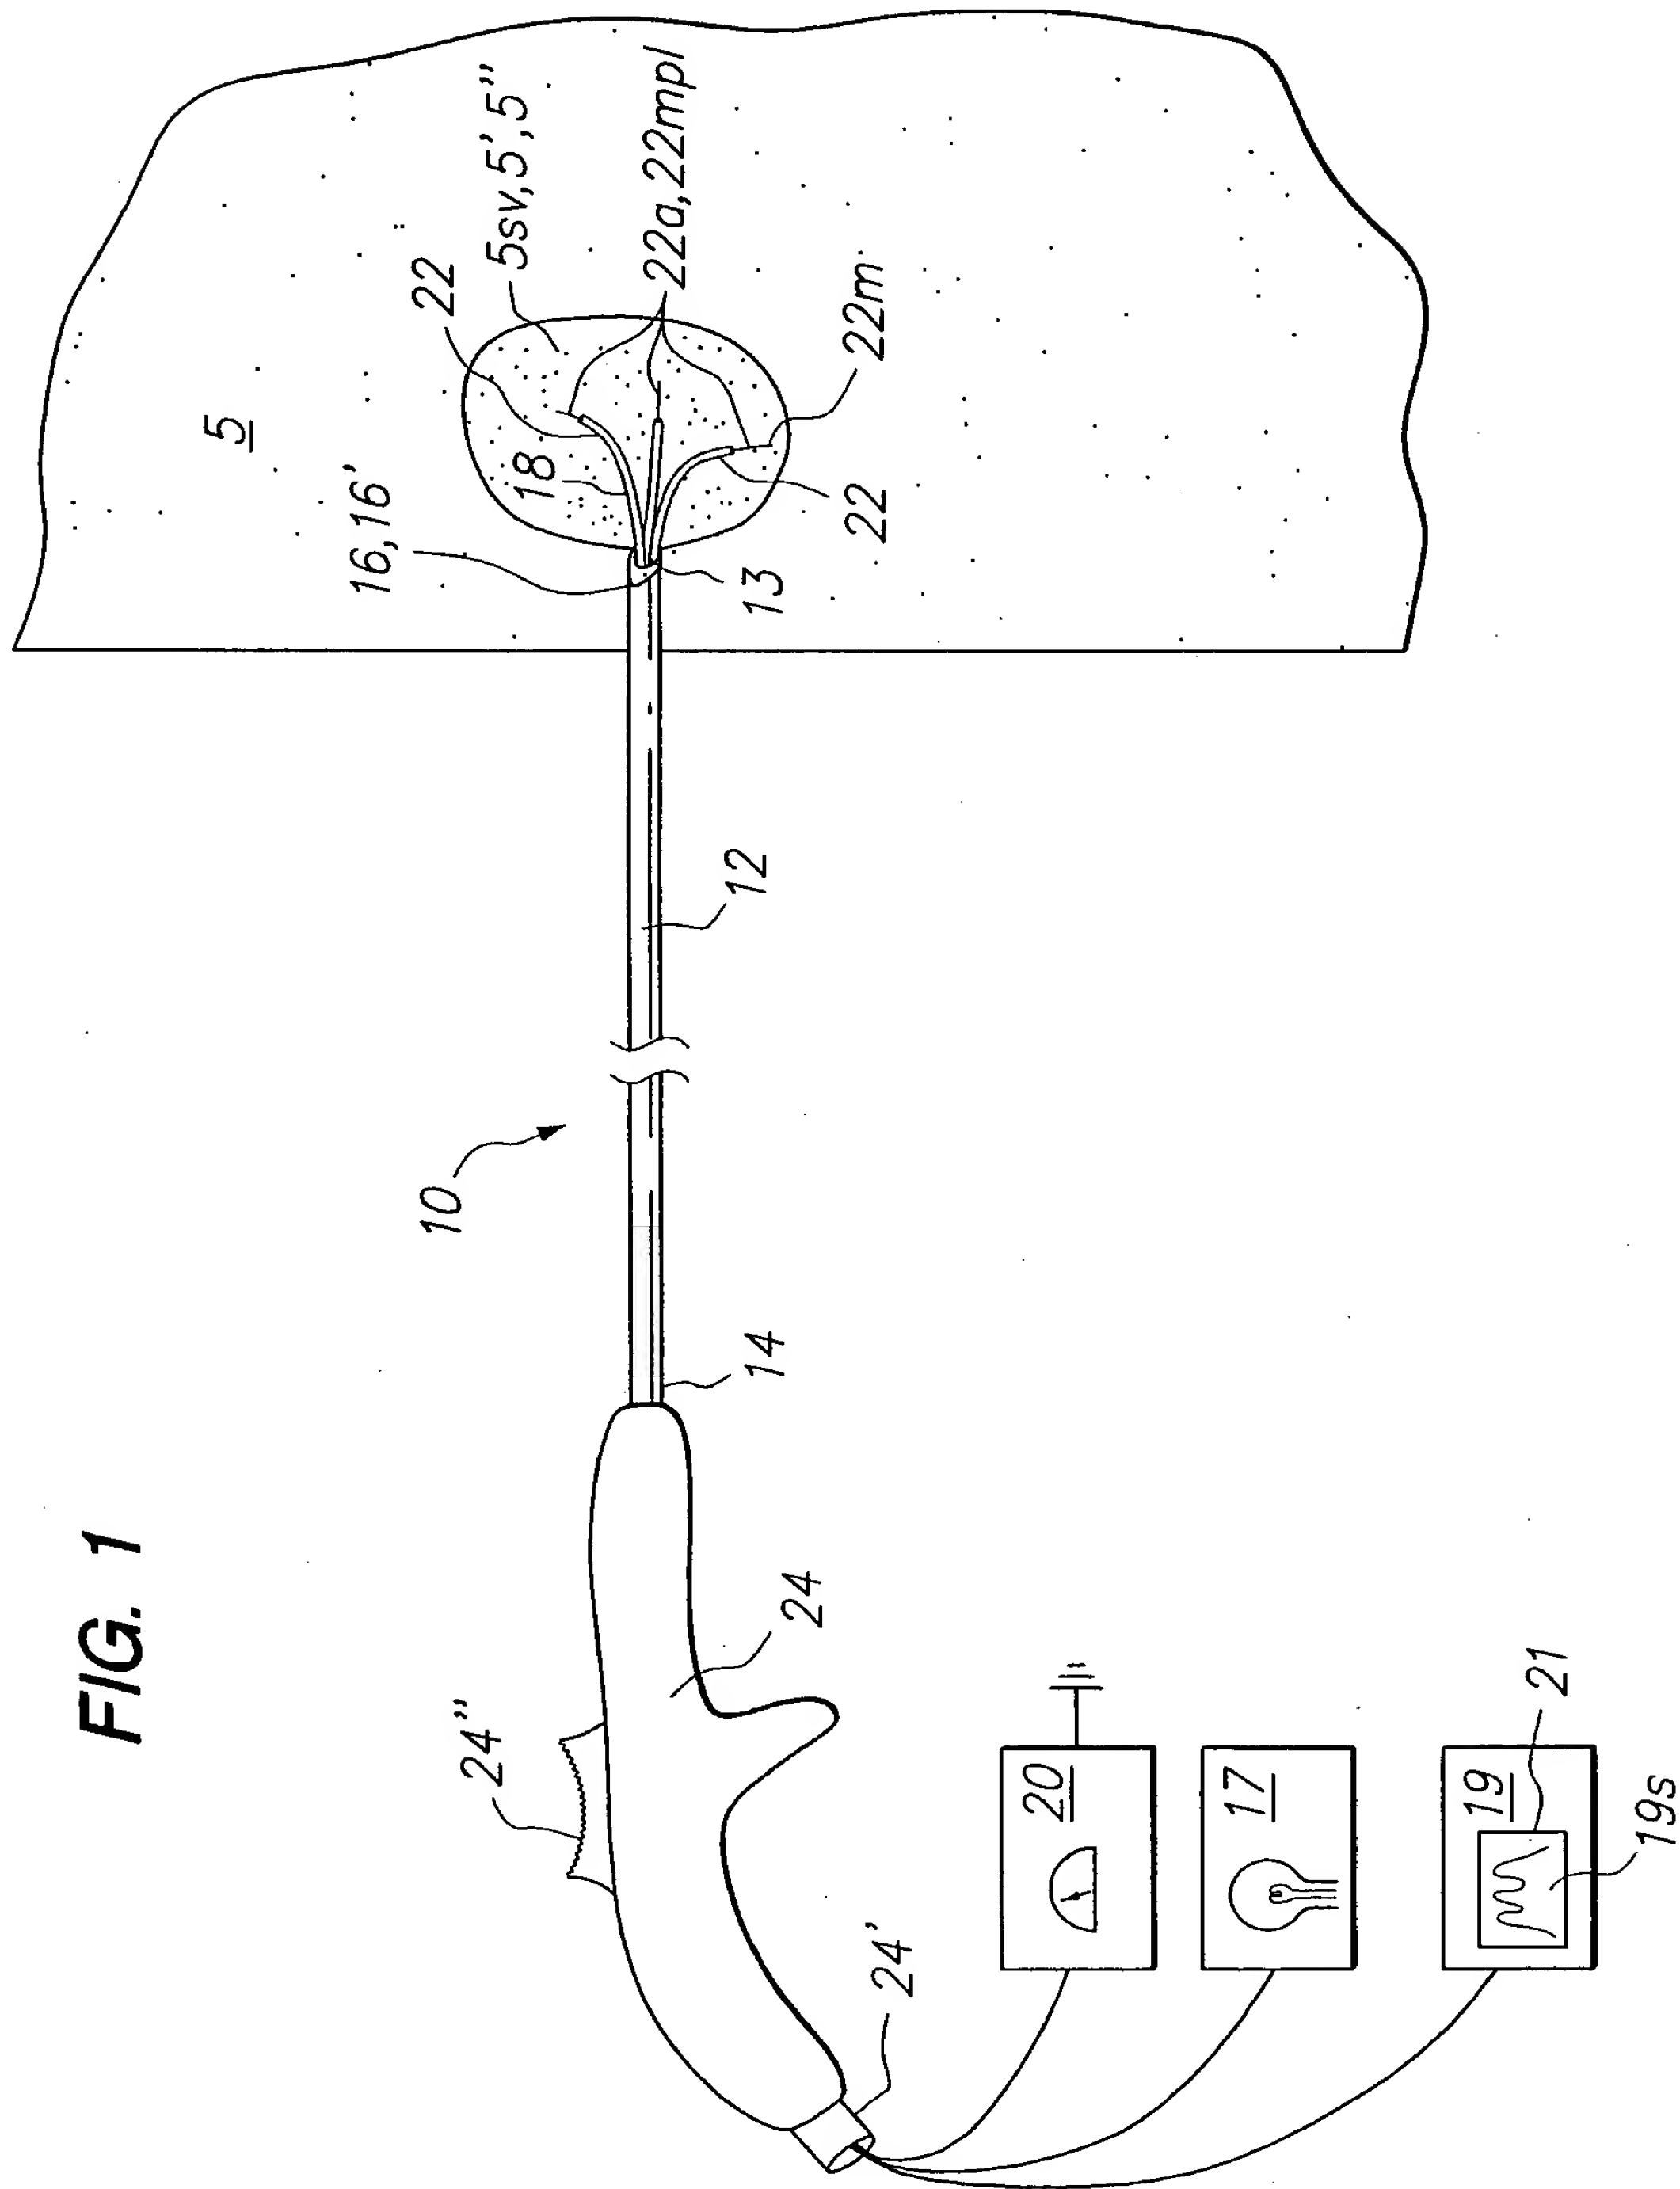


FIG. 3A

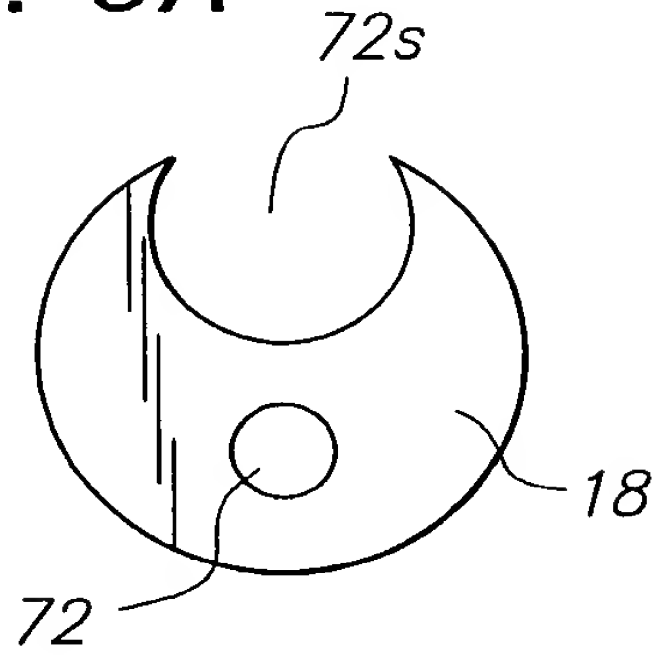


FIG. 3B

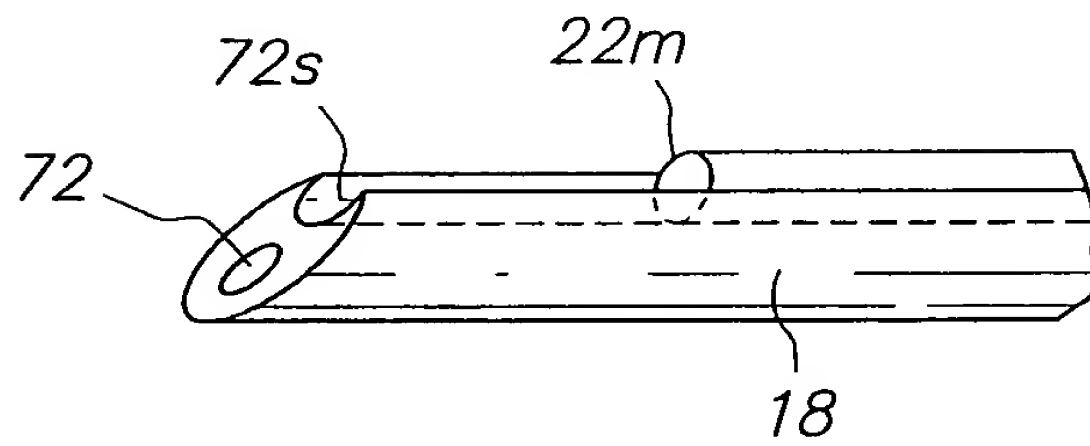


FIG. 3C

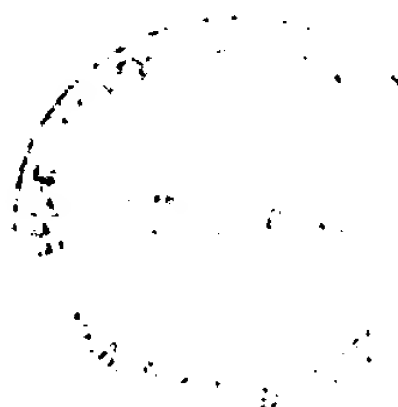
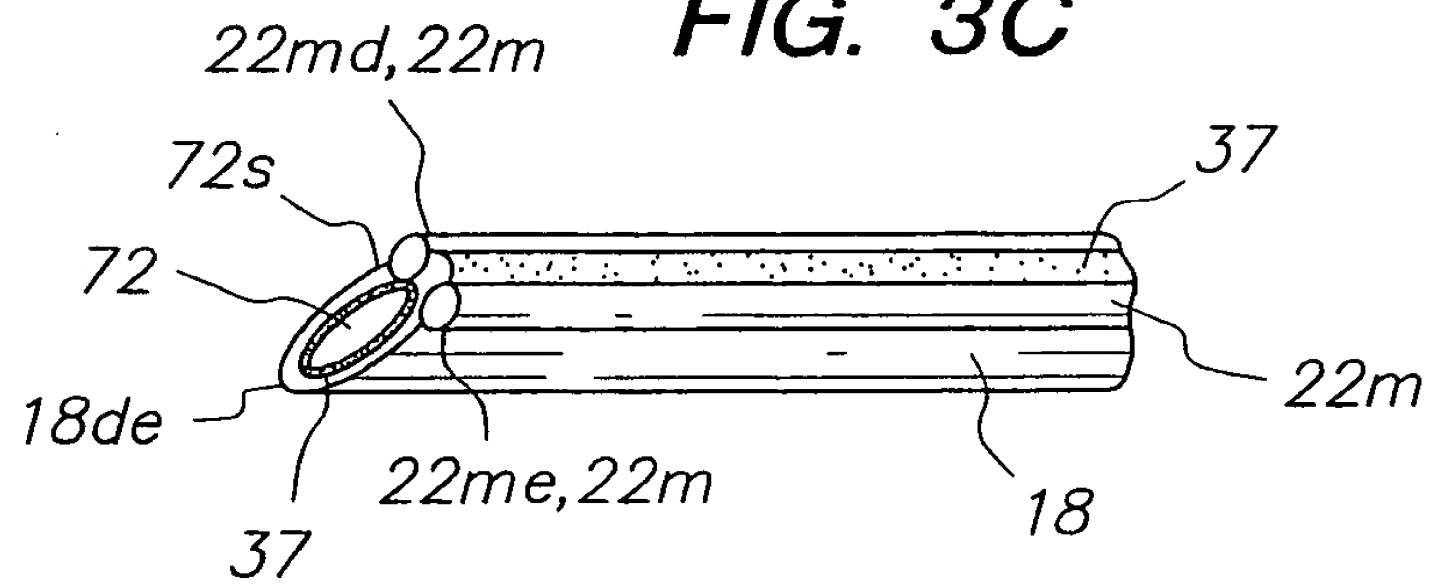


FIG. 4

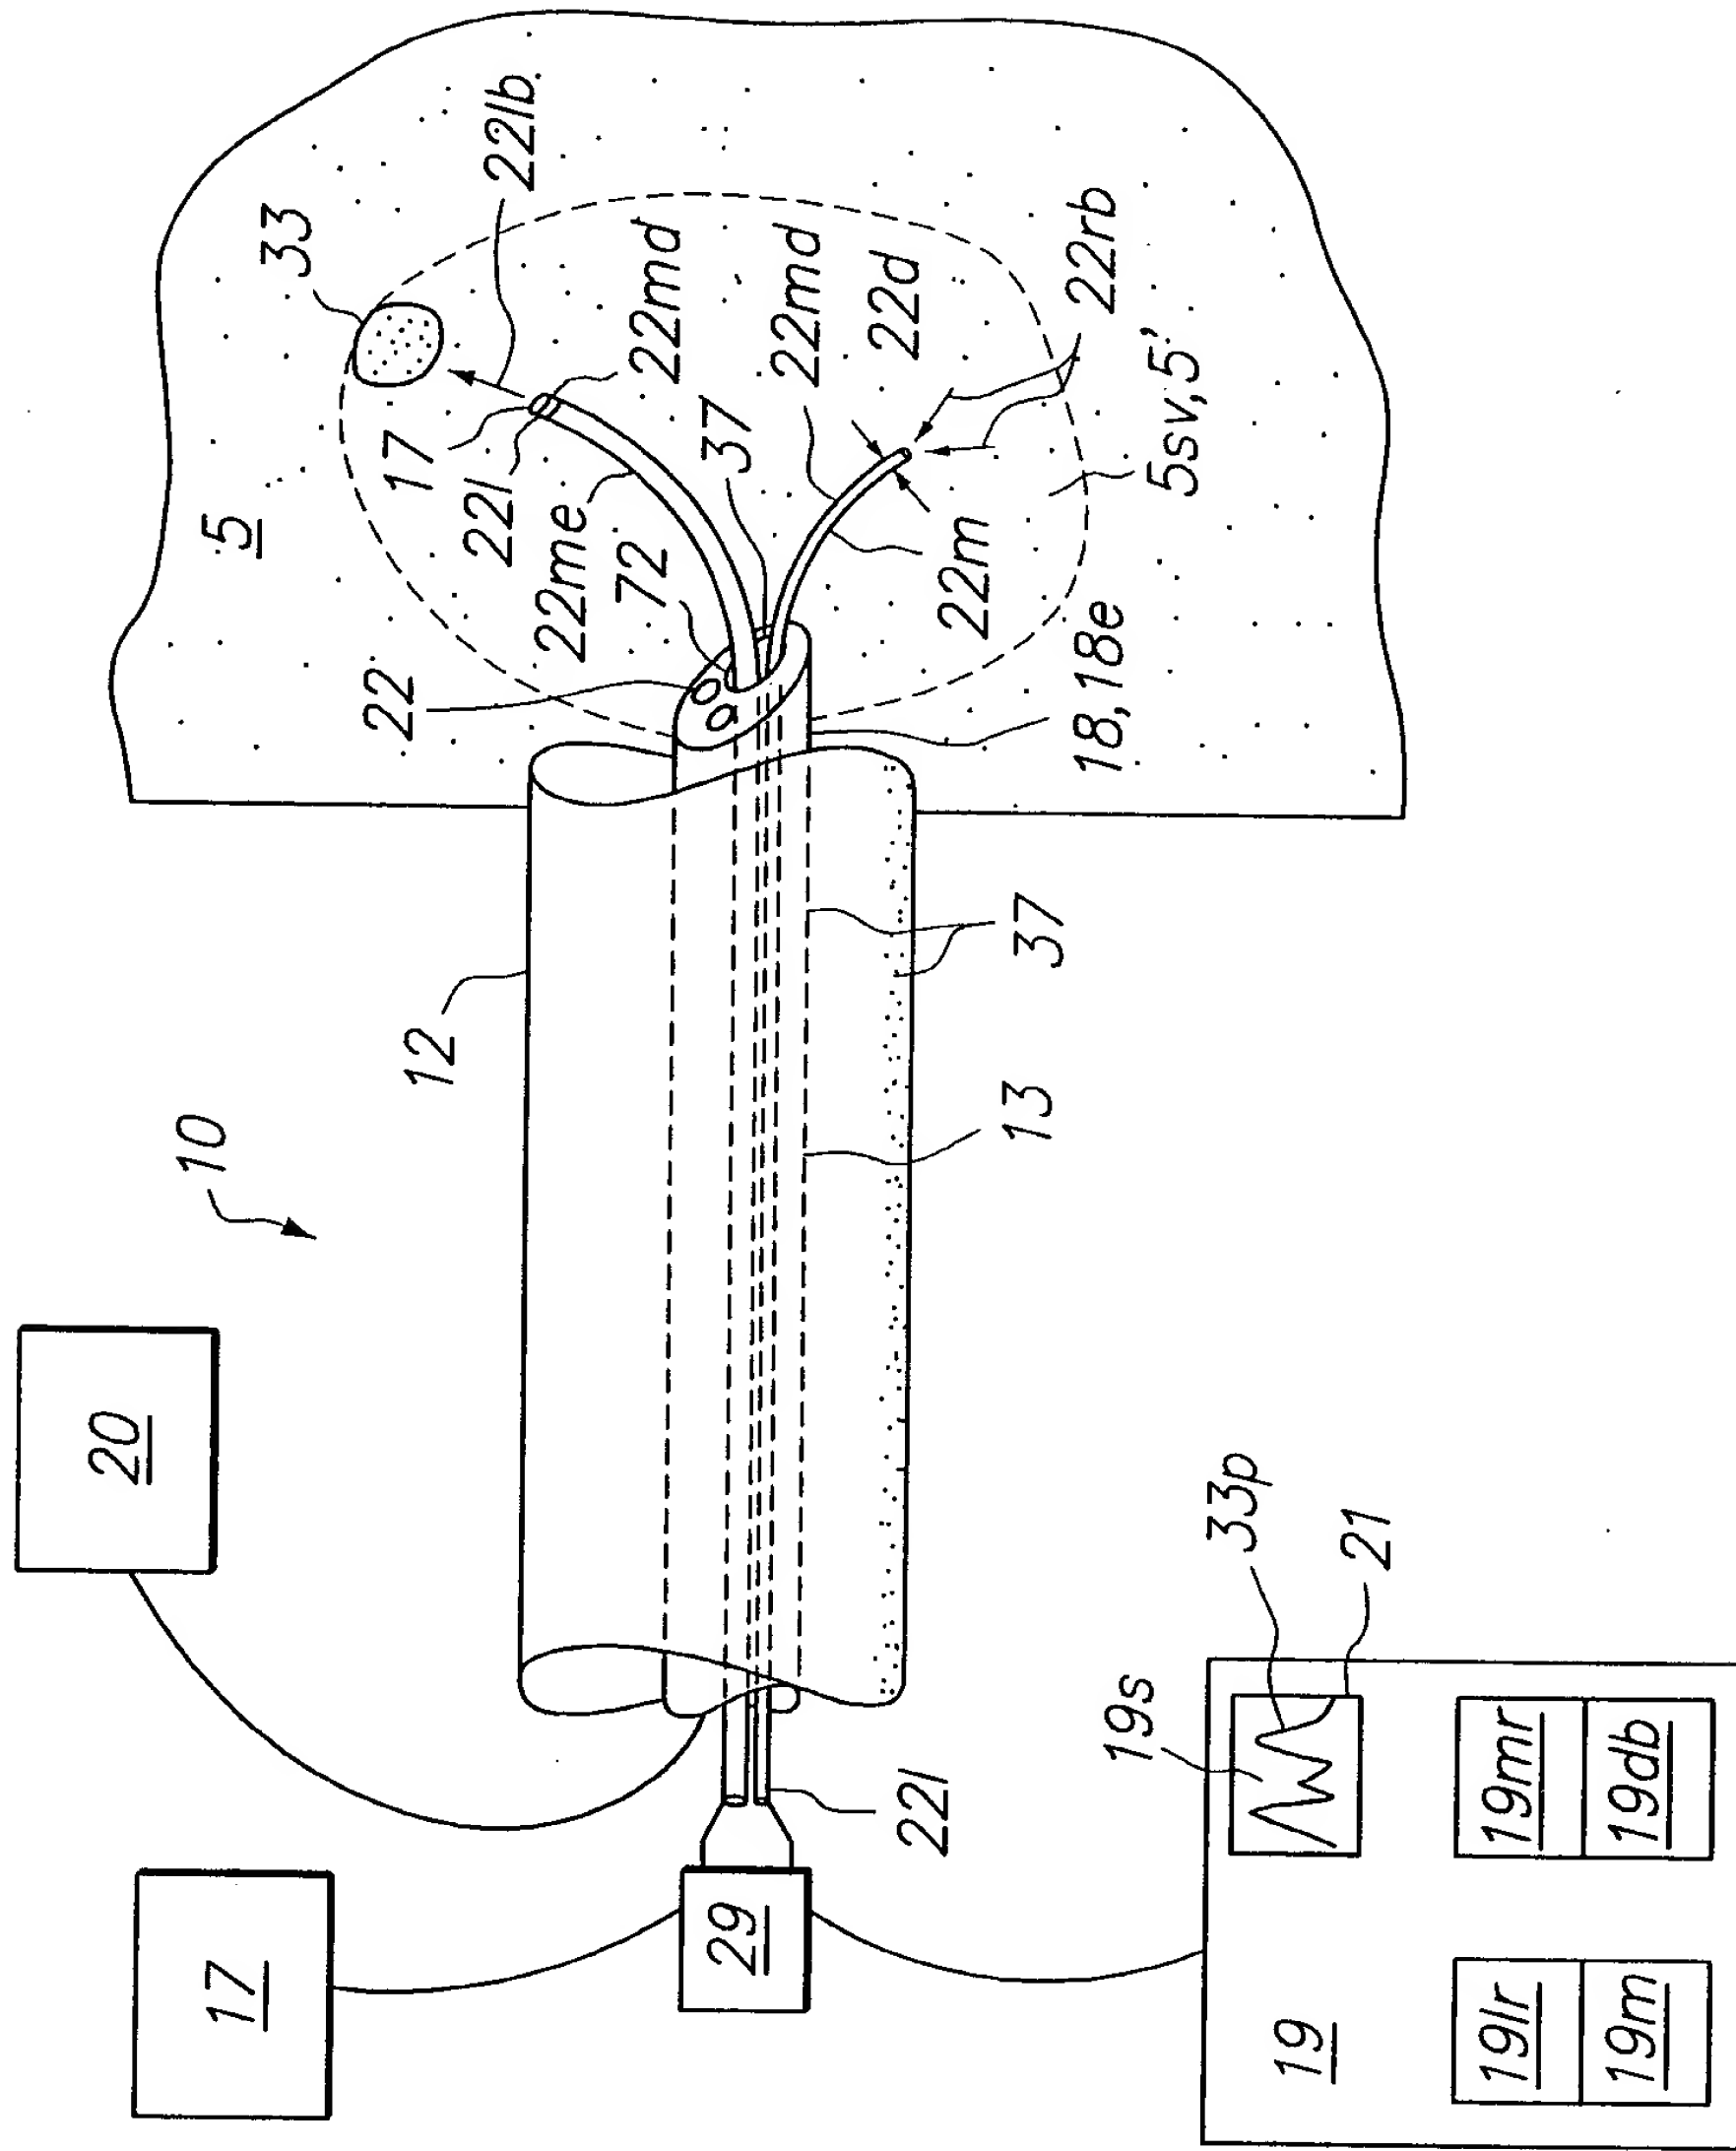


FIG. 5 5/23

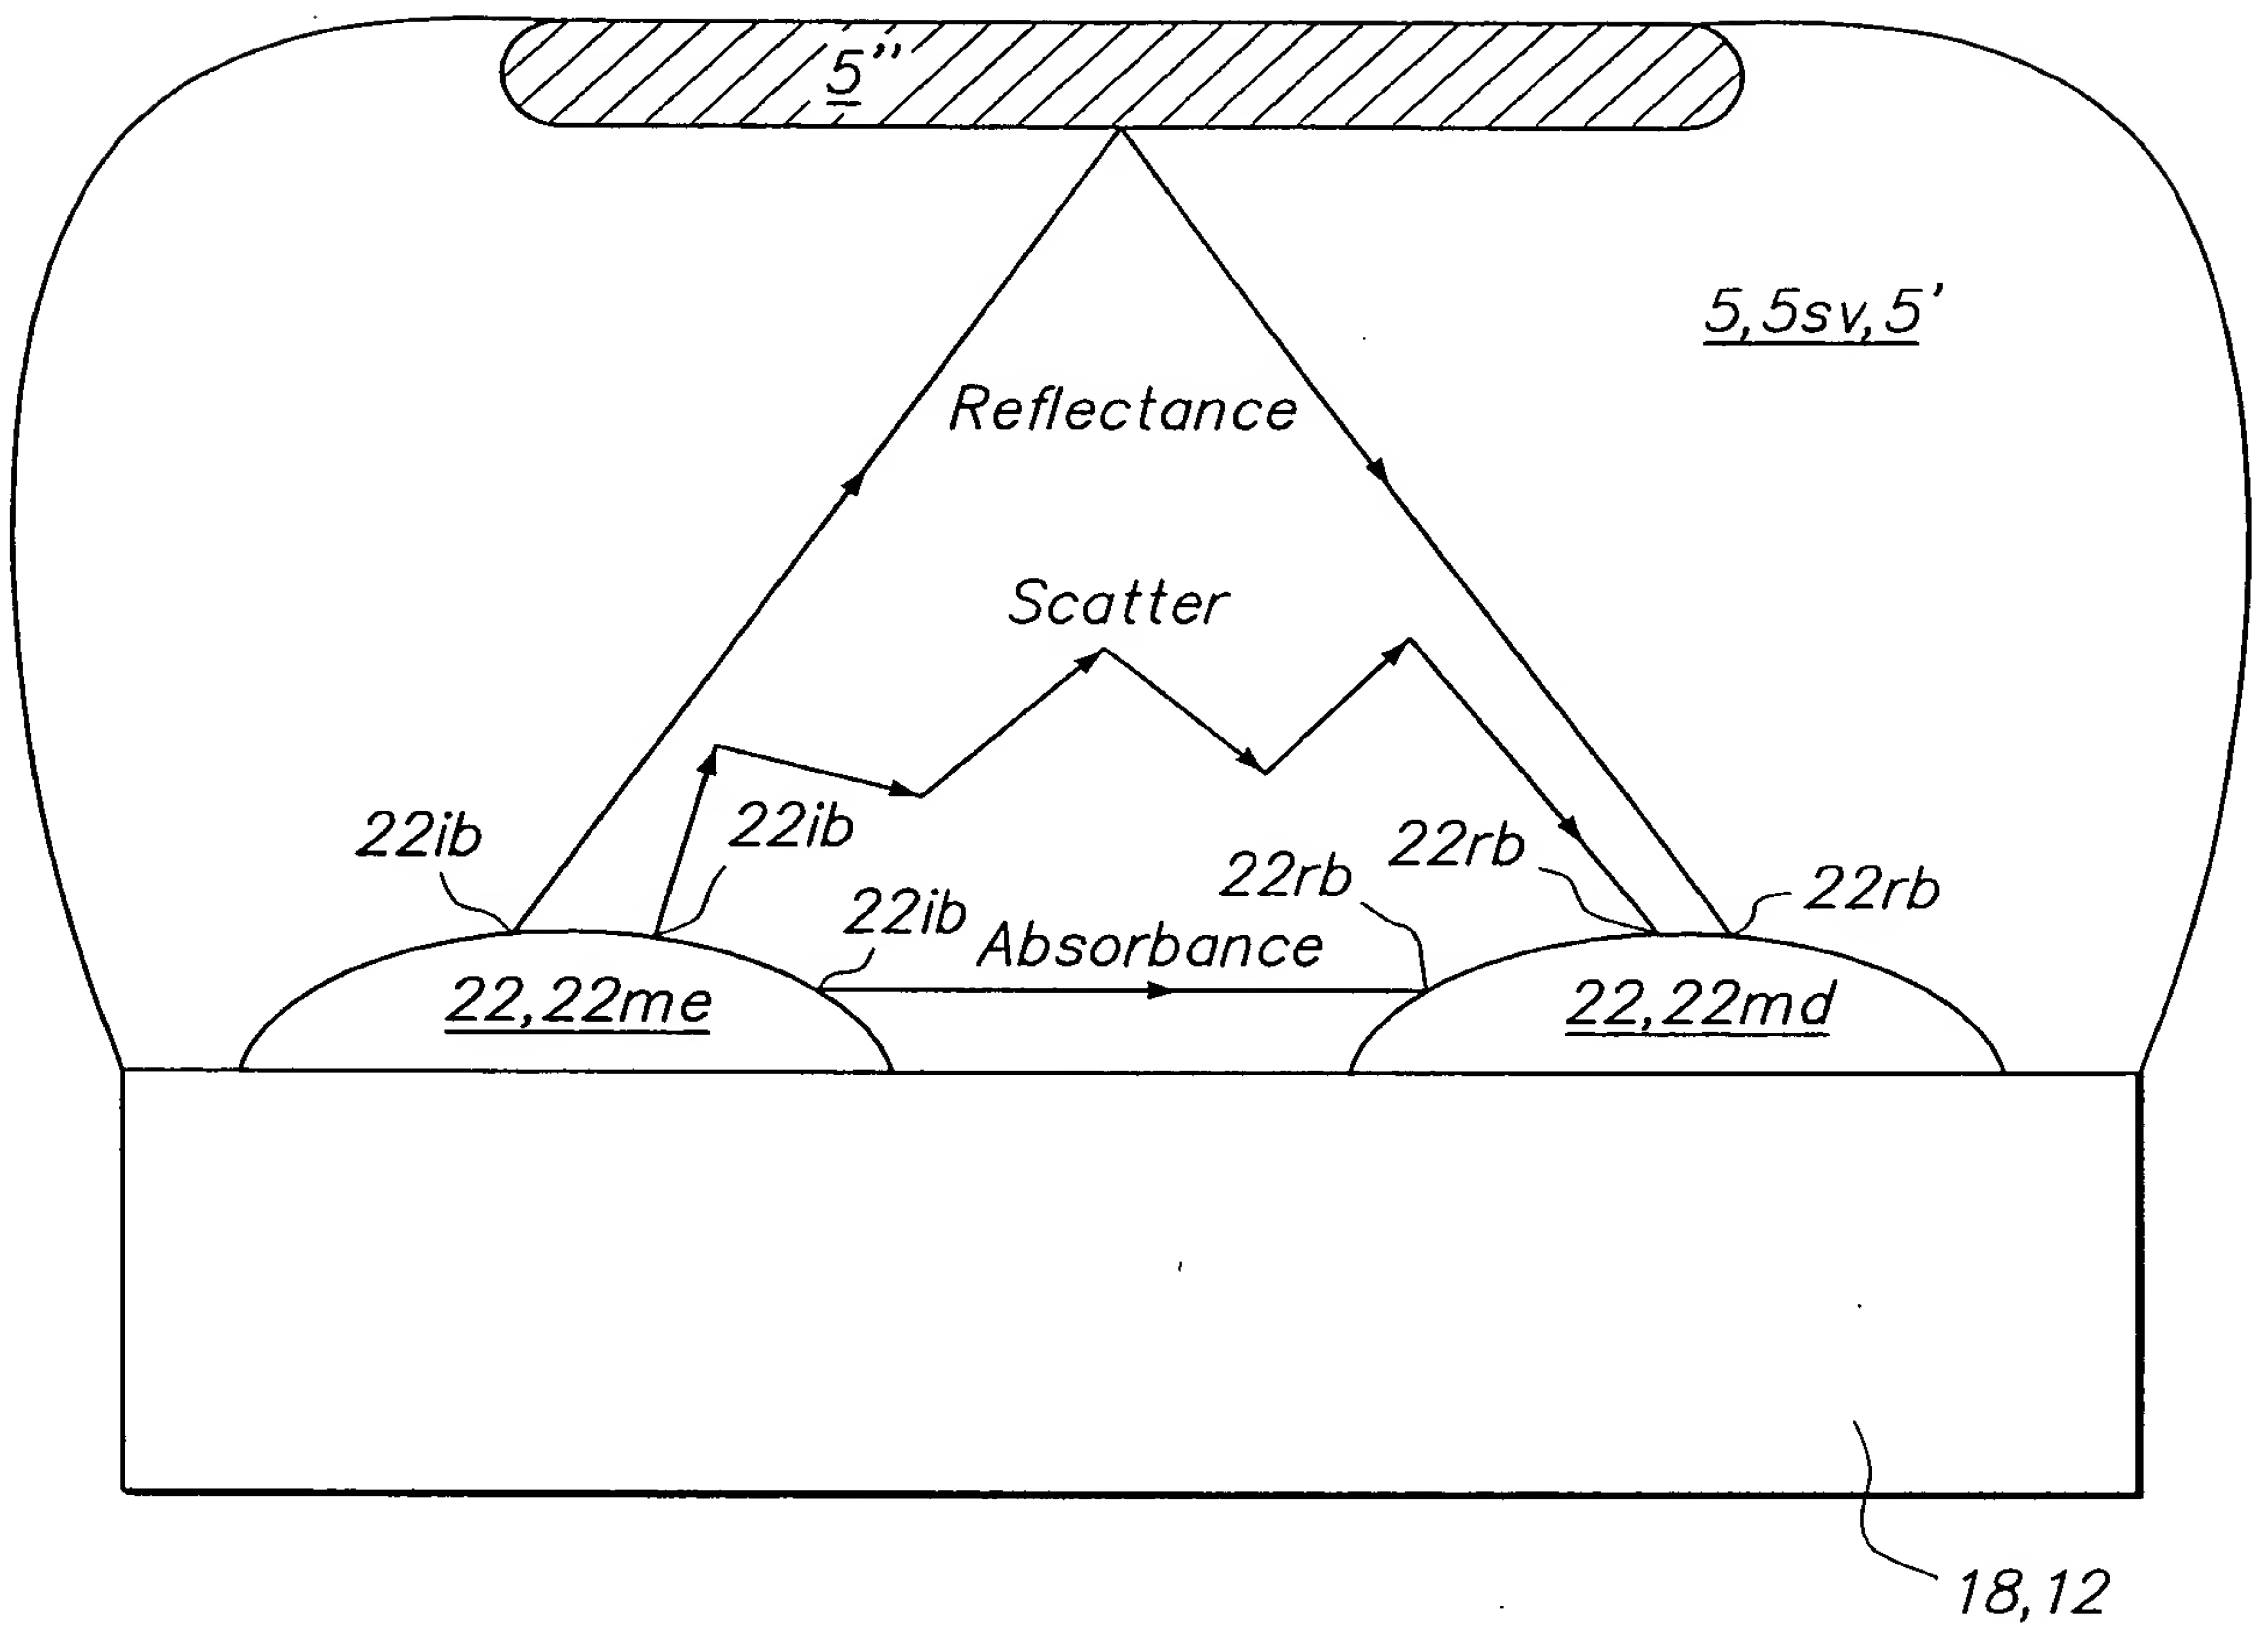


FIG. 6

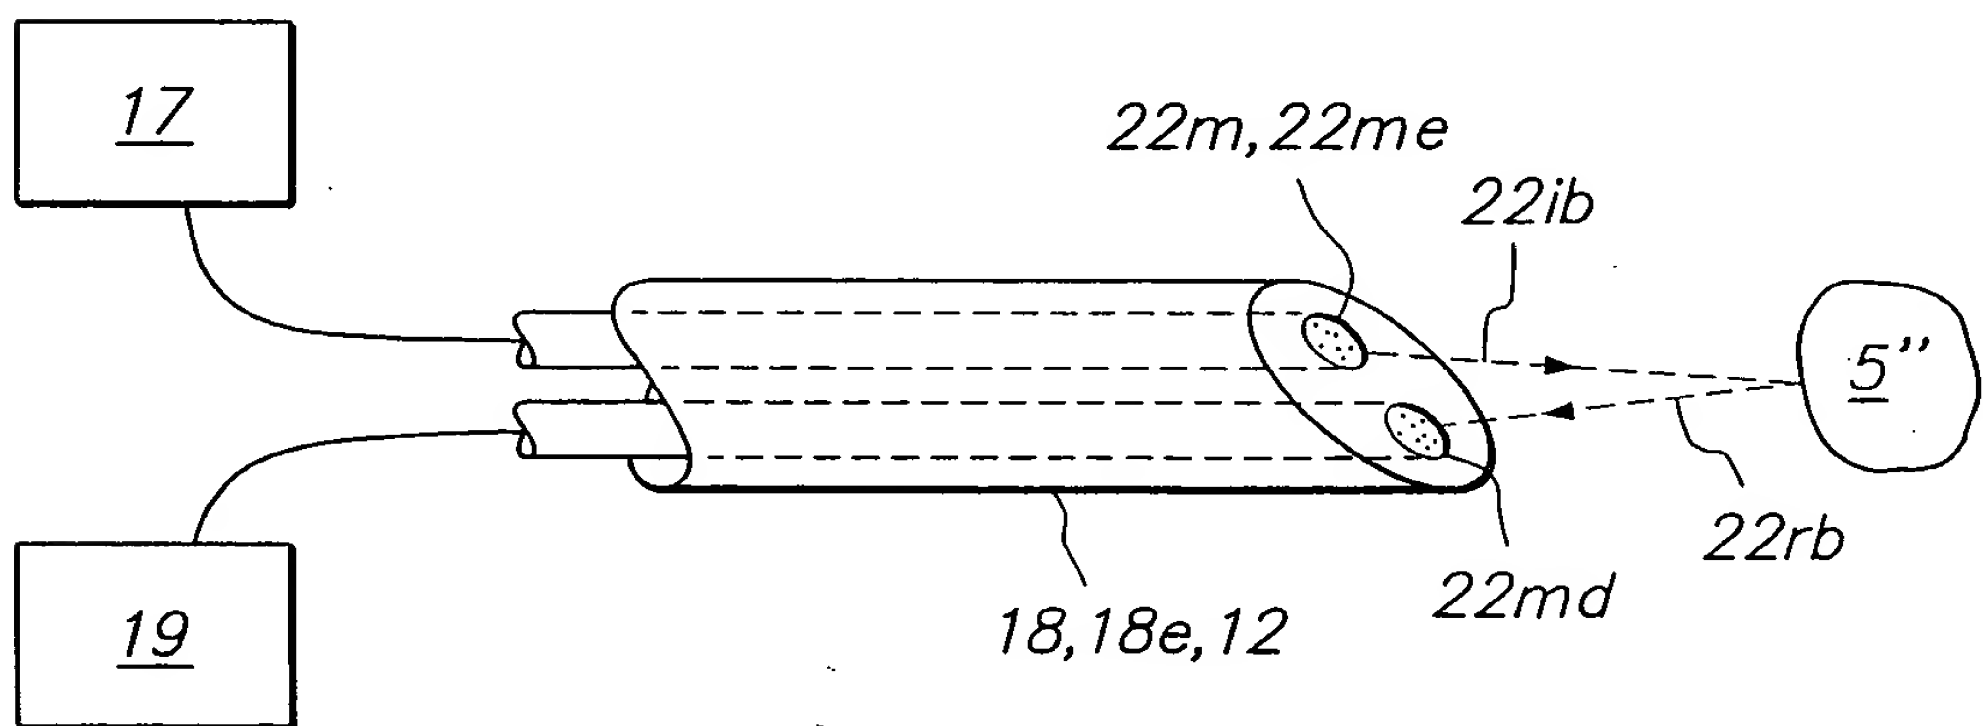


FIG. 7

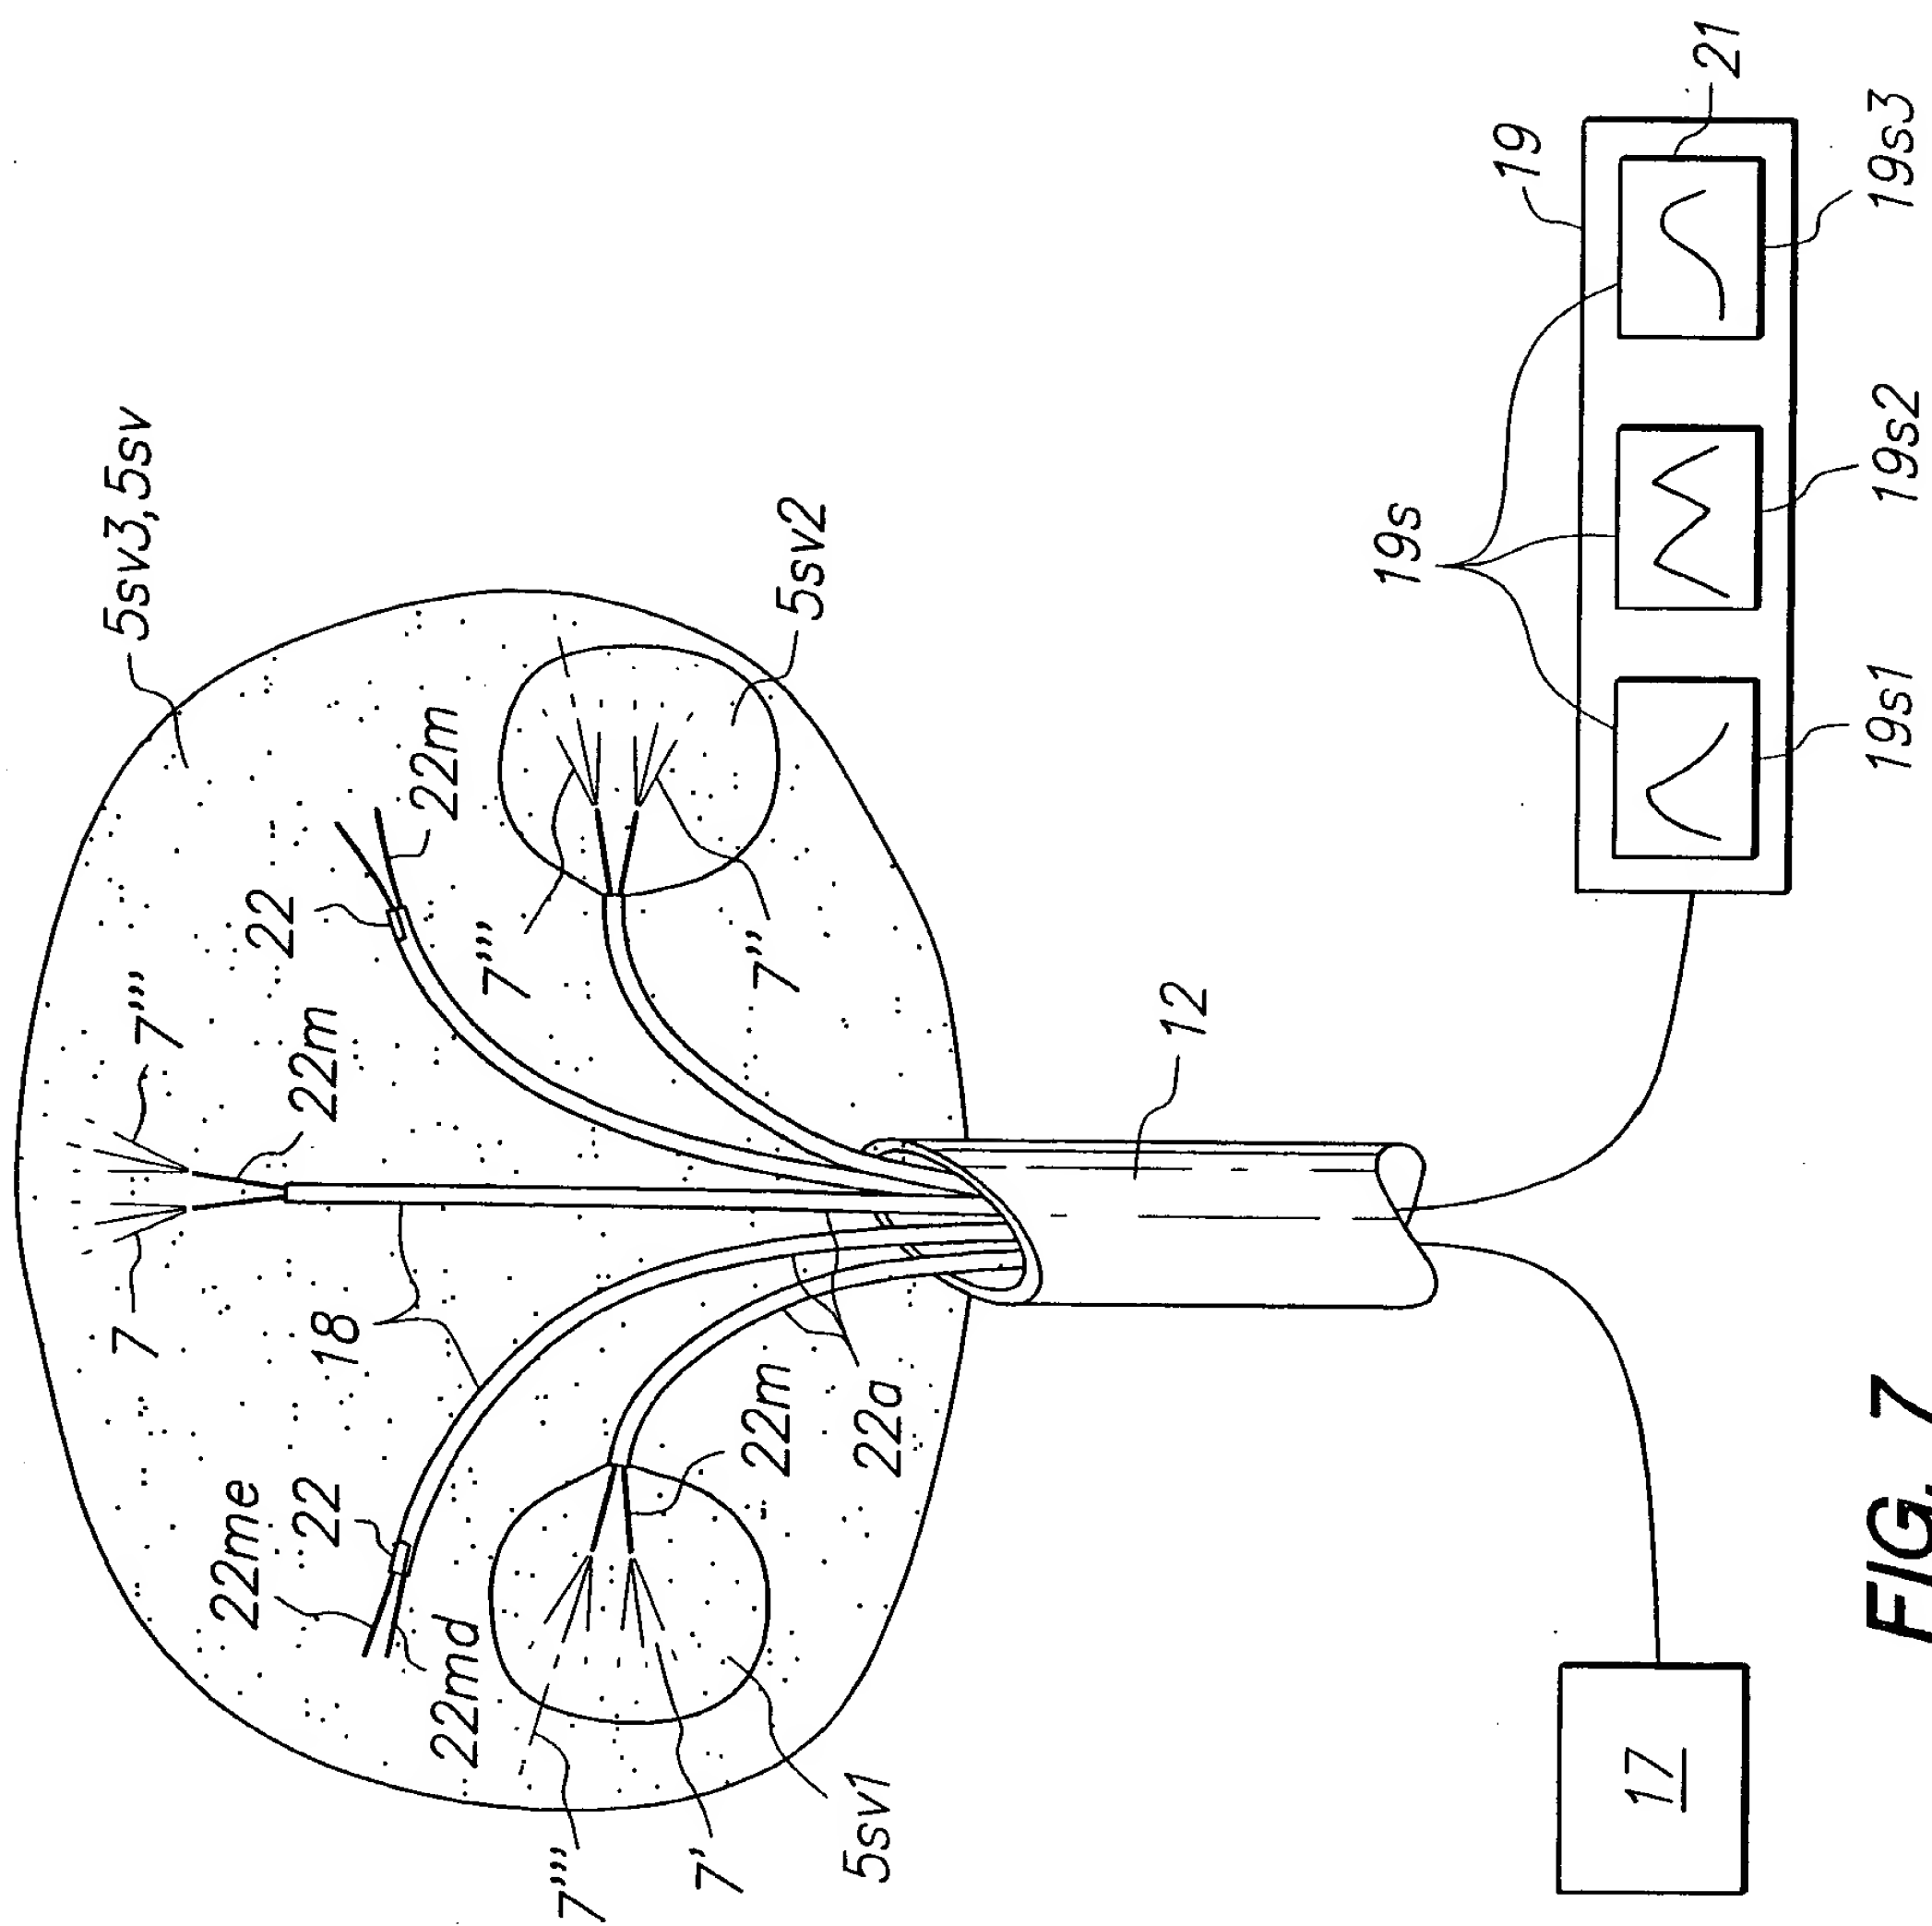


FIG. 7

FIG. 8A

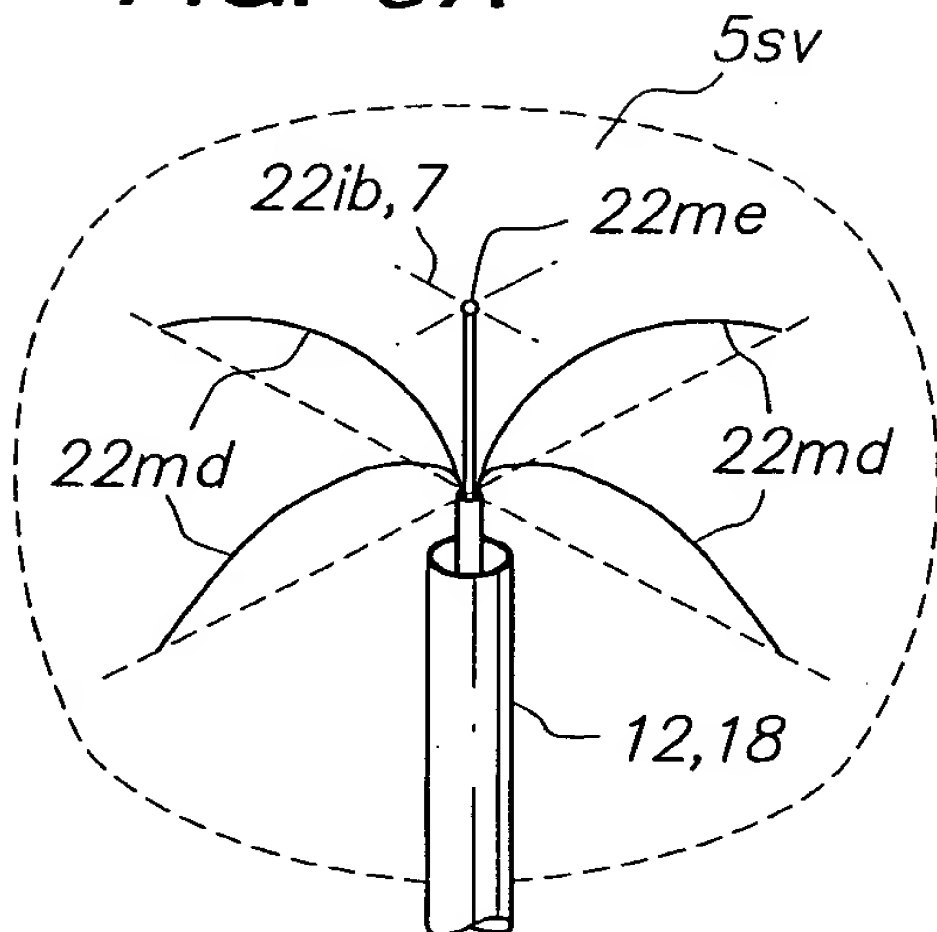


FIG. 8B

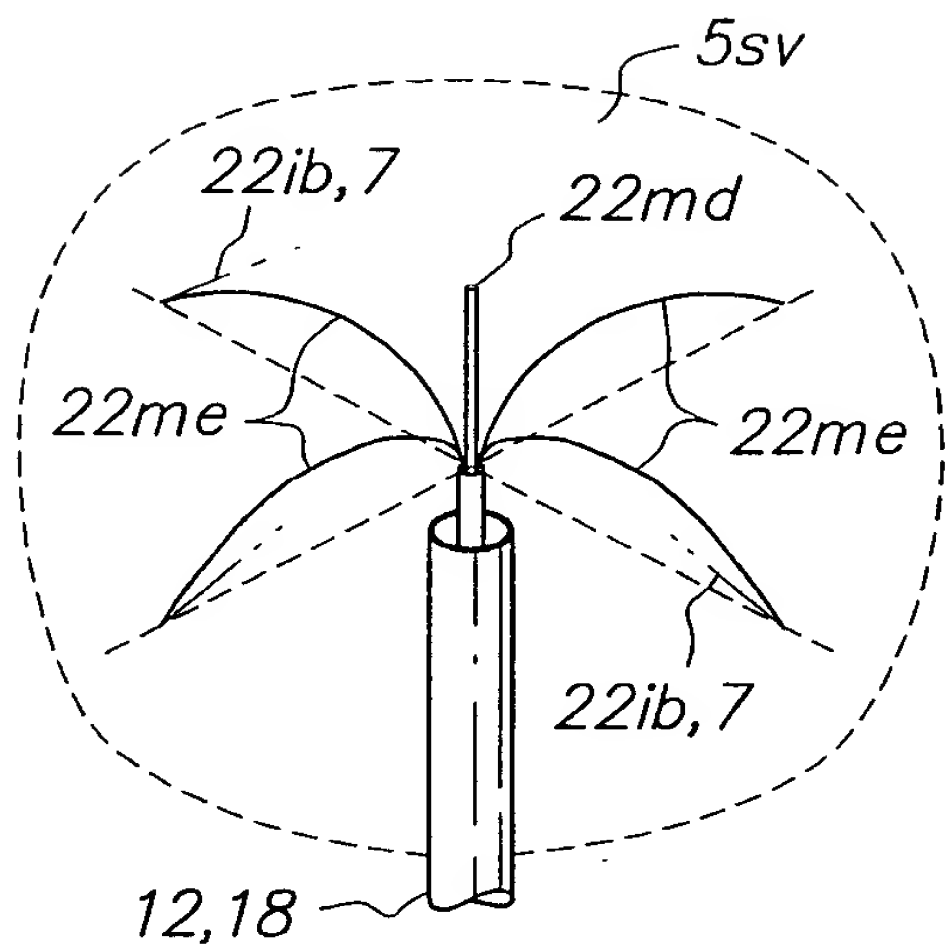


FIG. 8C


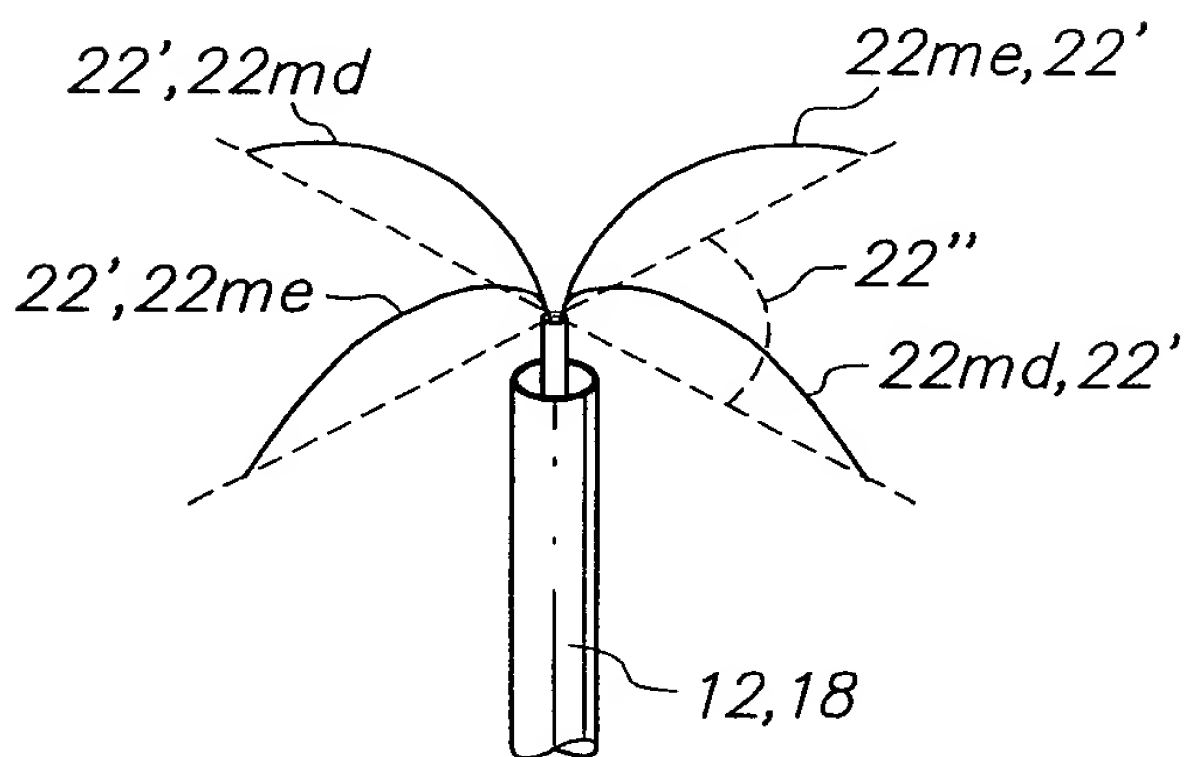


FIG. 8D

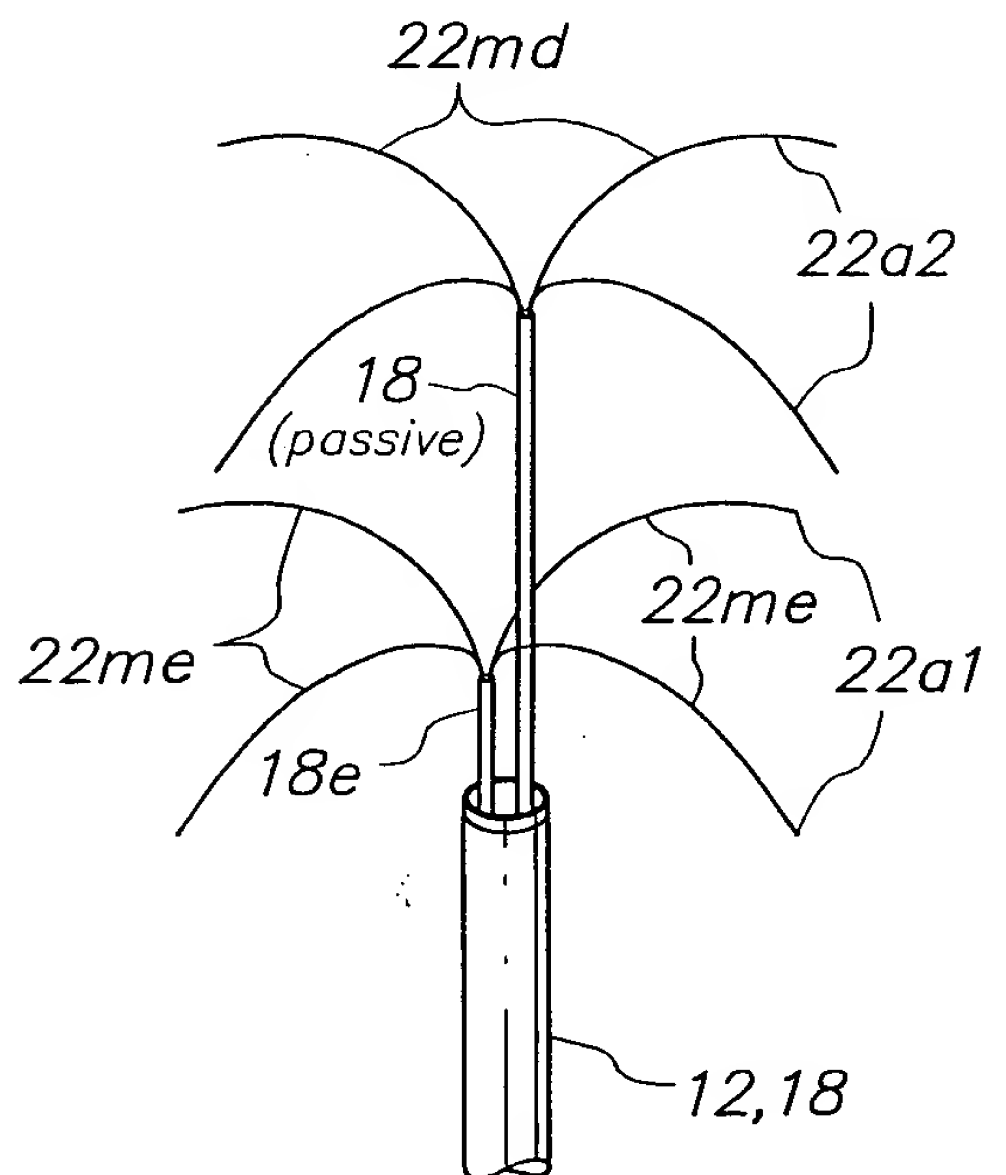

8/23

FIG. 9

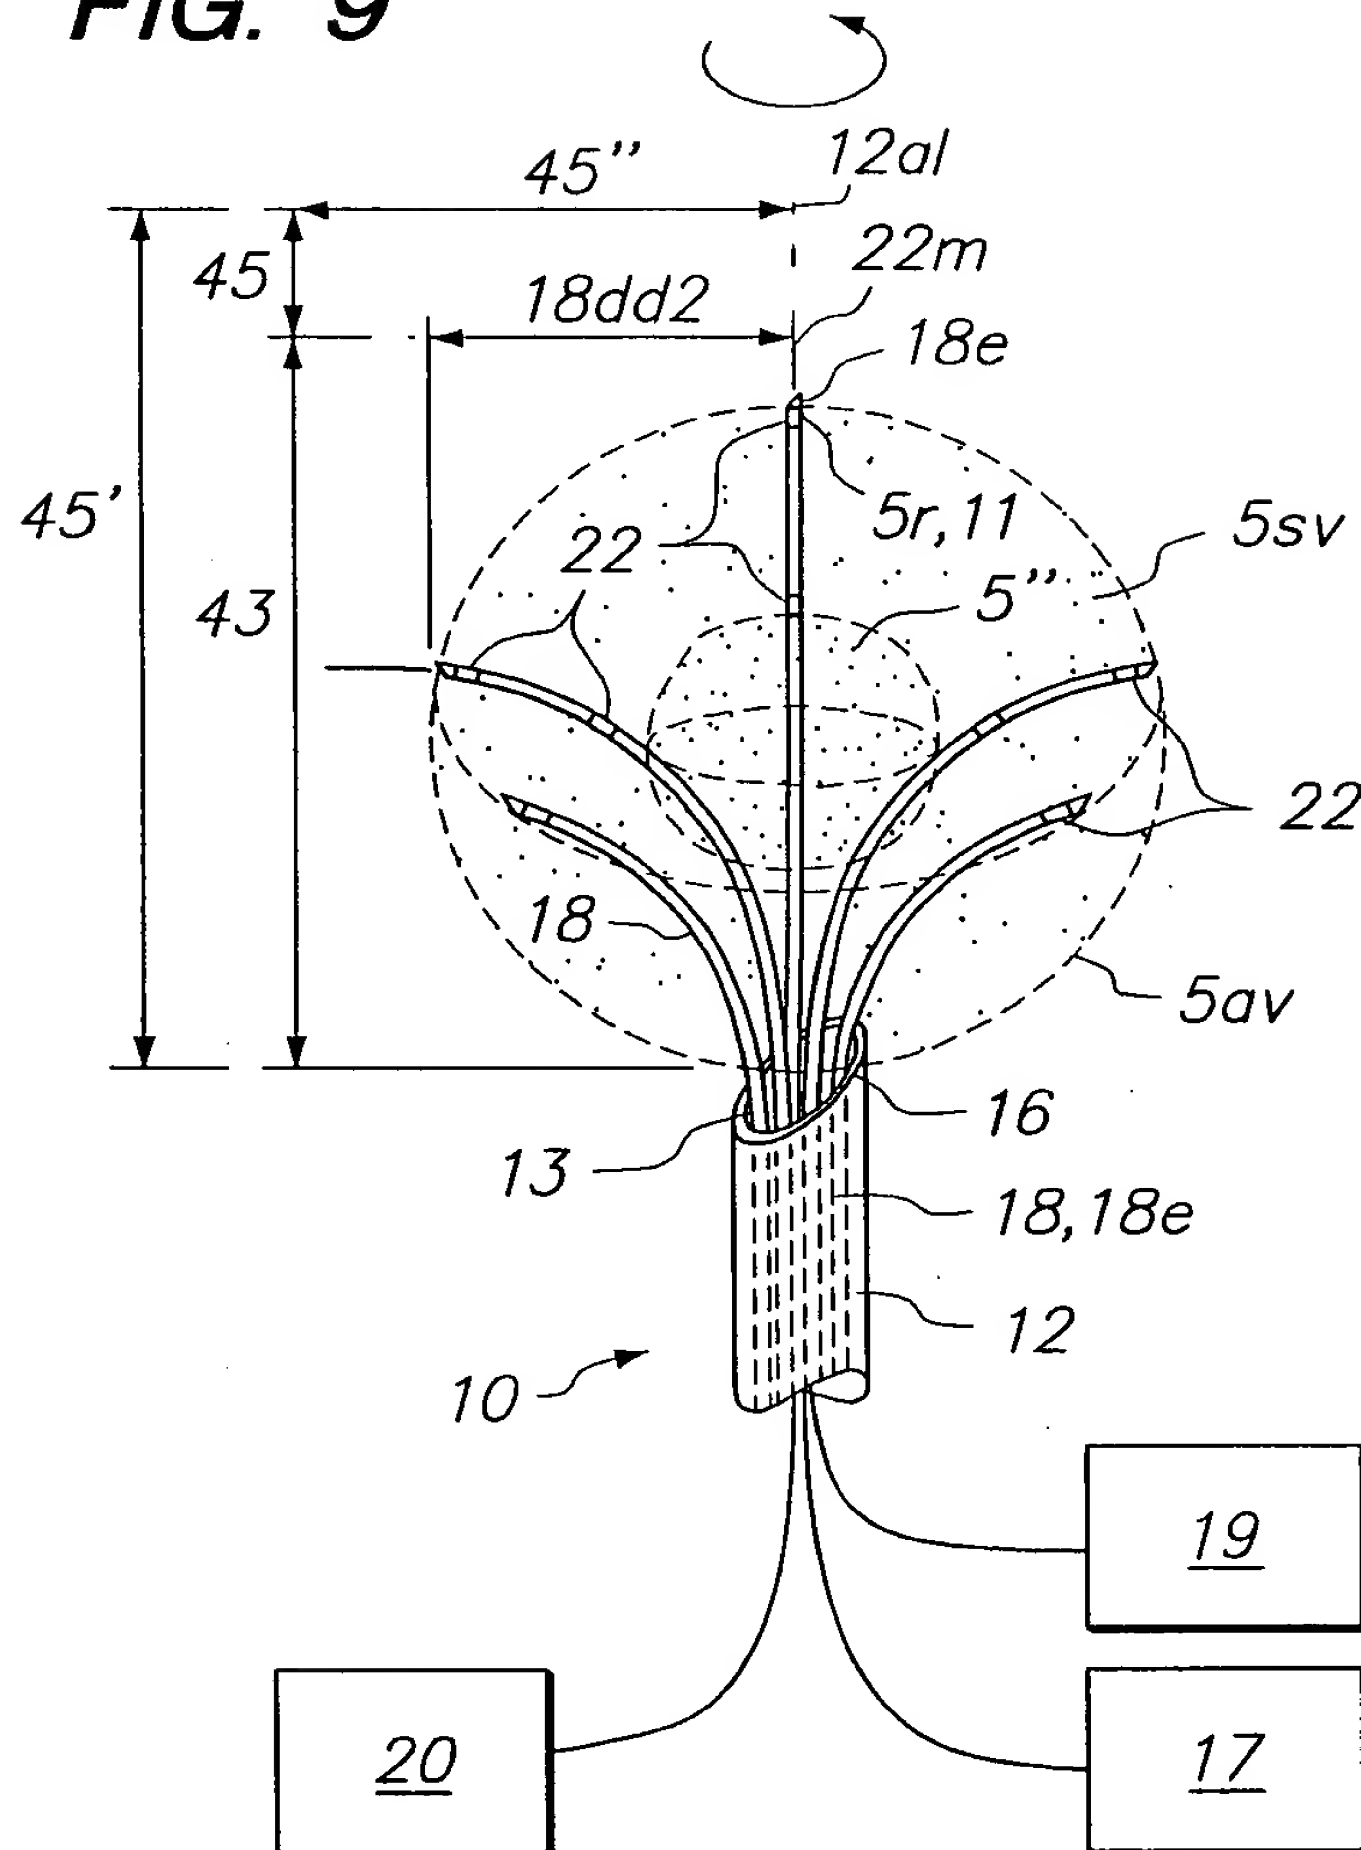


FIG. 10


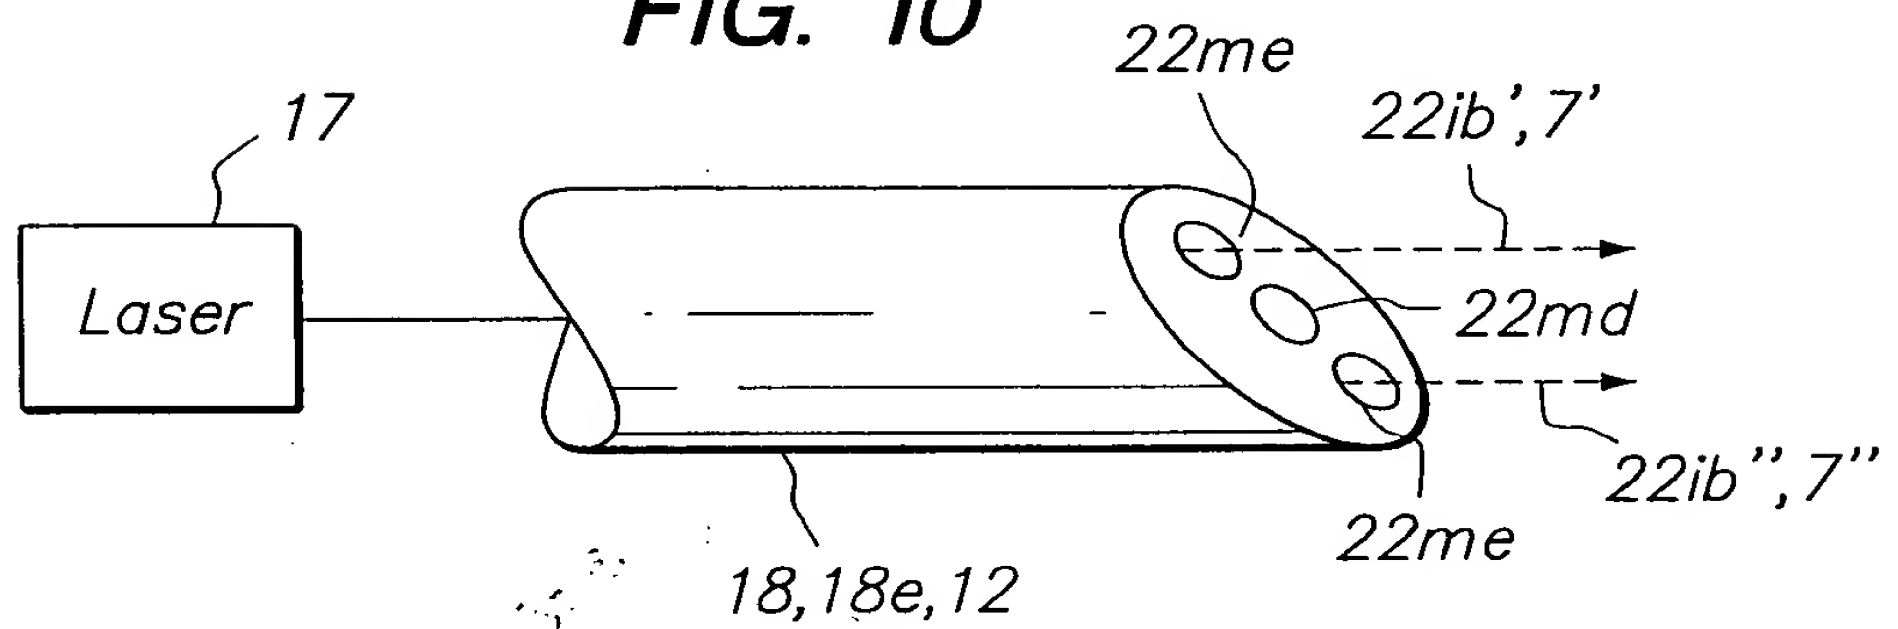


FIG. 11

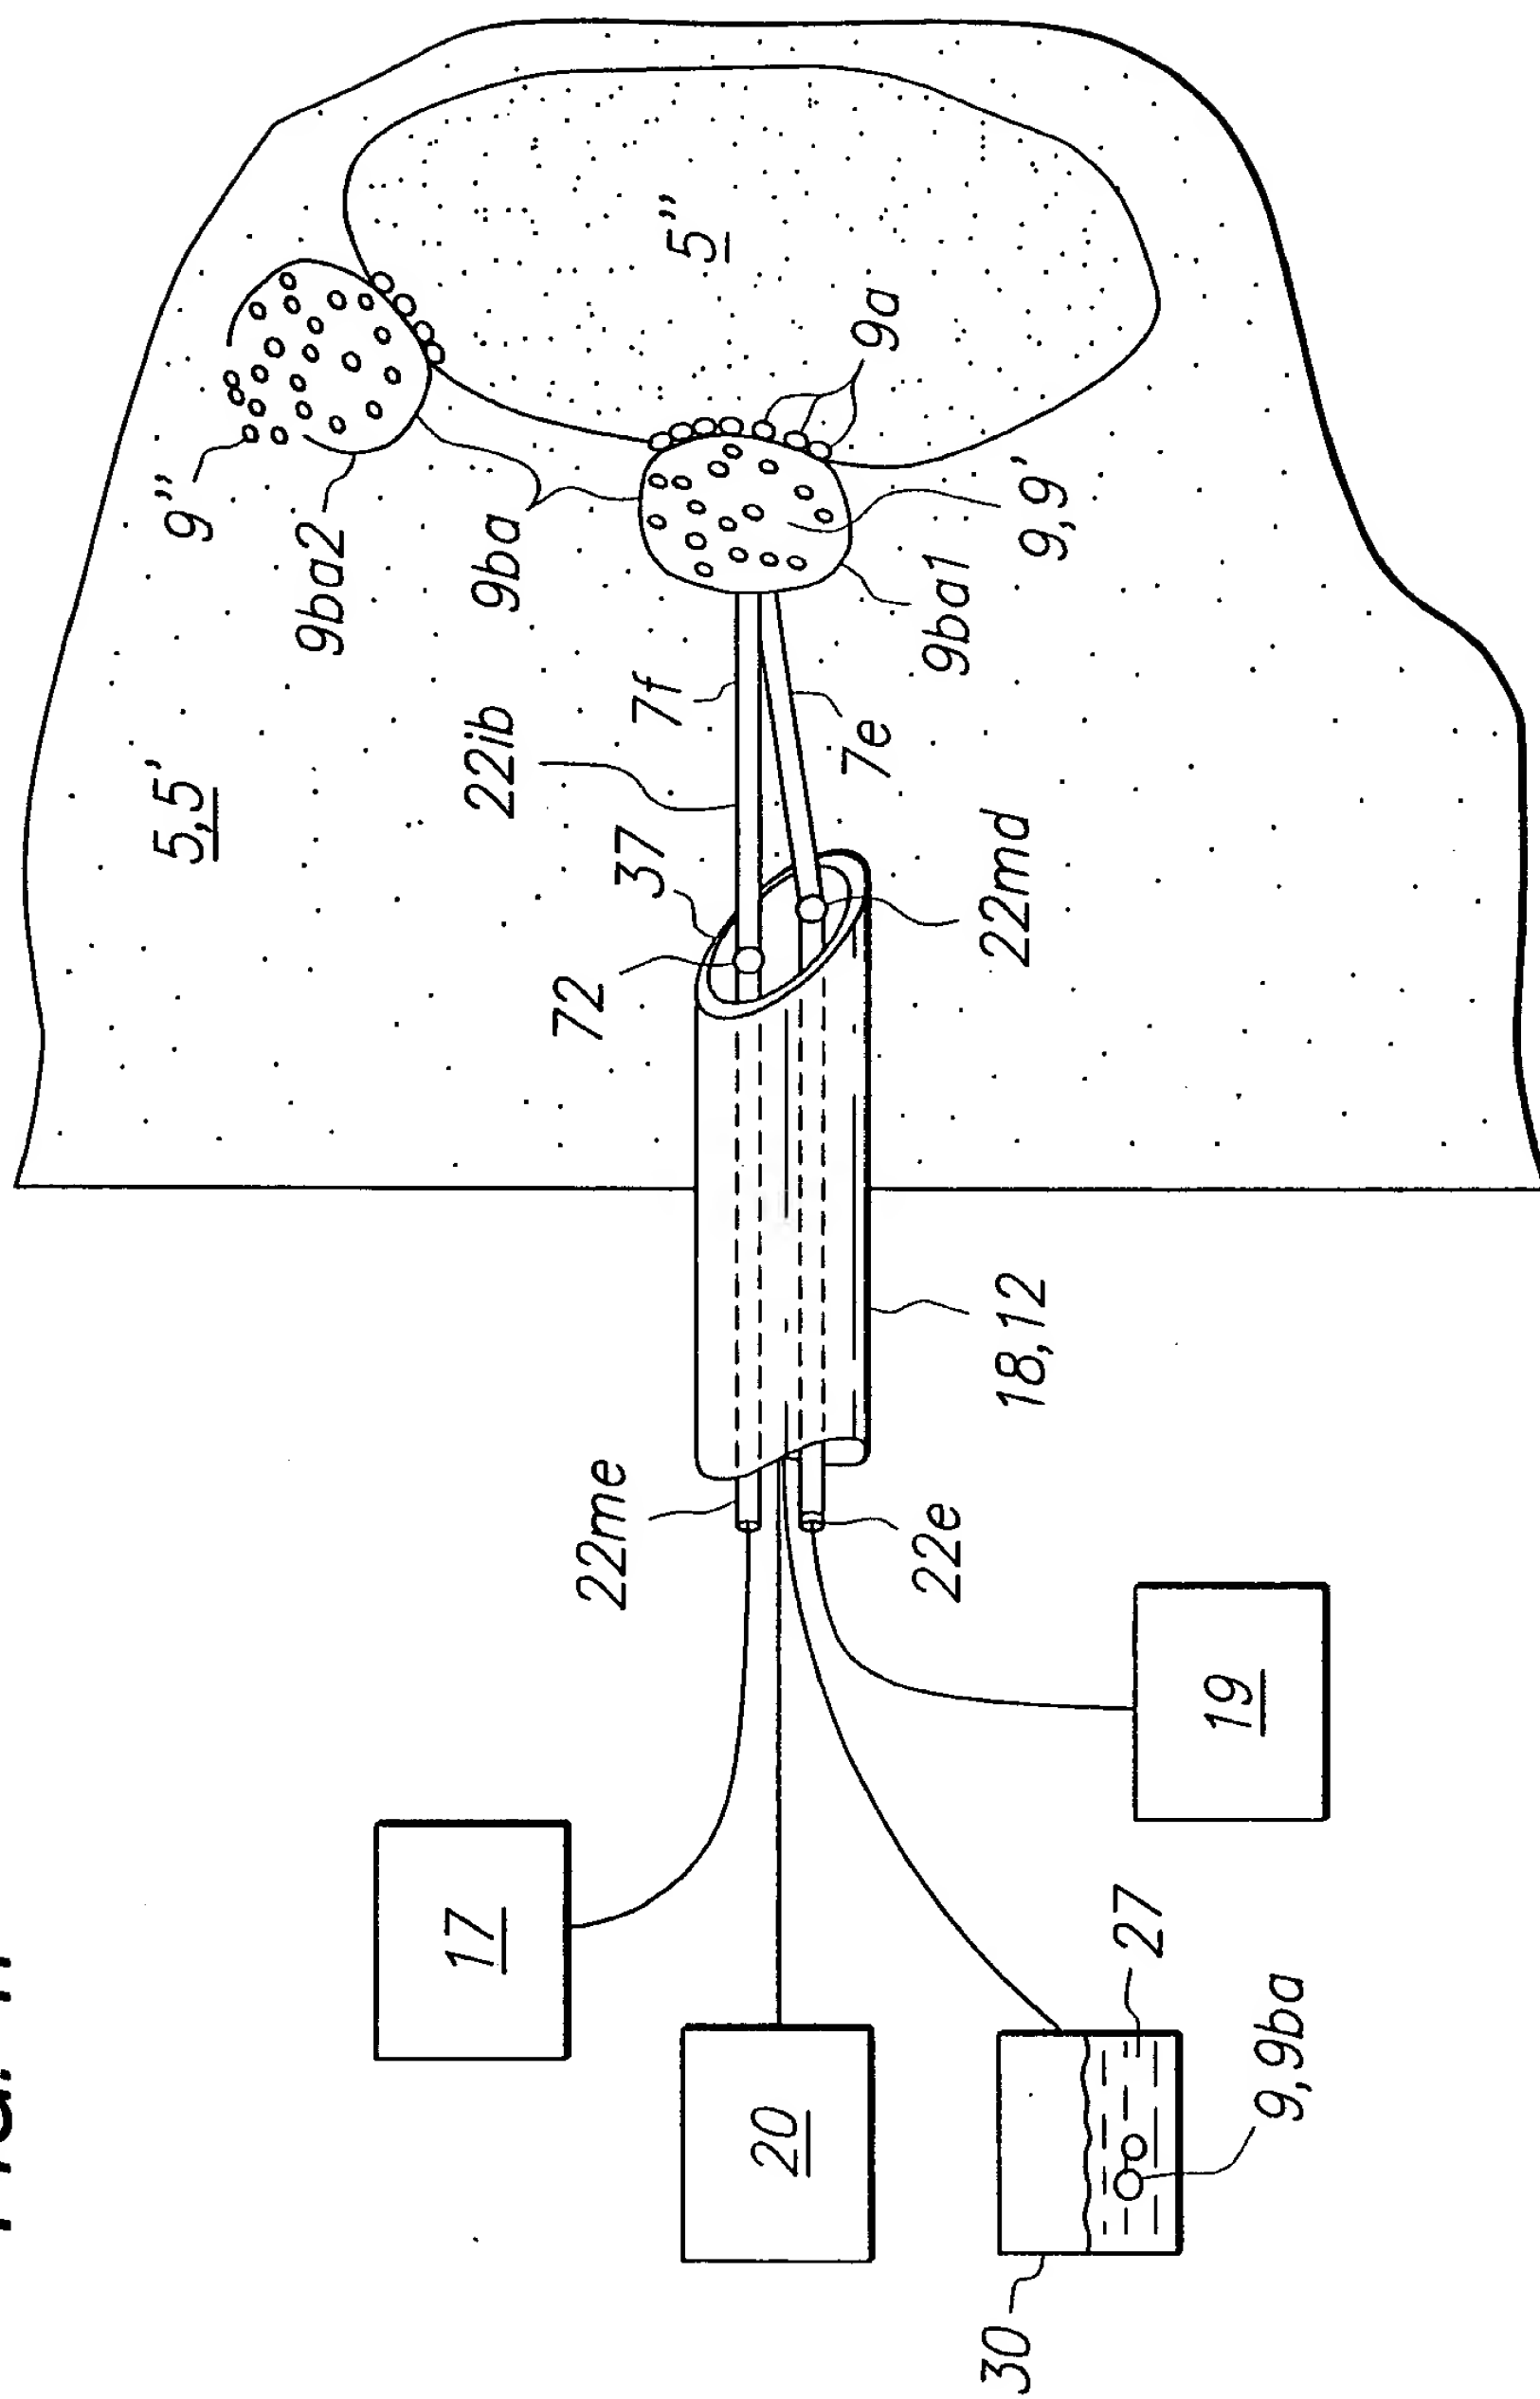

10/23

FIG. 12

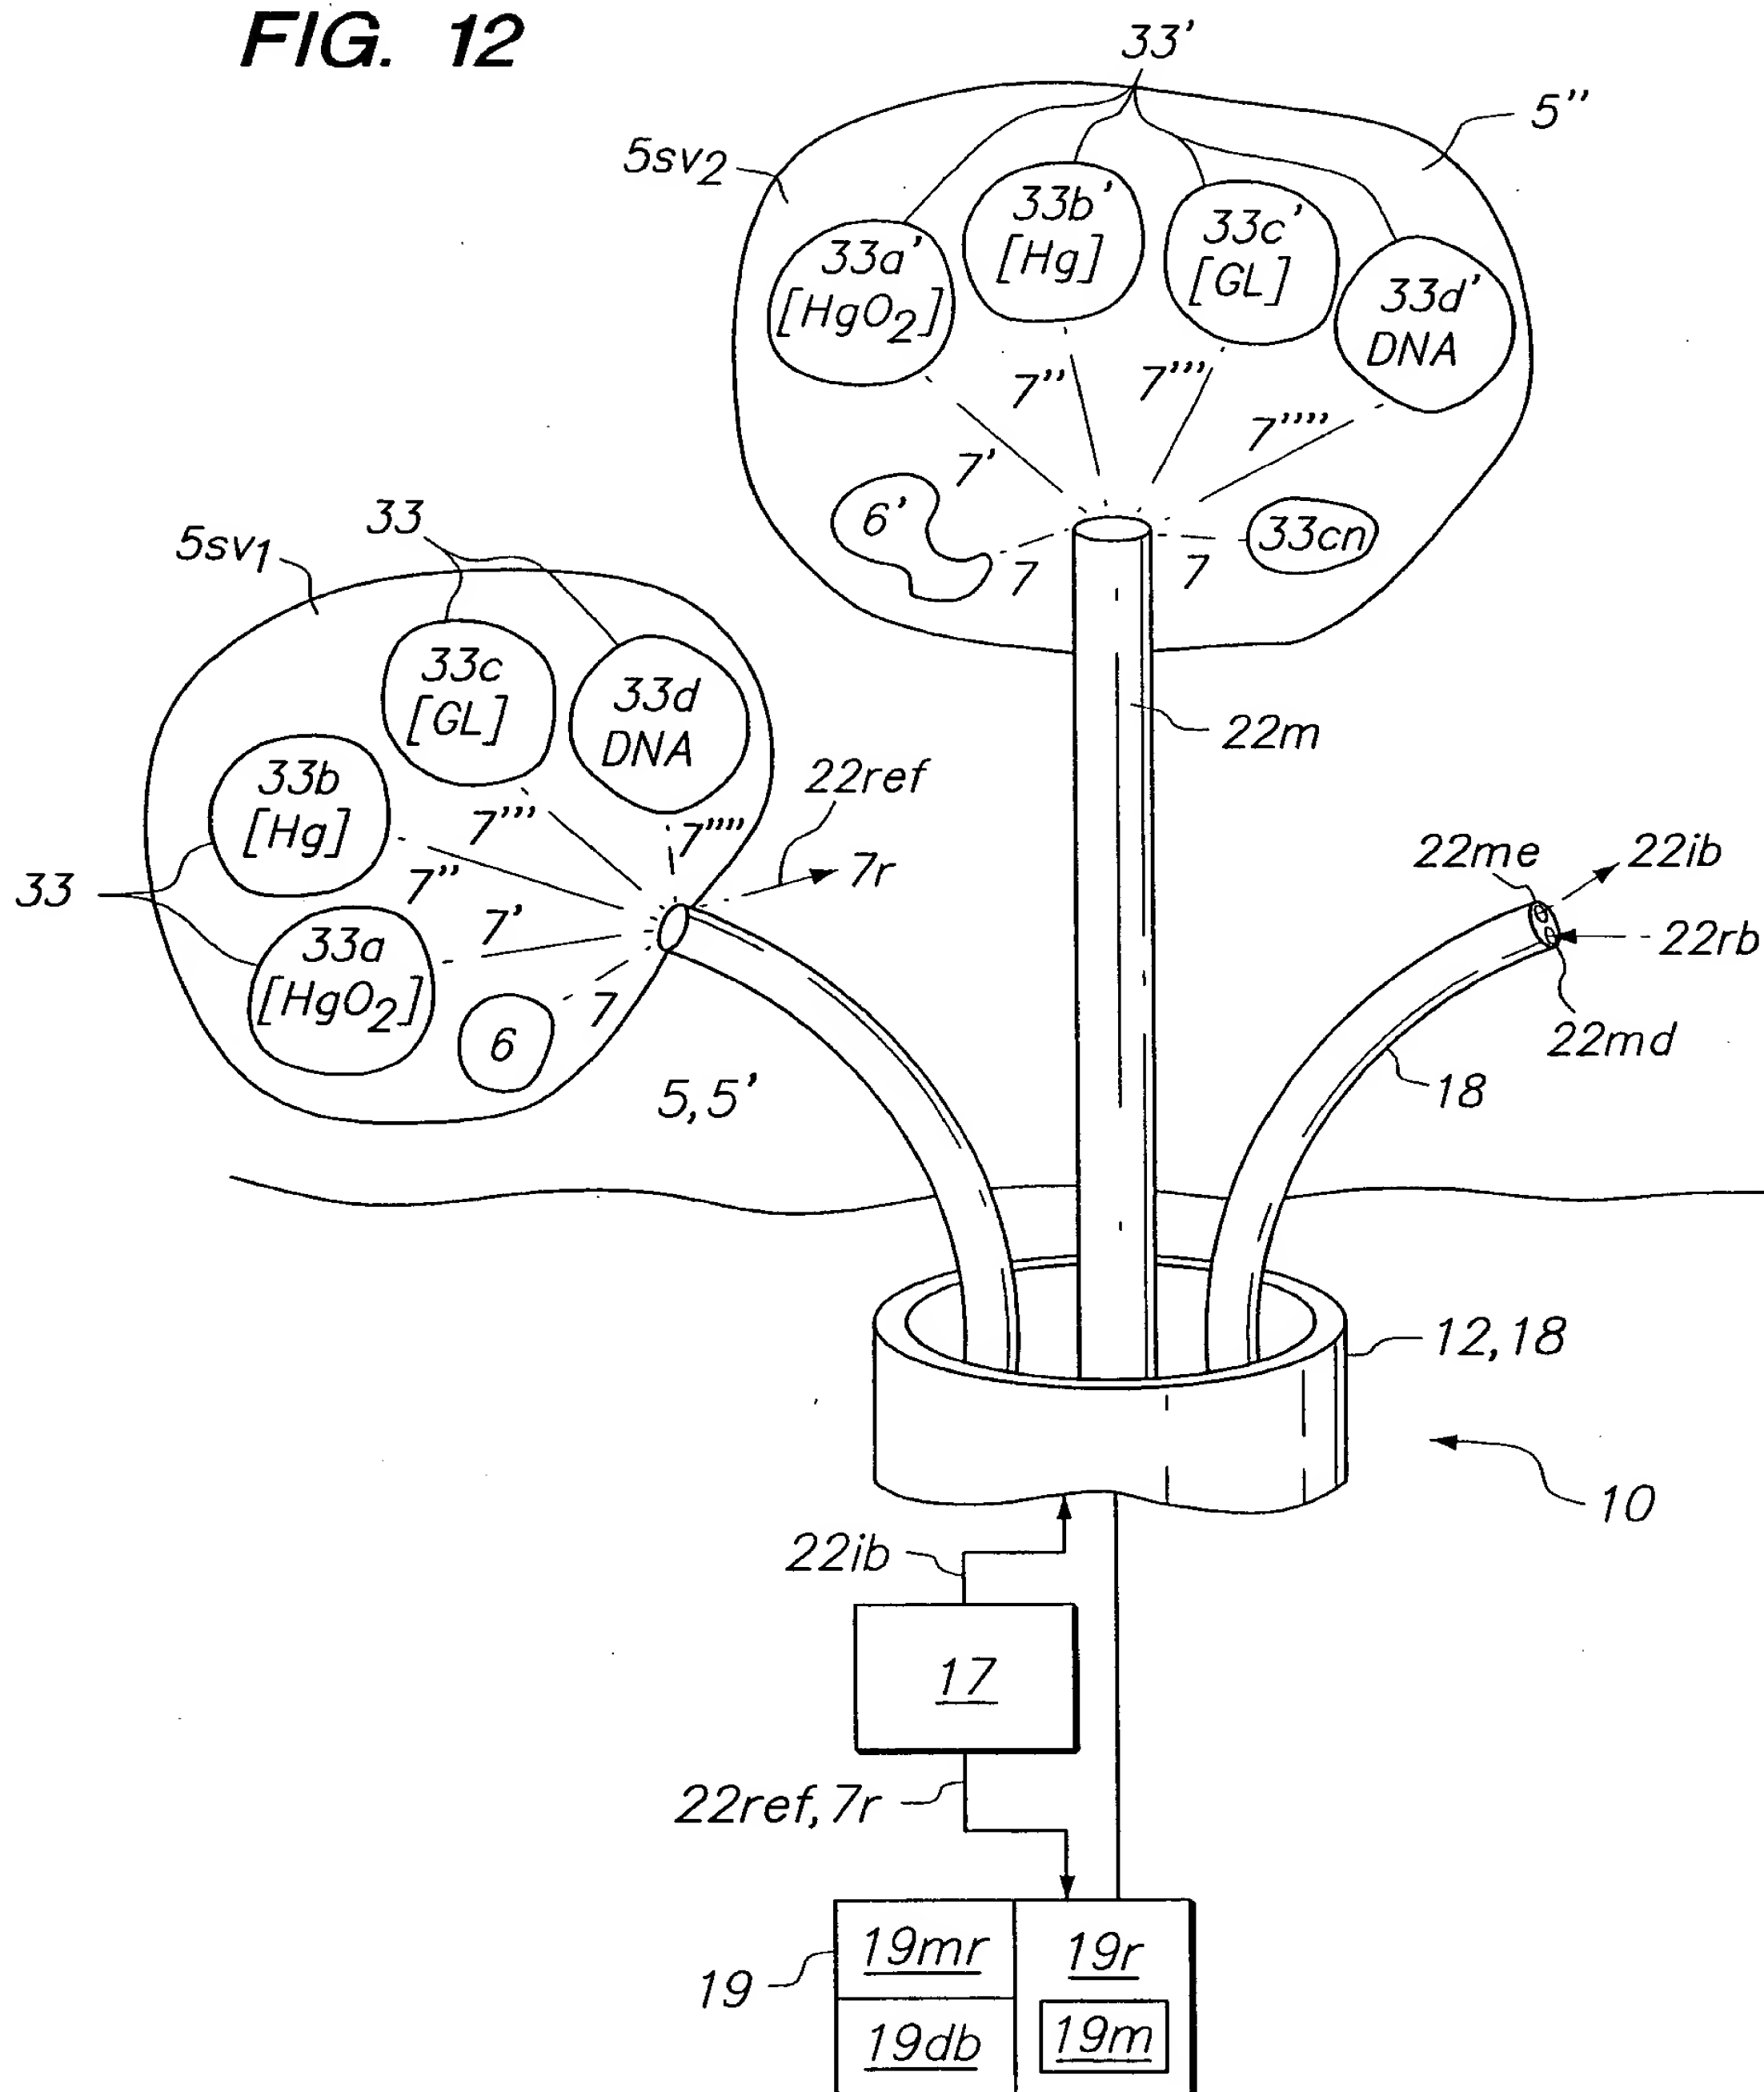


FIG. 13

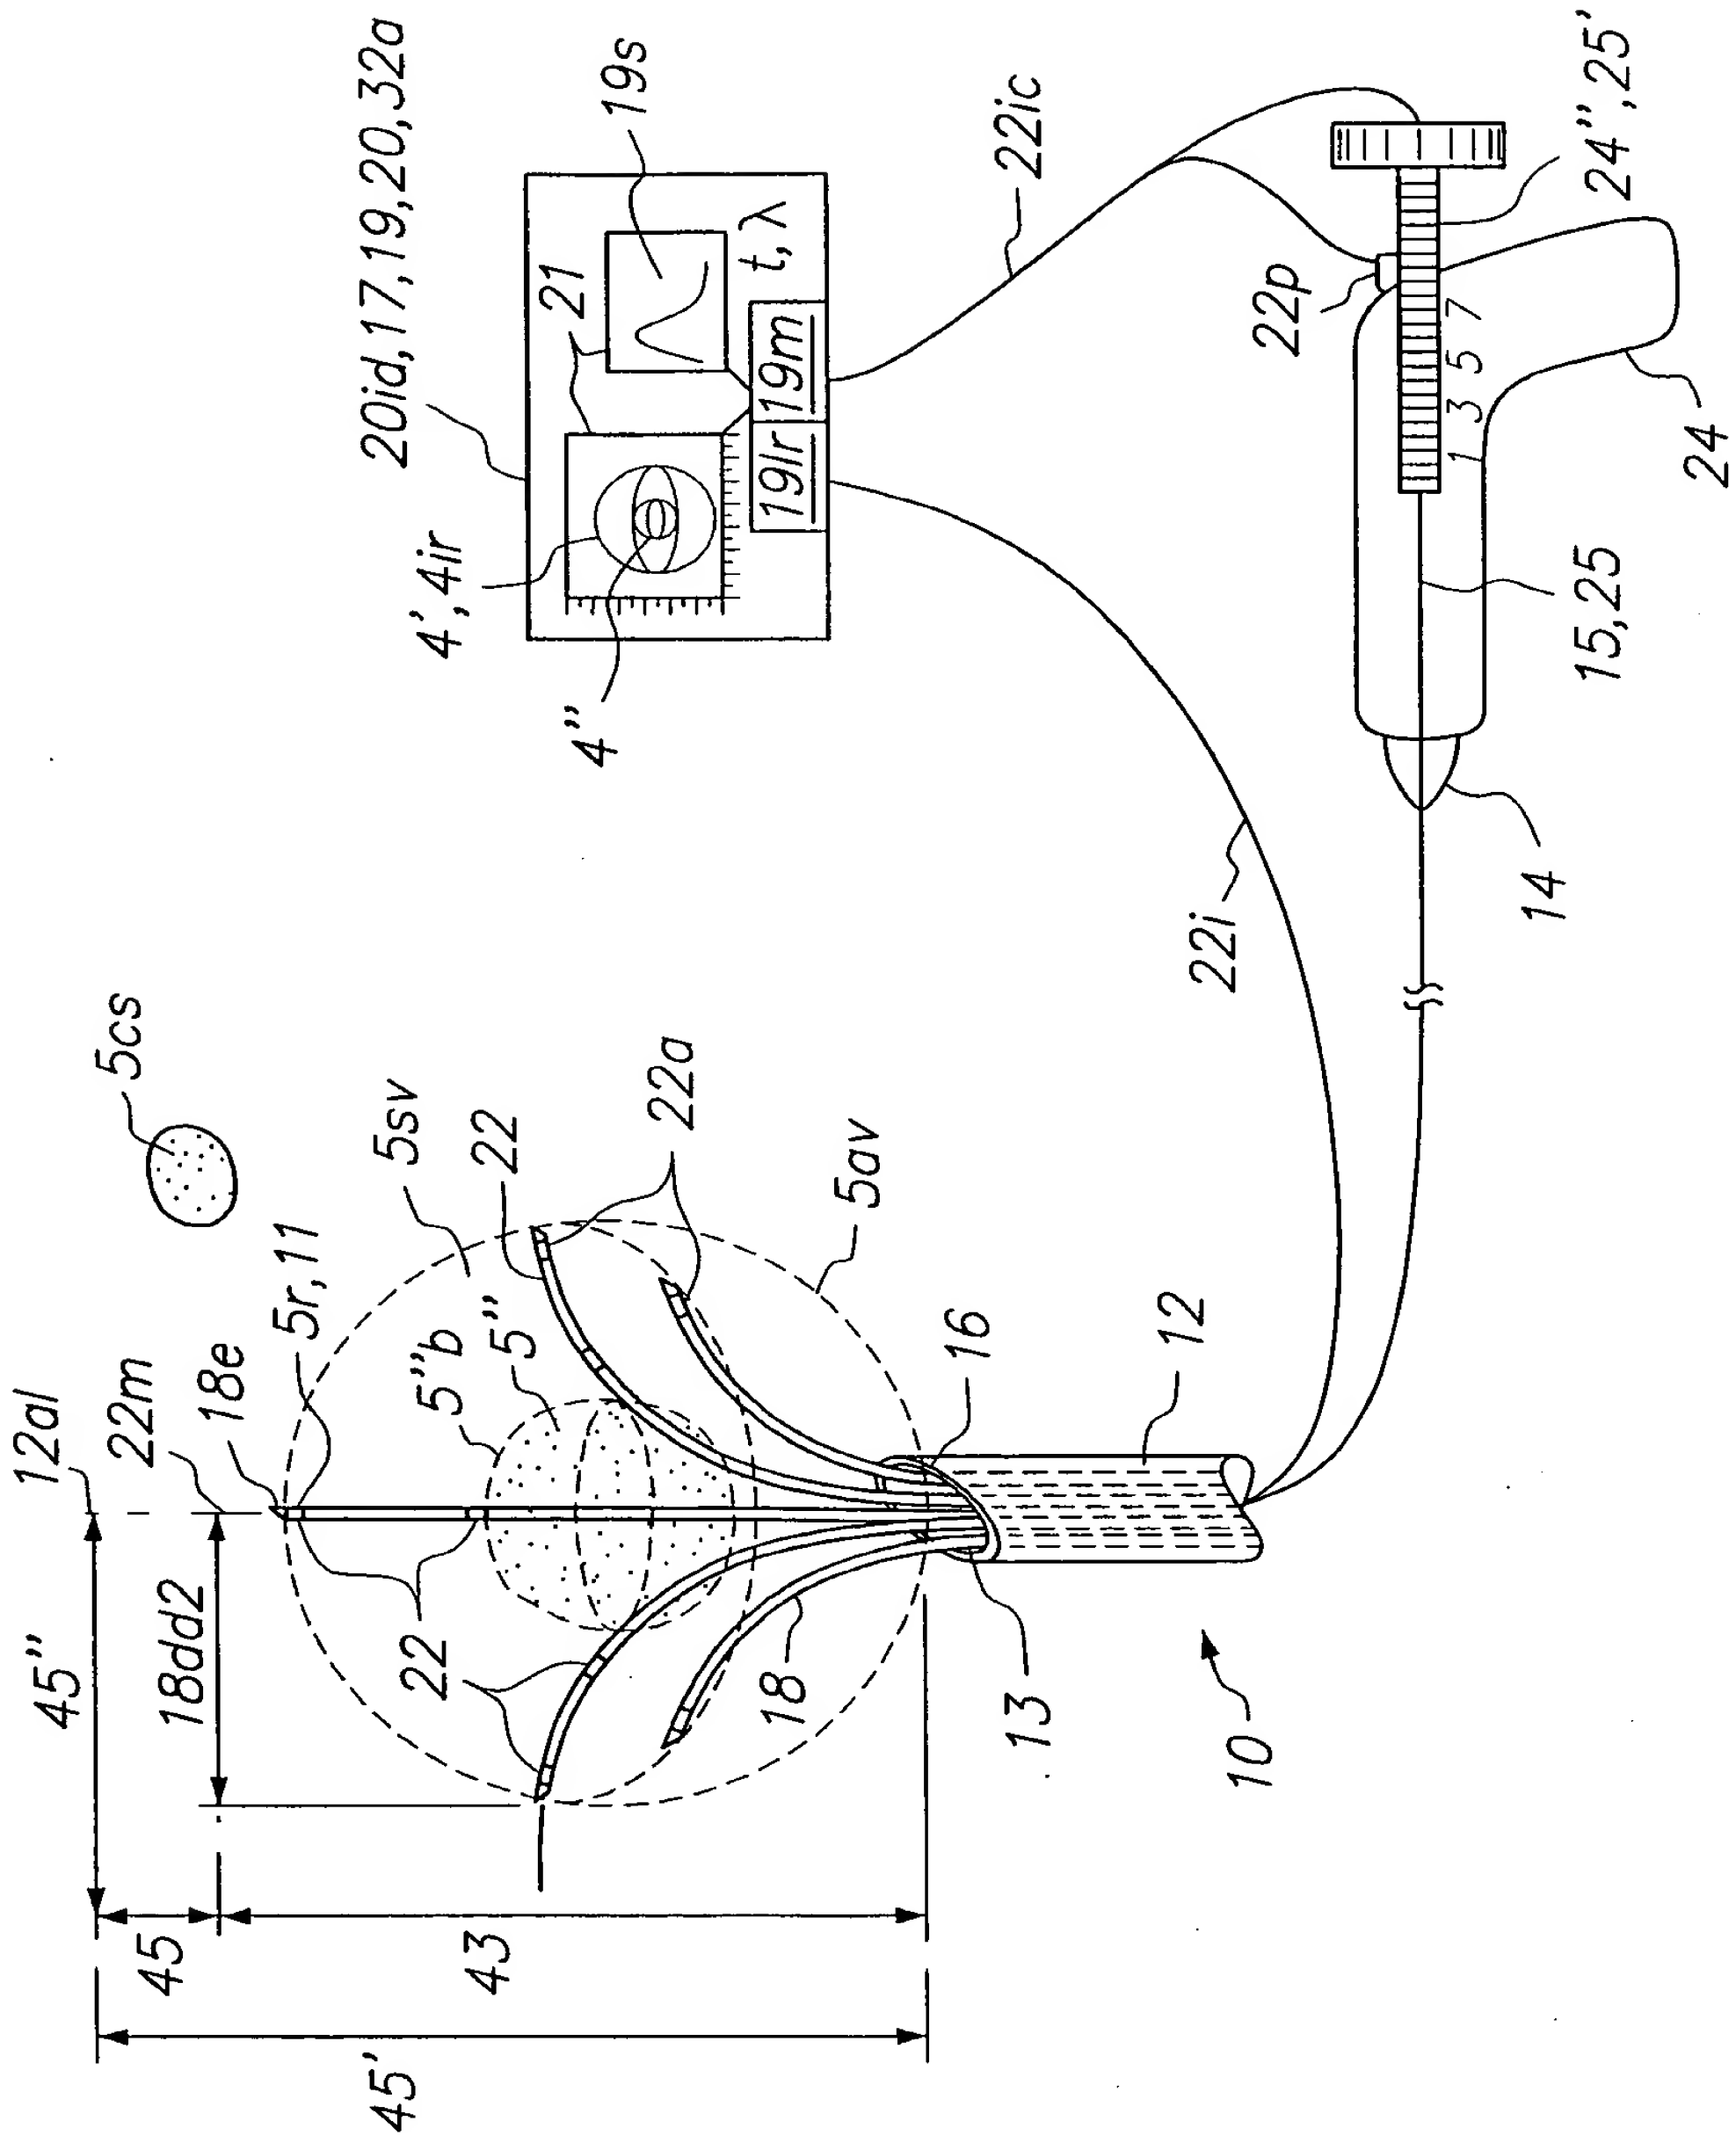


FIG. 13

12/23

FIG. 14A

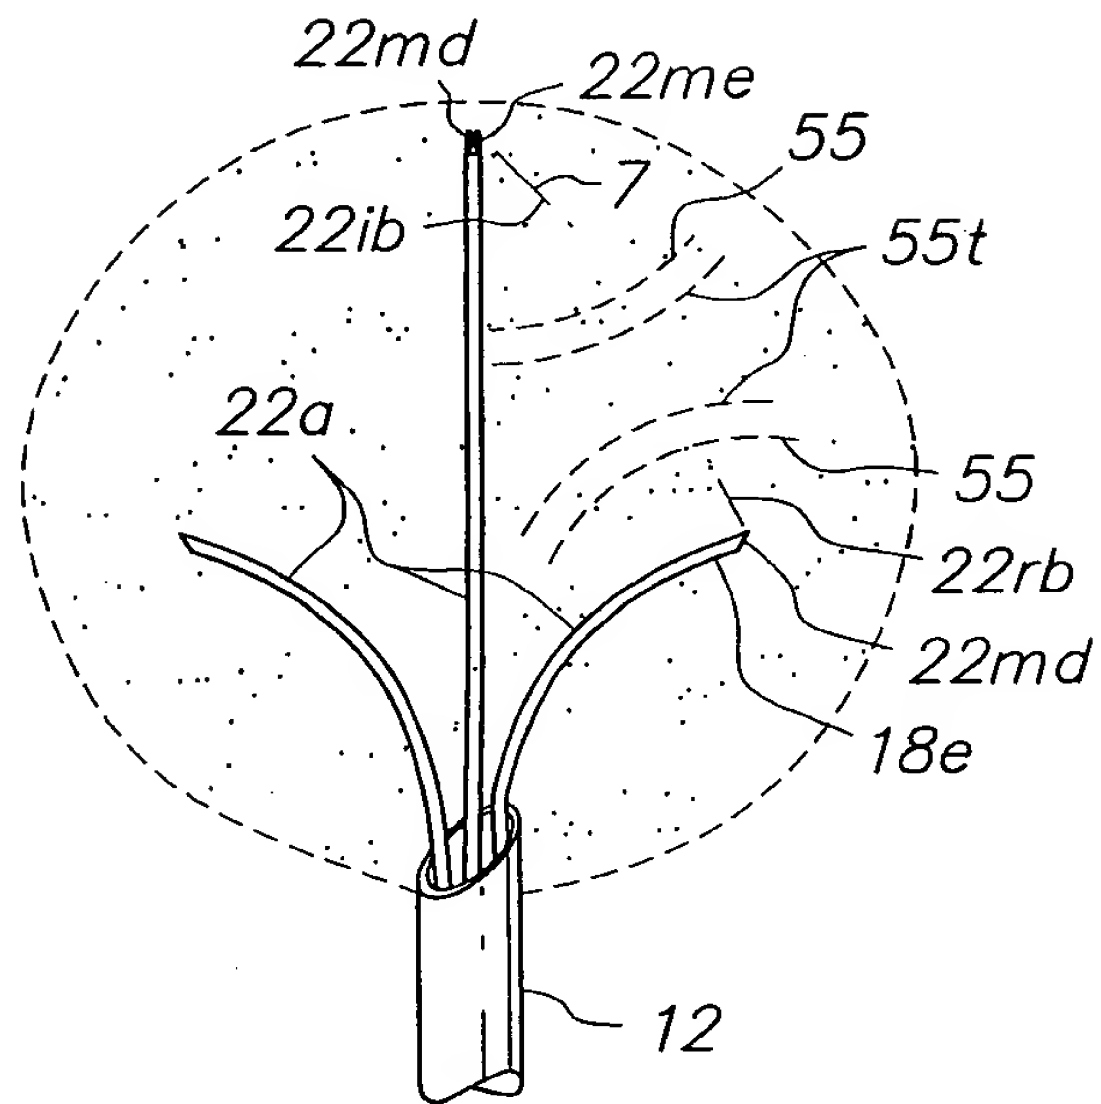


FIG. 14B

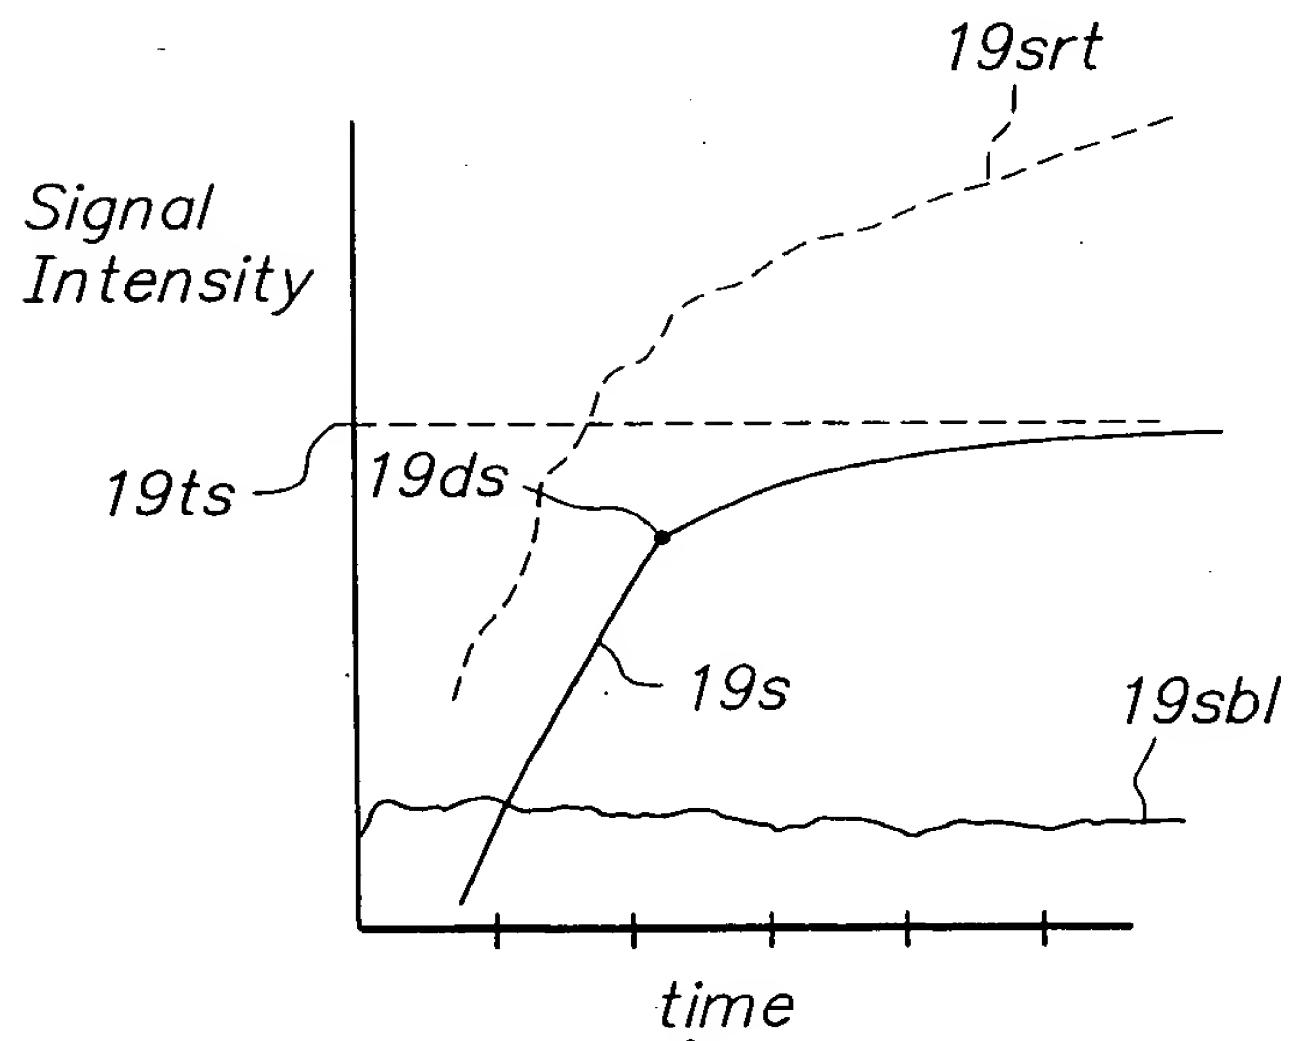


FIG. 15

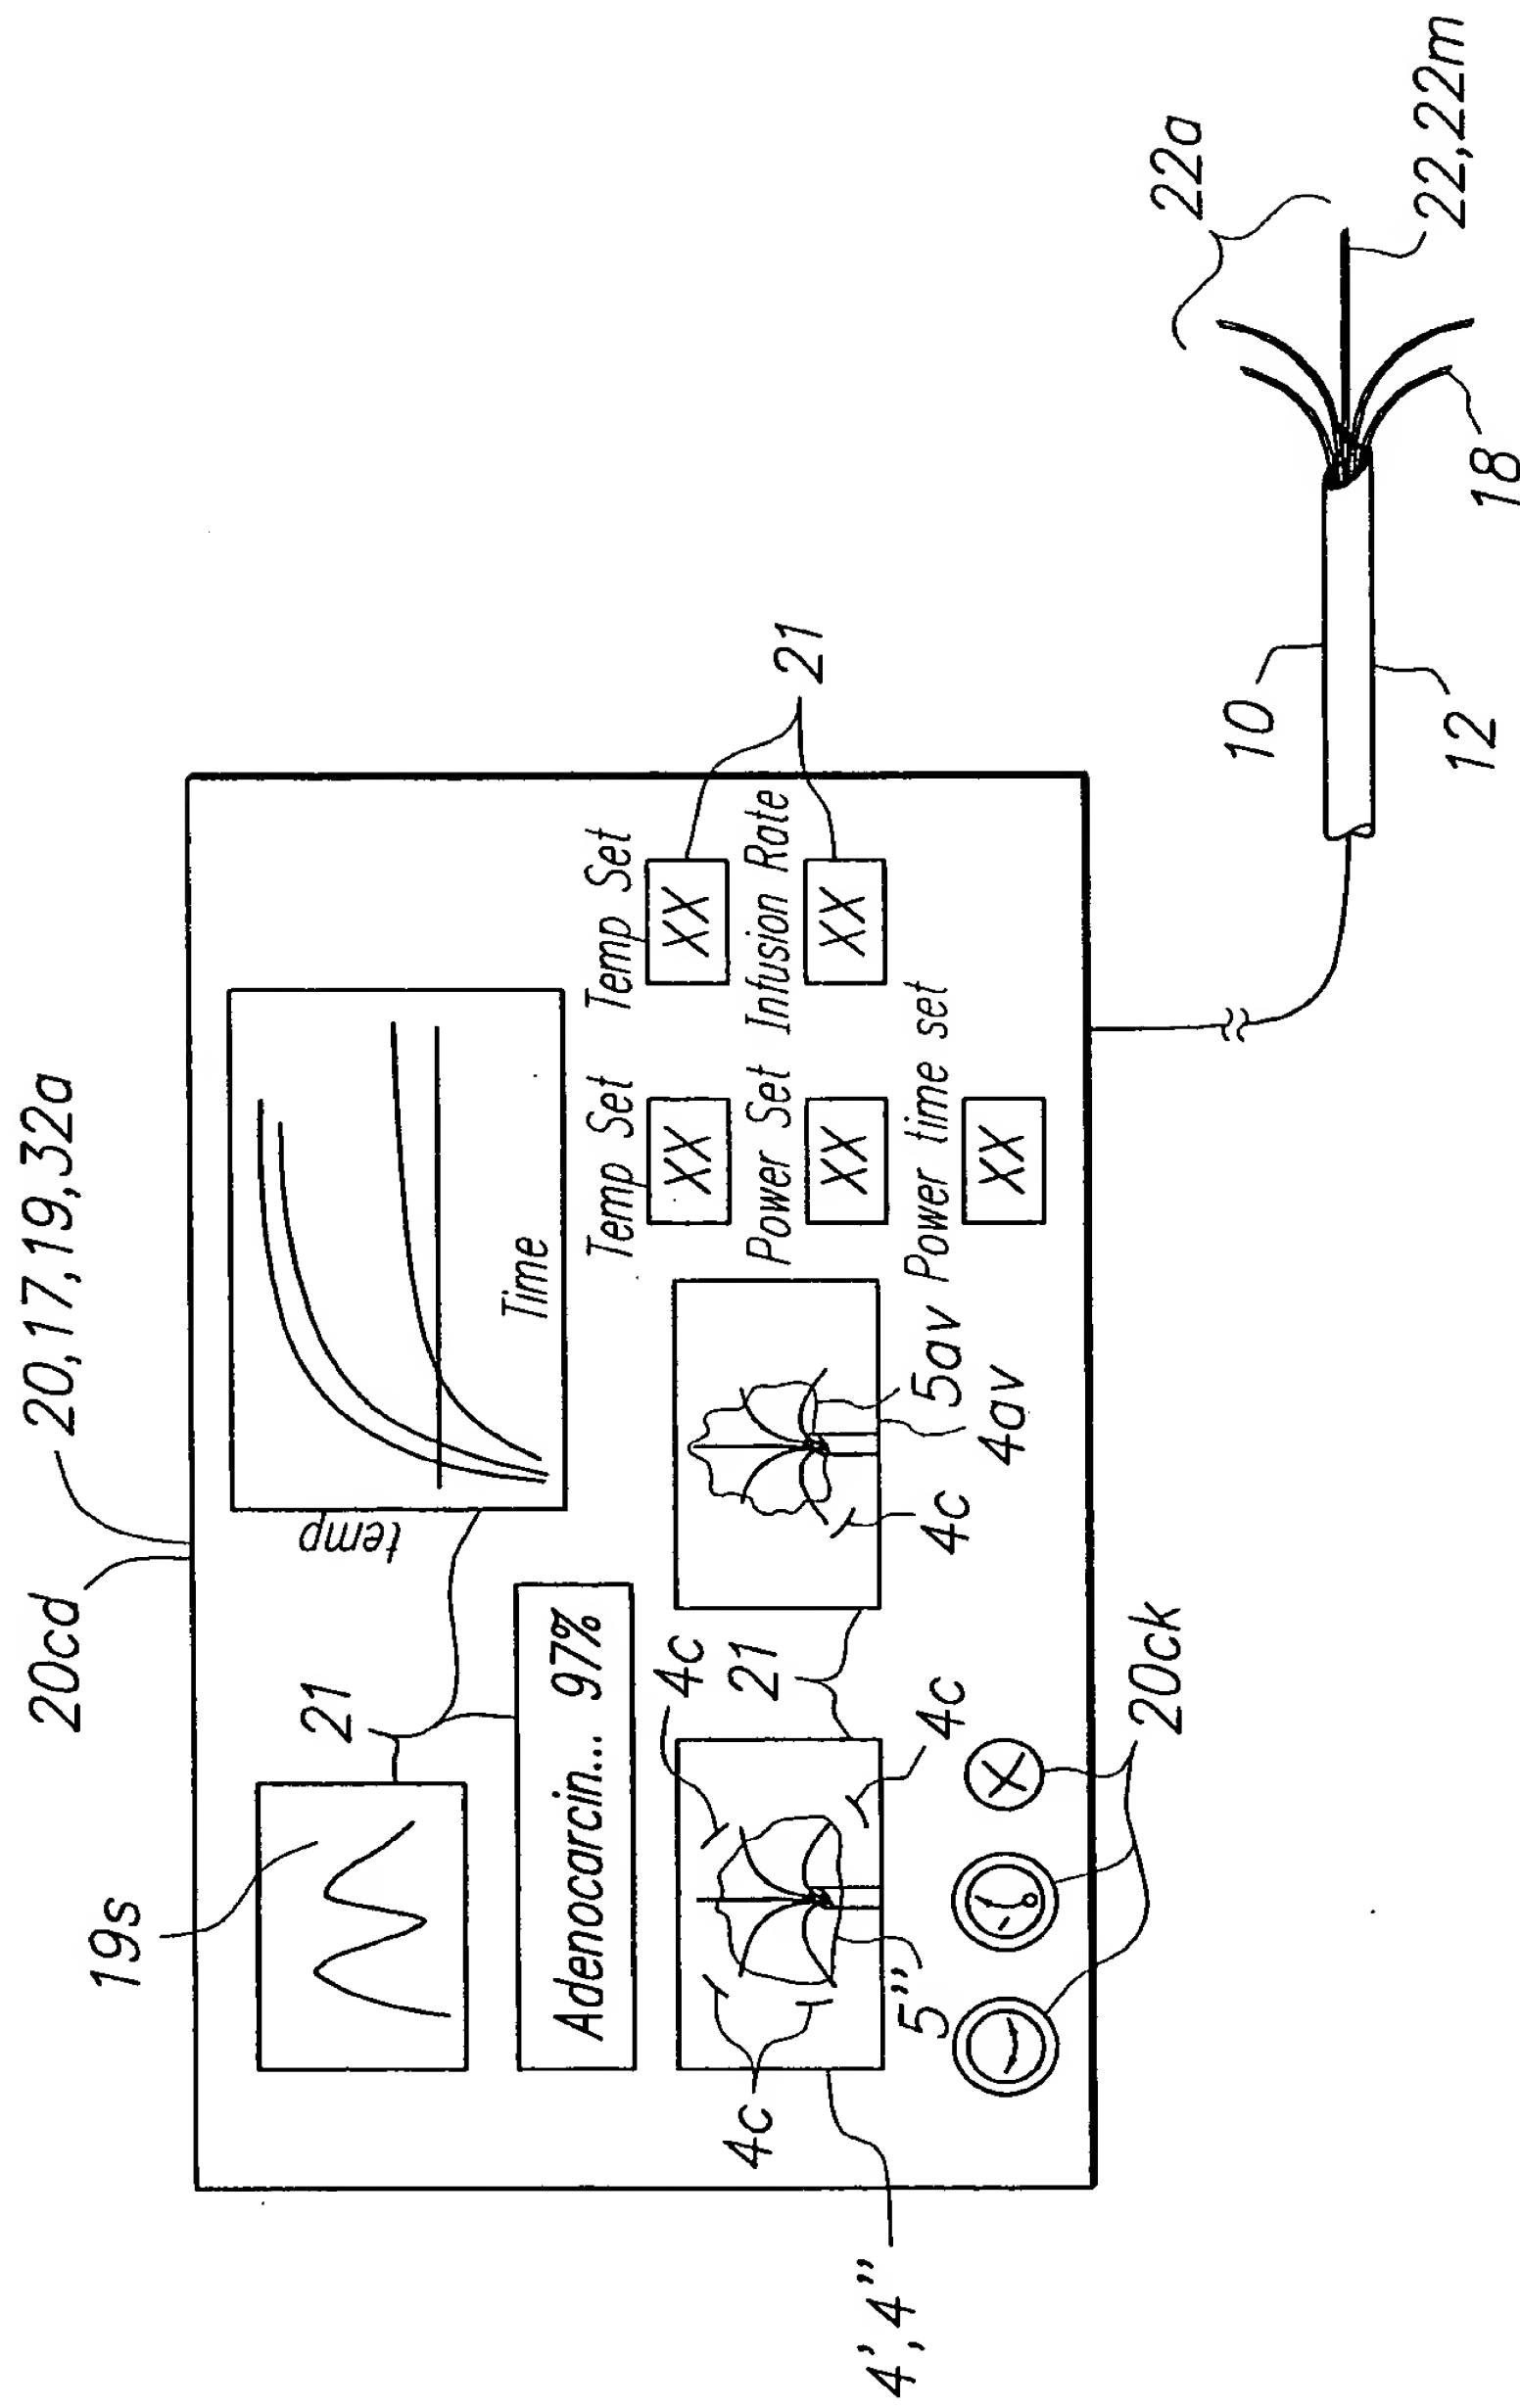


FIG. 16A

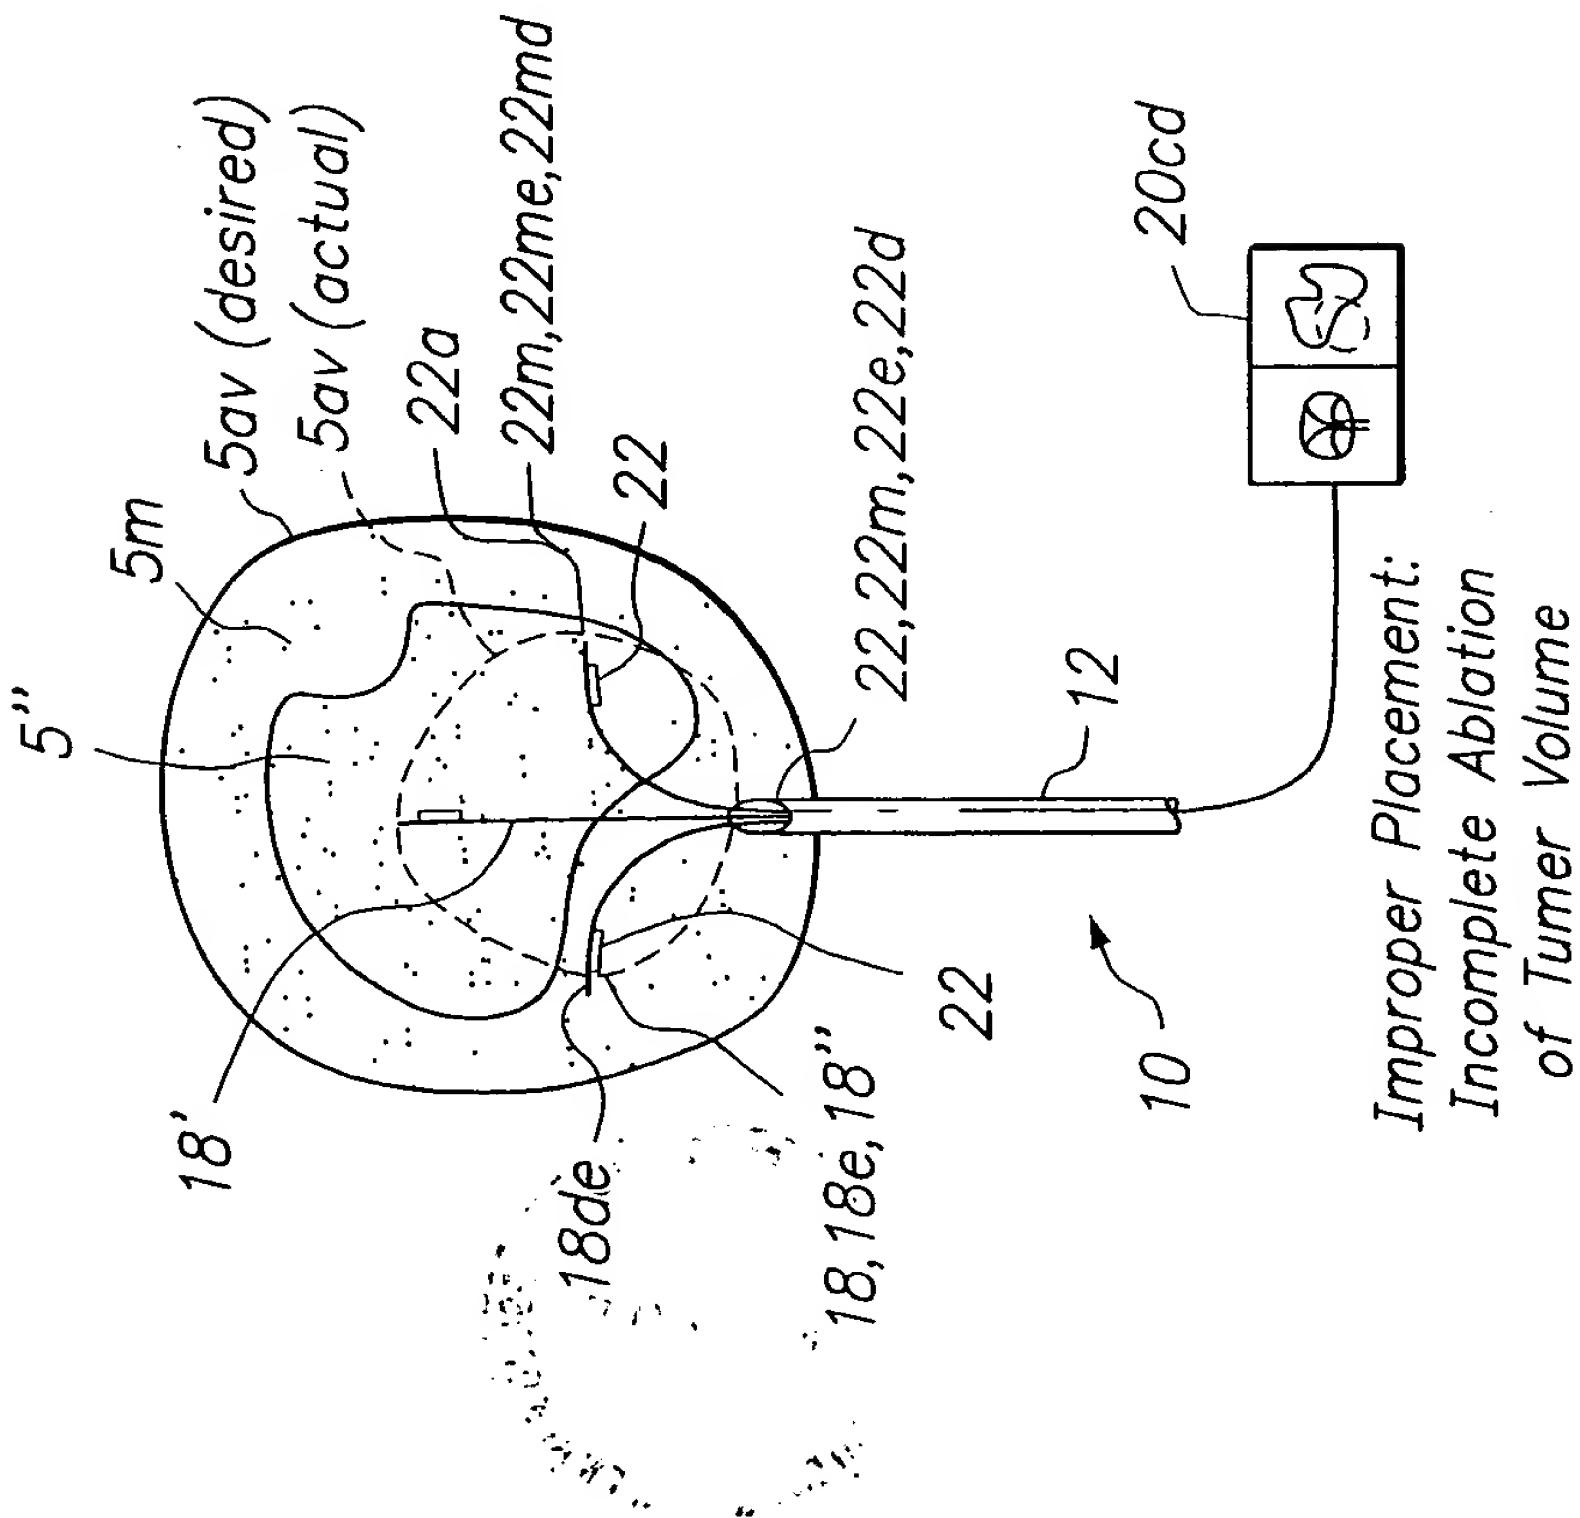


FIG. 16B

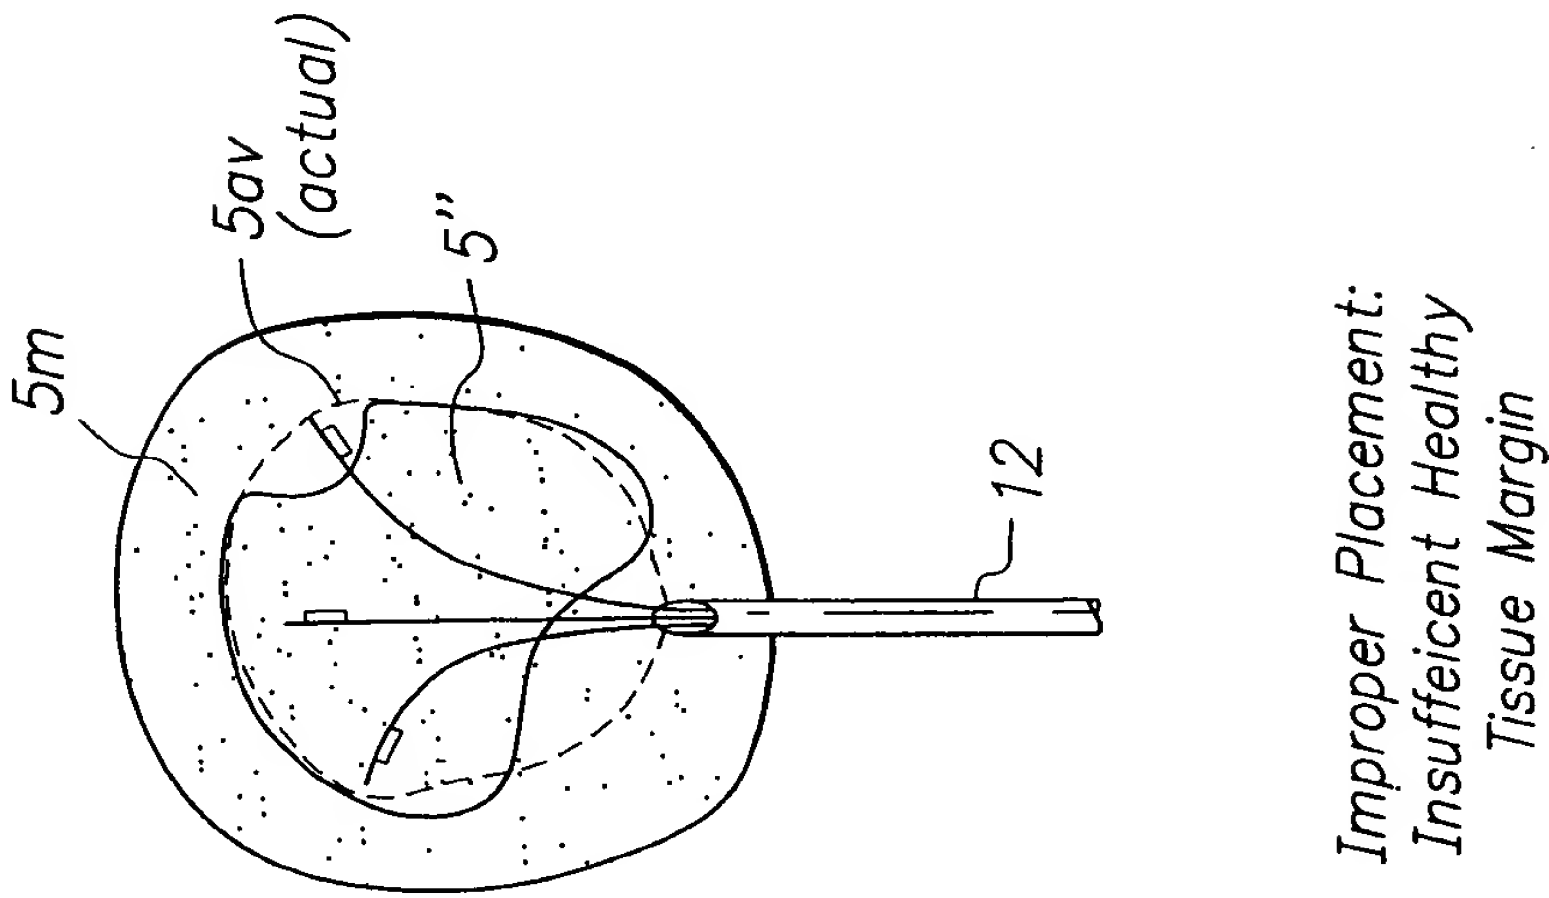


FIG. 16C



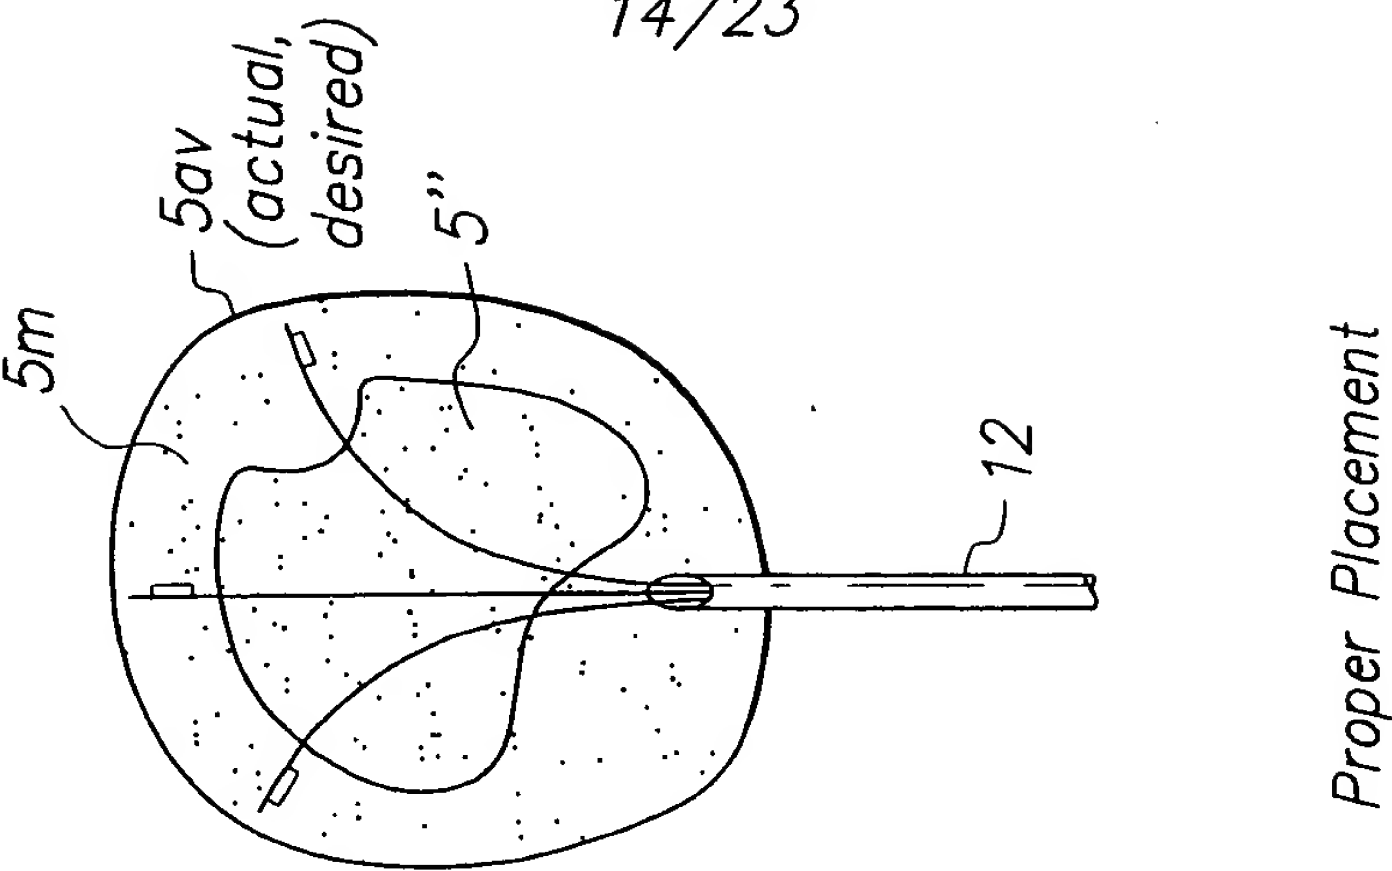


FIG. 17A

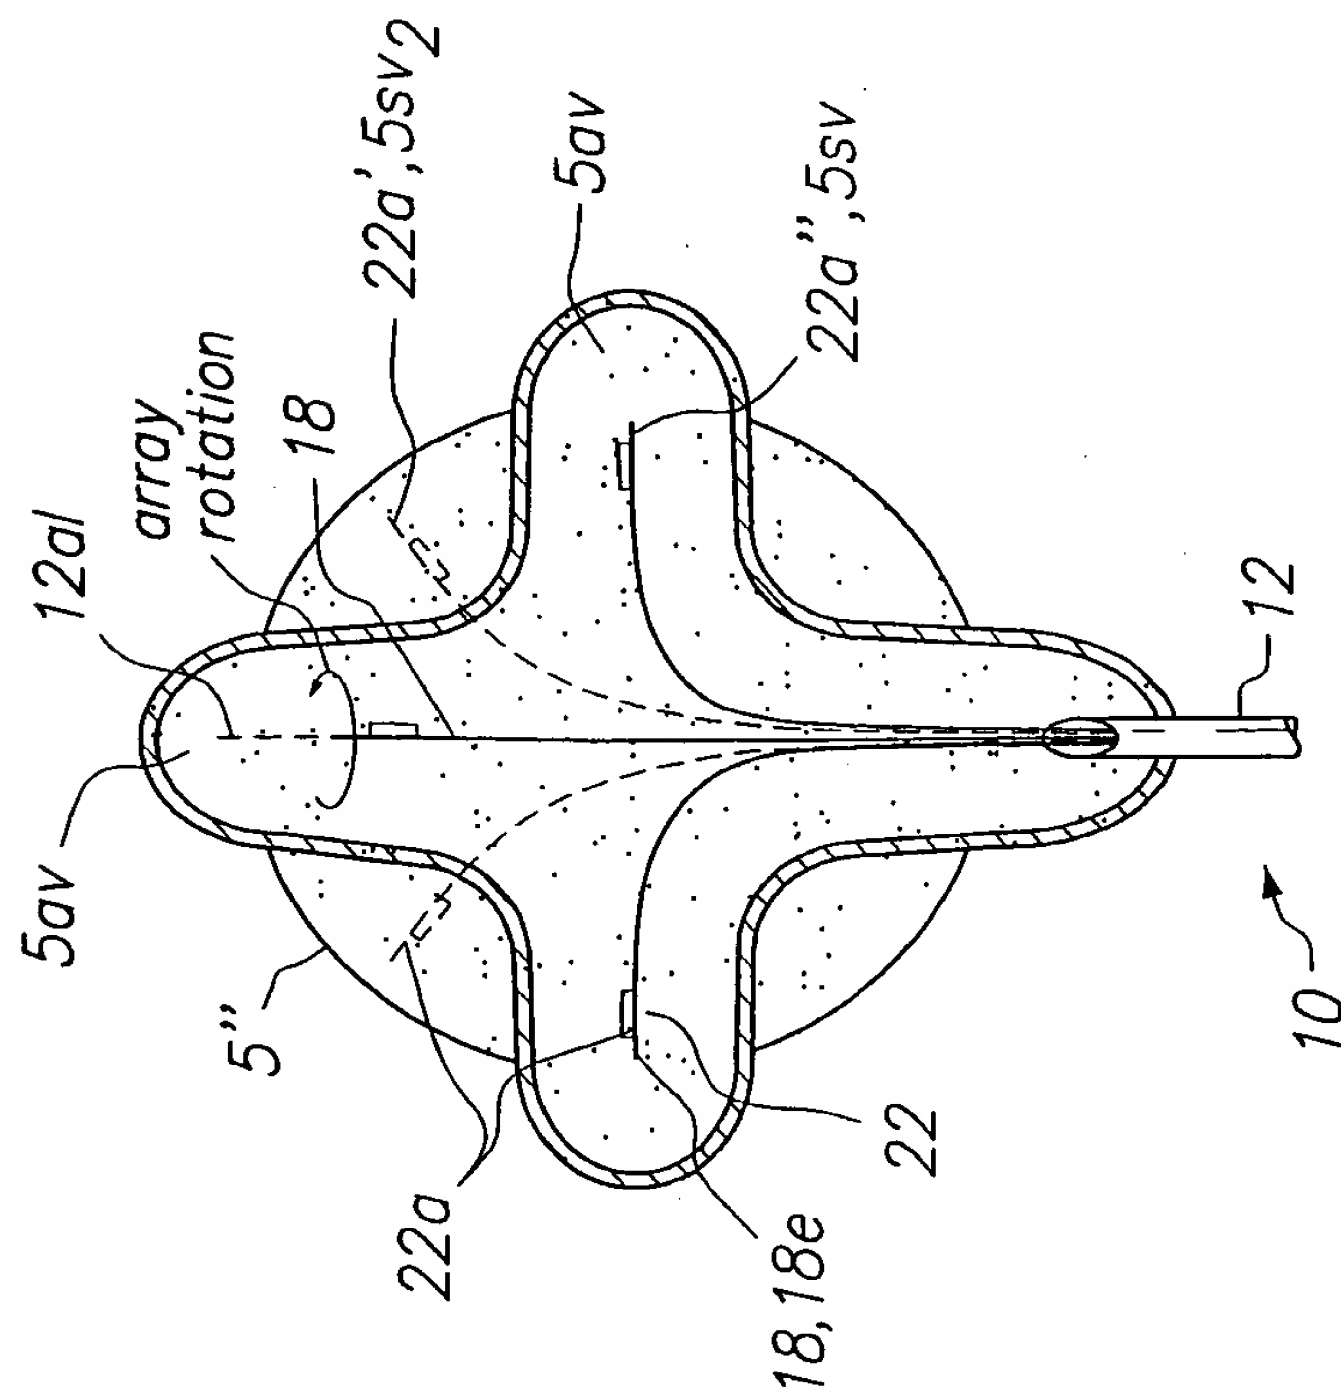

Detection of Incomplete Ablation via rotation of electrode/sensor array

FIG. 17B

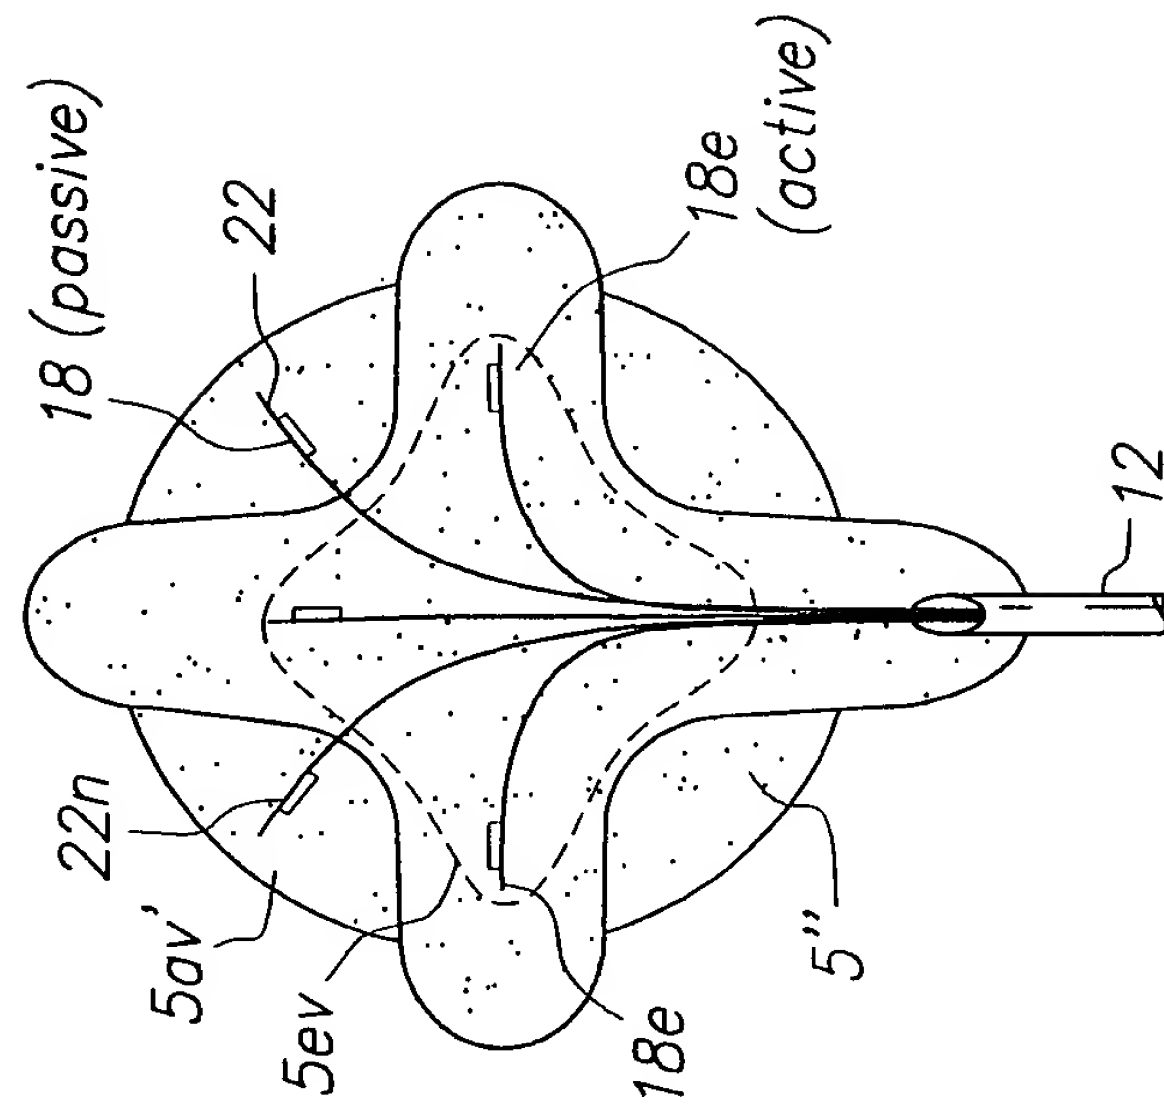

*Detection of Incomplete Ablation
Deployment of passive Resilient Members 18
of Sensing Members 22m*

FIG. 18A

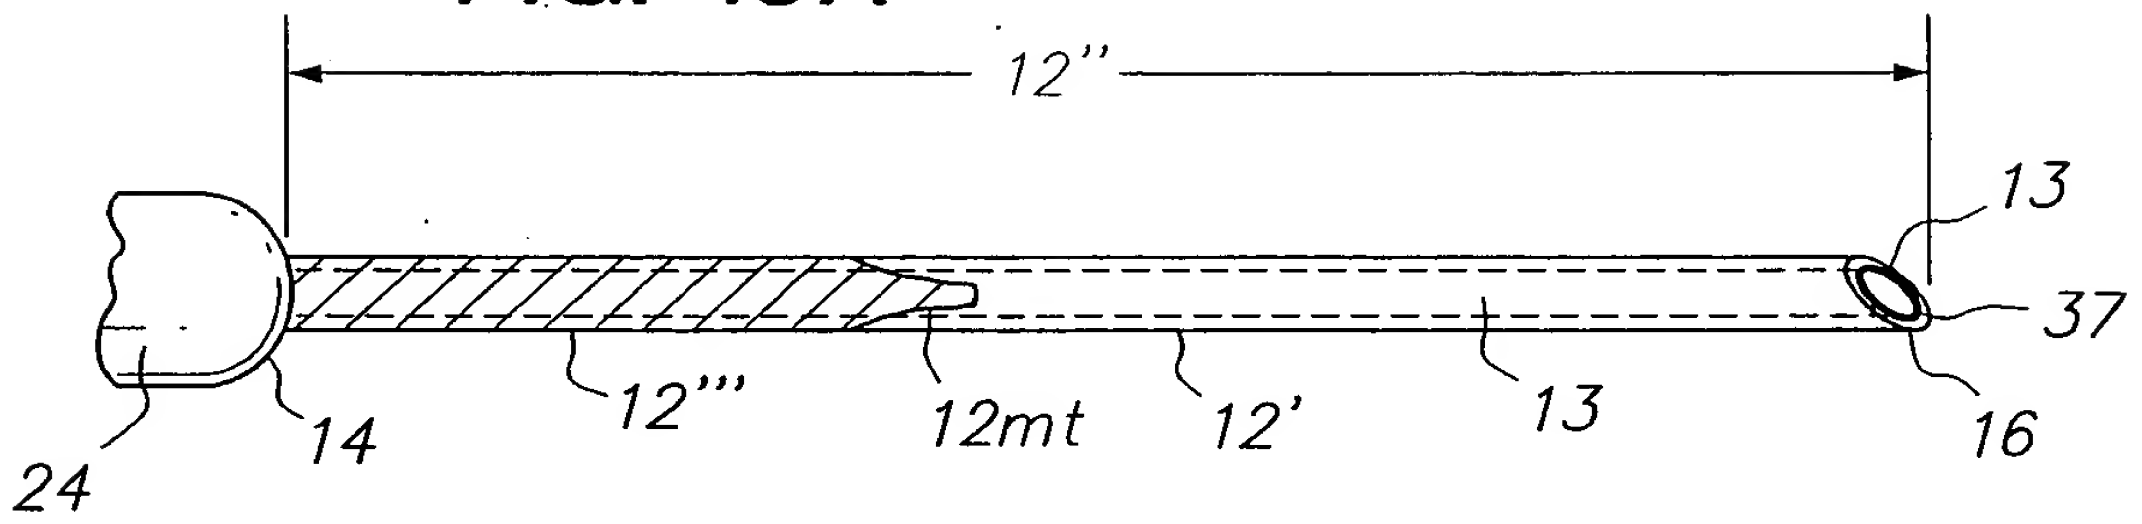


FIG. 18B

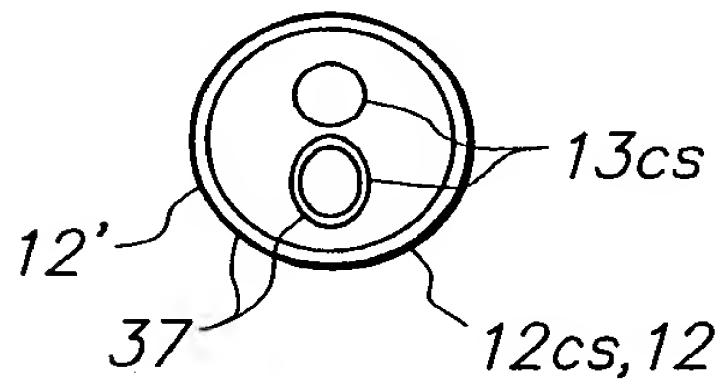


FIG. 18C

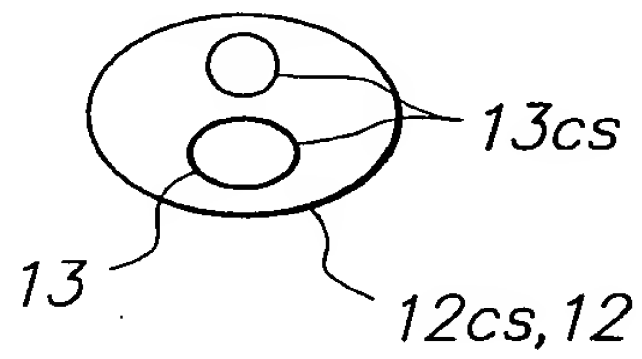


FIG. 19

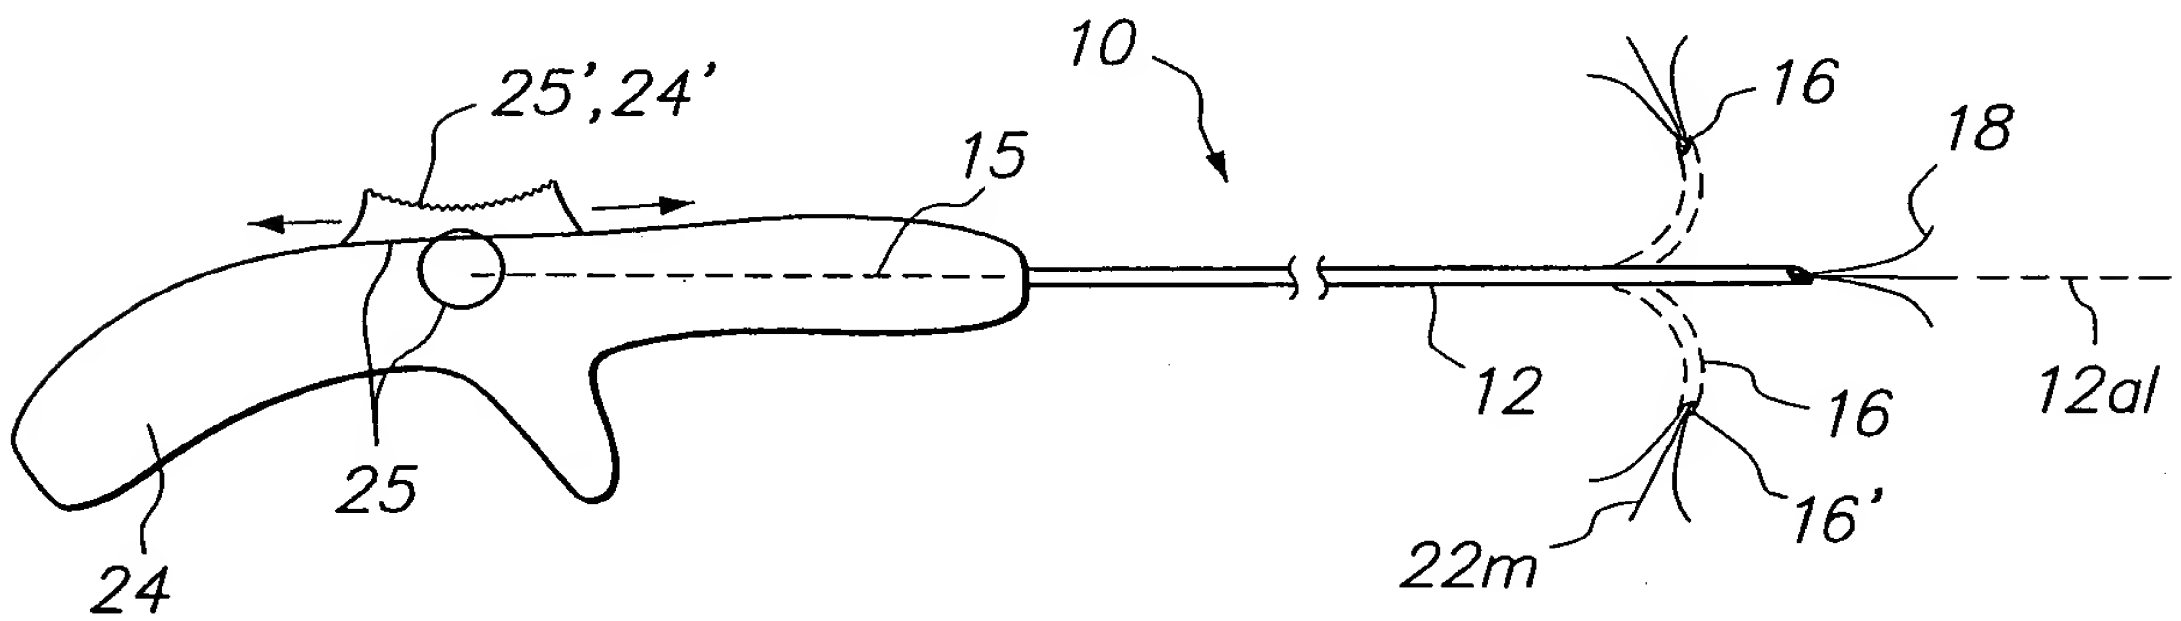
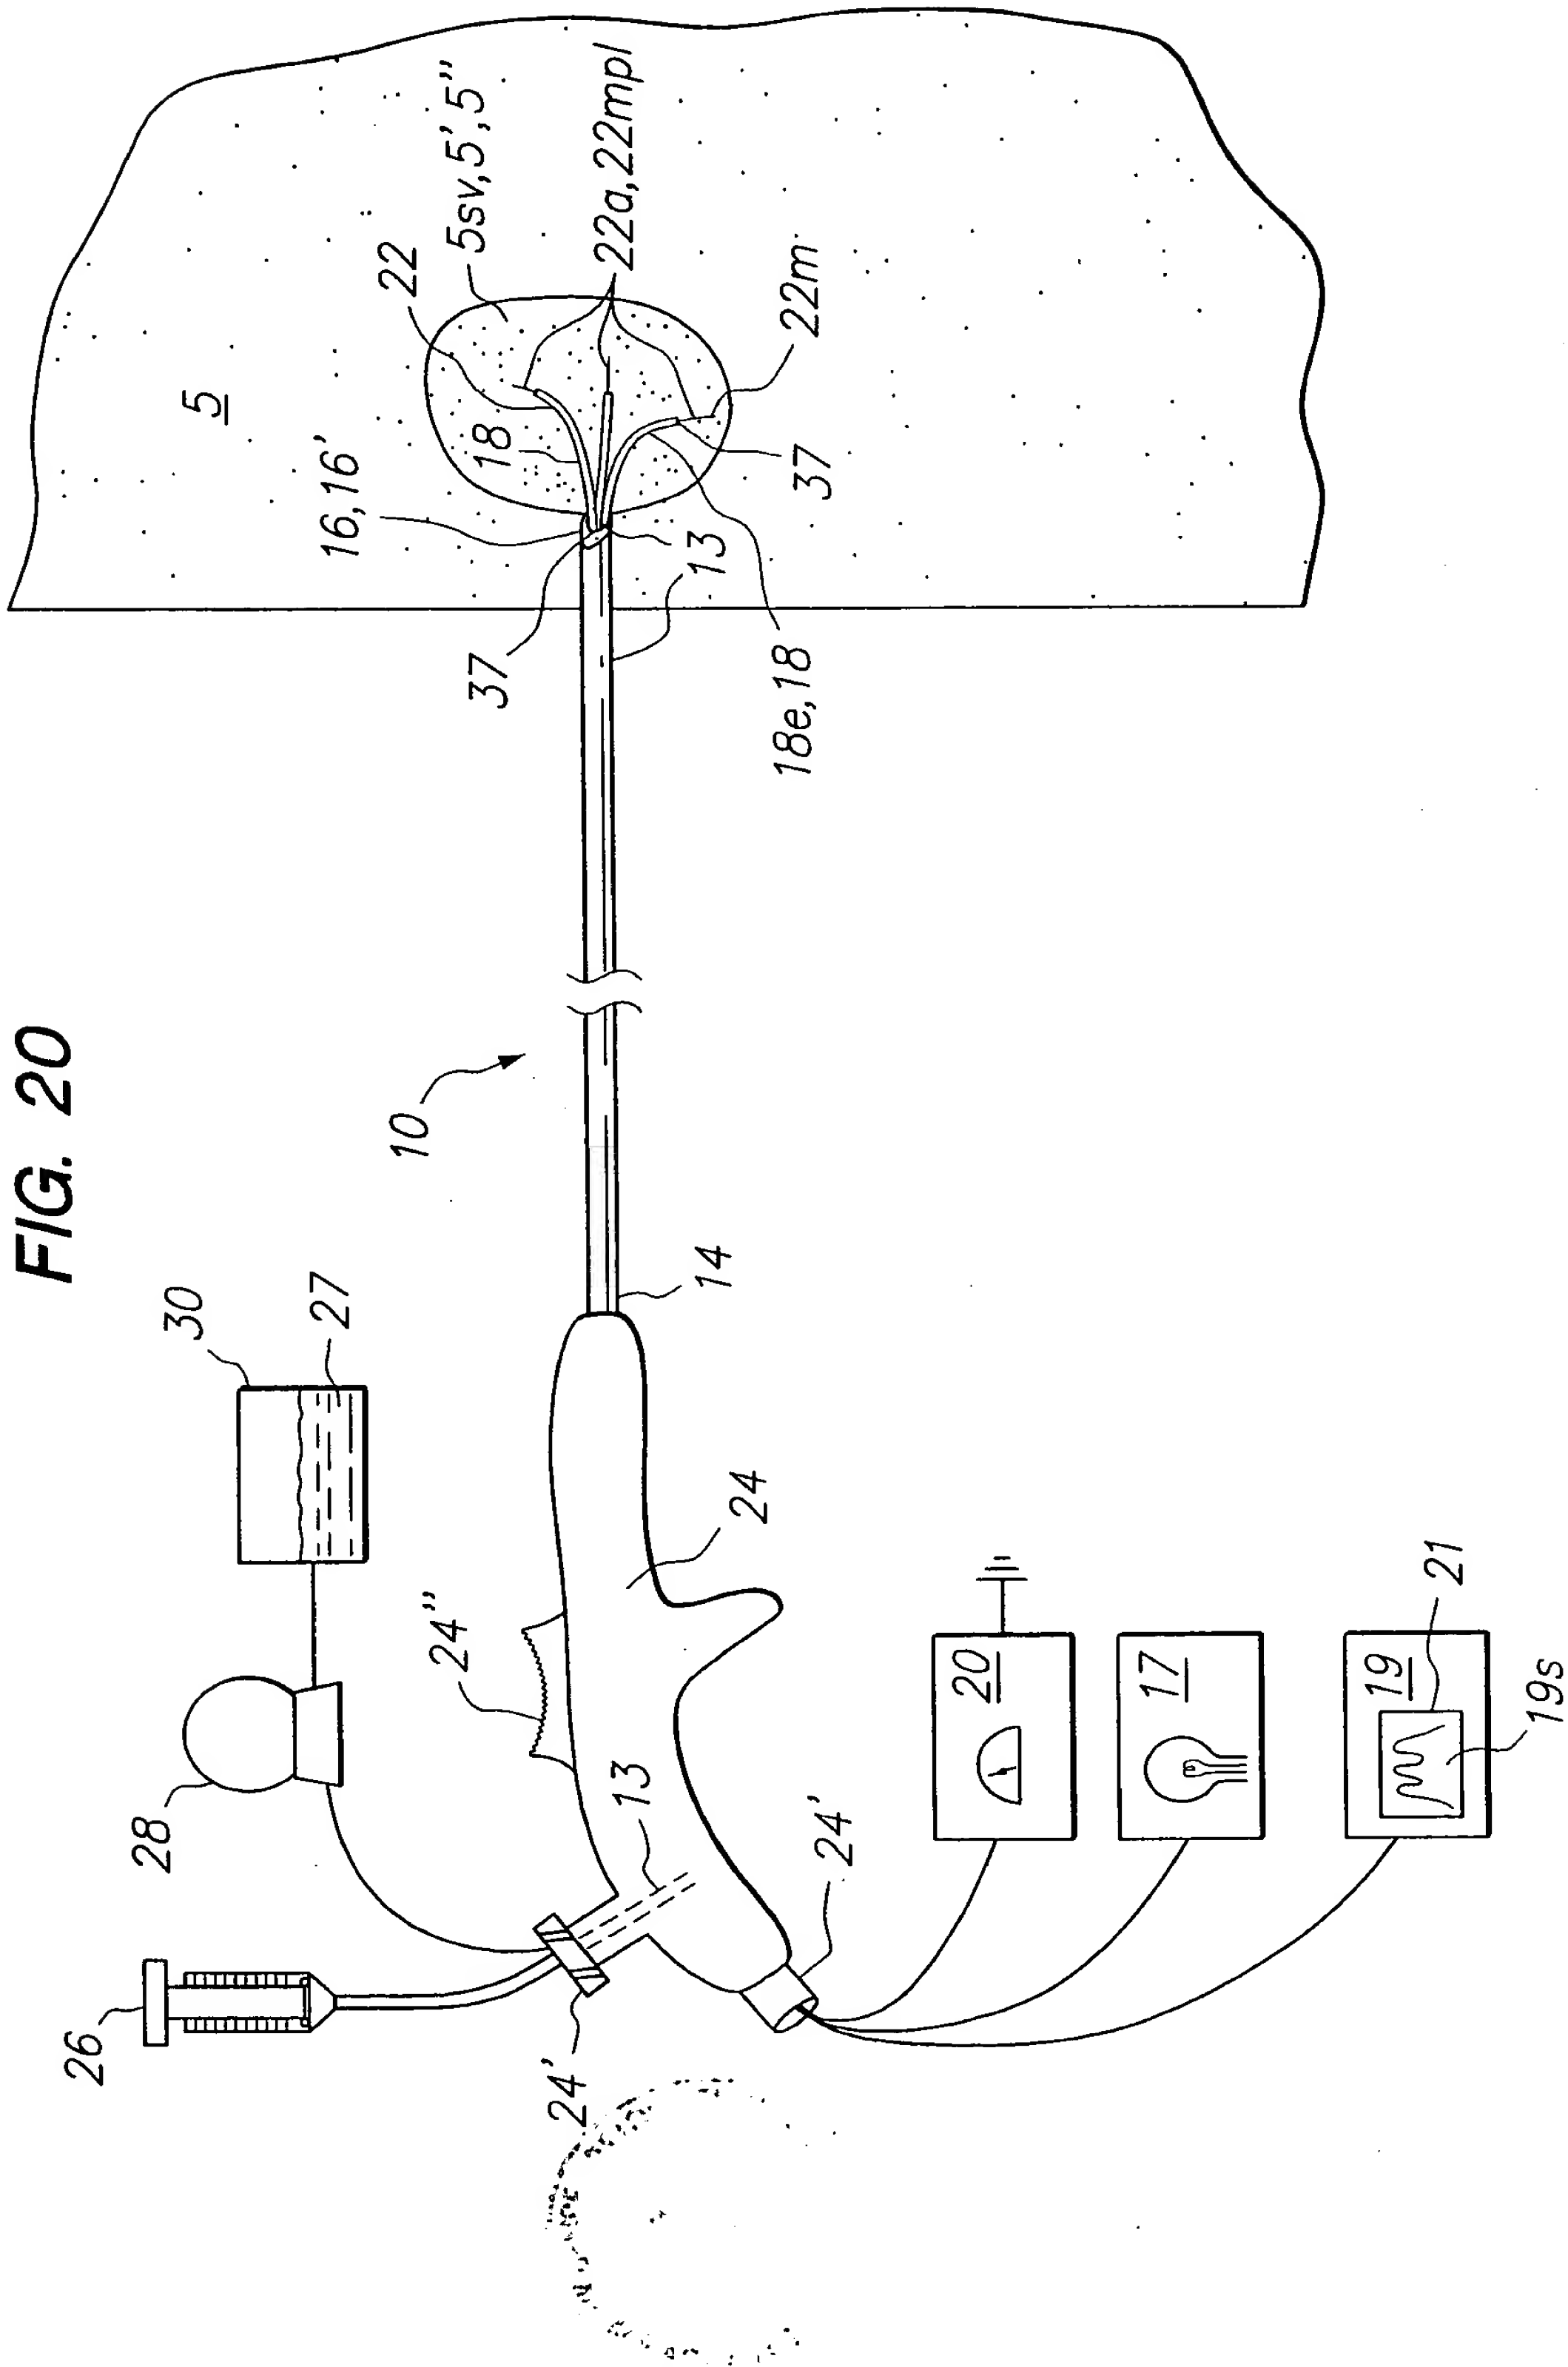


FIG. 20



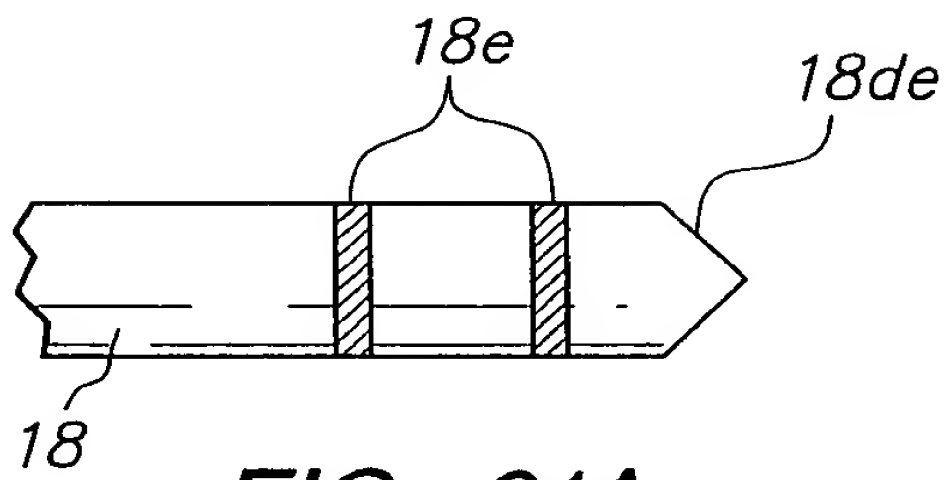


FIG. 21A

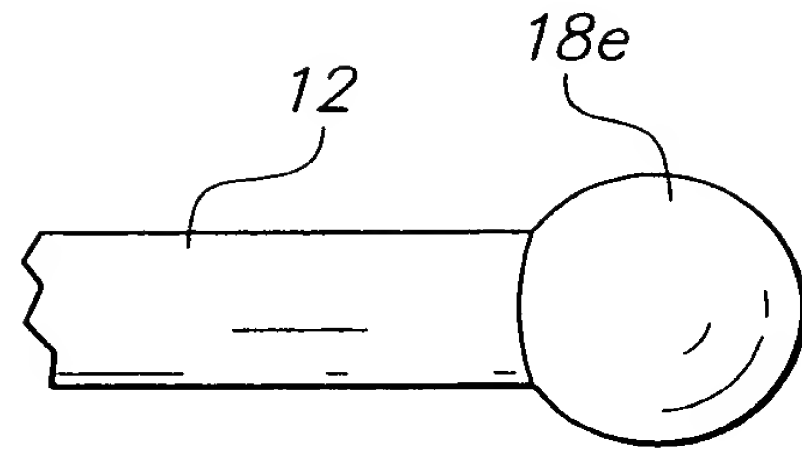


FIG. 21B

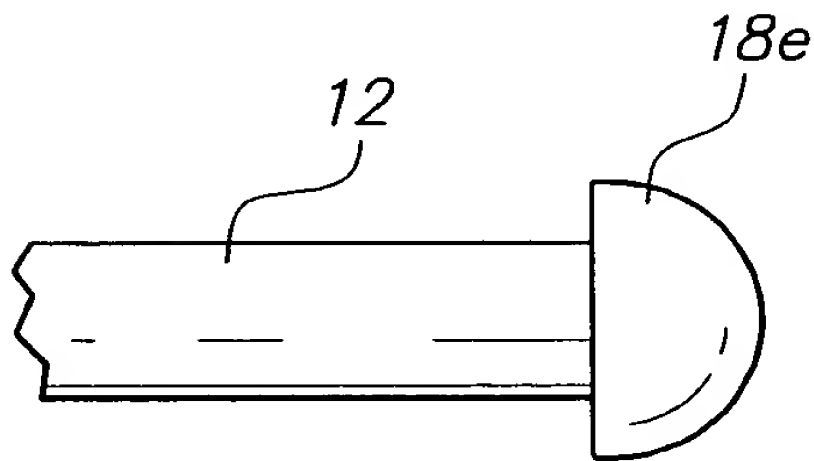


FIG. 21C

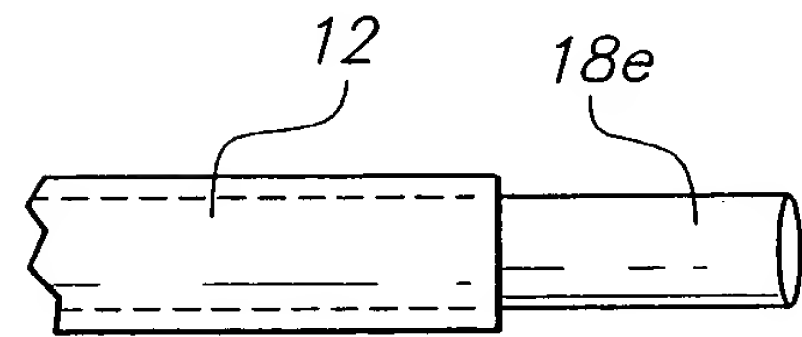


FIG. 21D

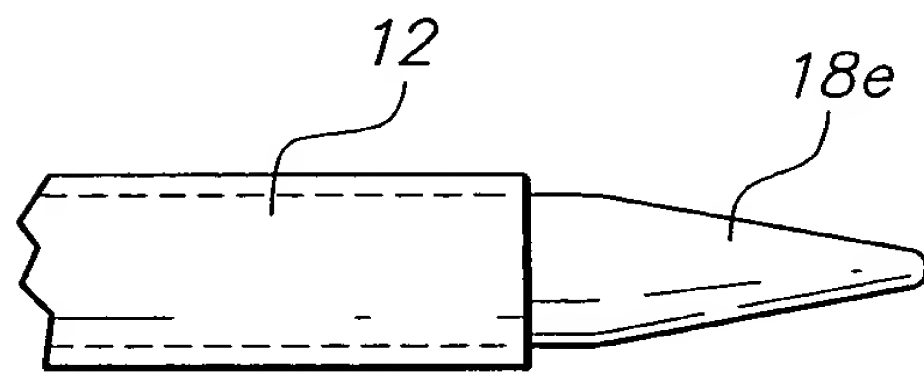


FIG. 21E

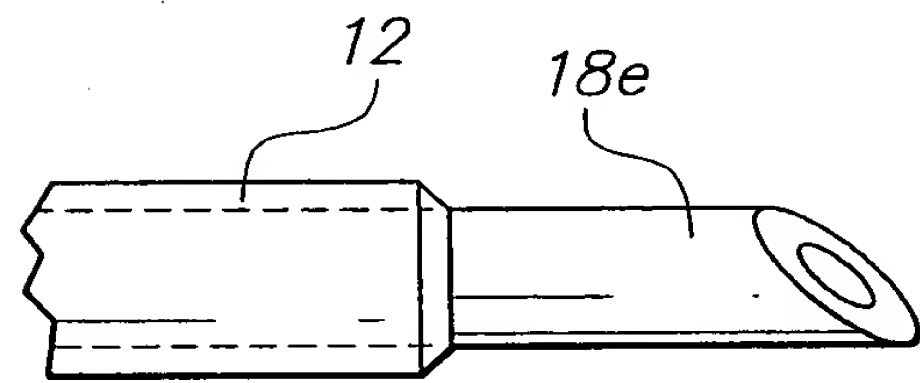


FIG. 21F

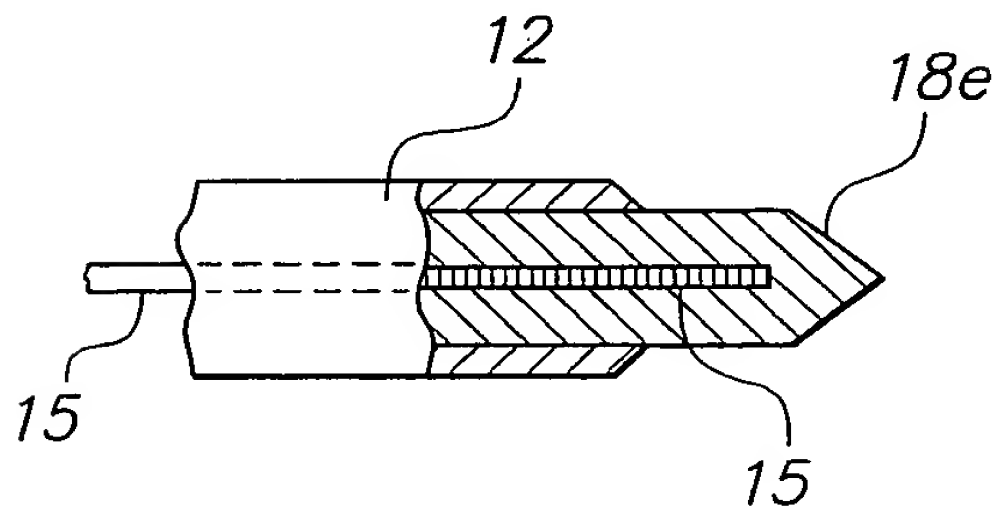


FIG. 21G




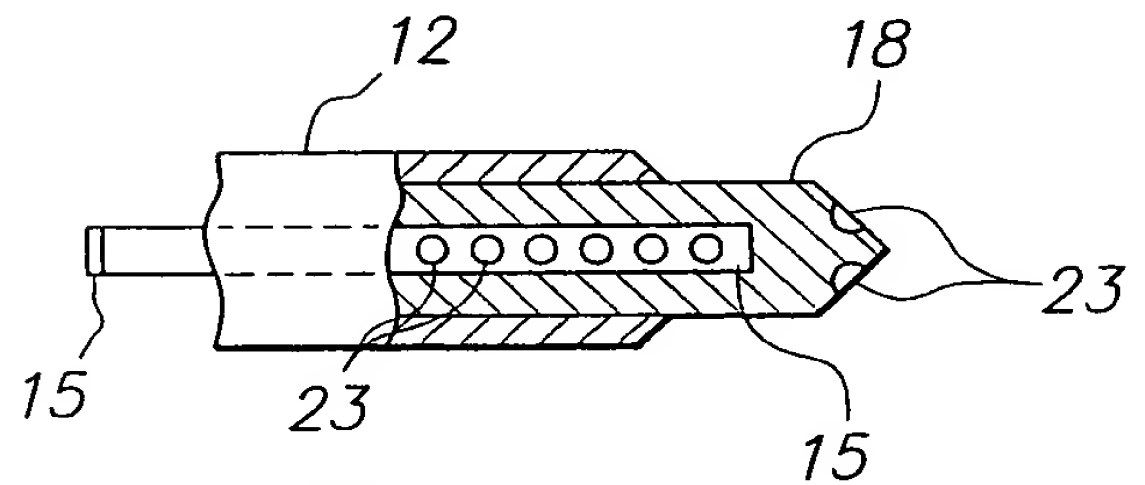


FIG. 21H

FIG. 21A

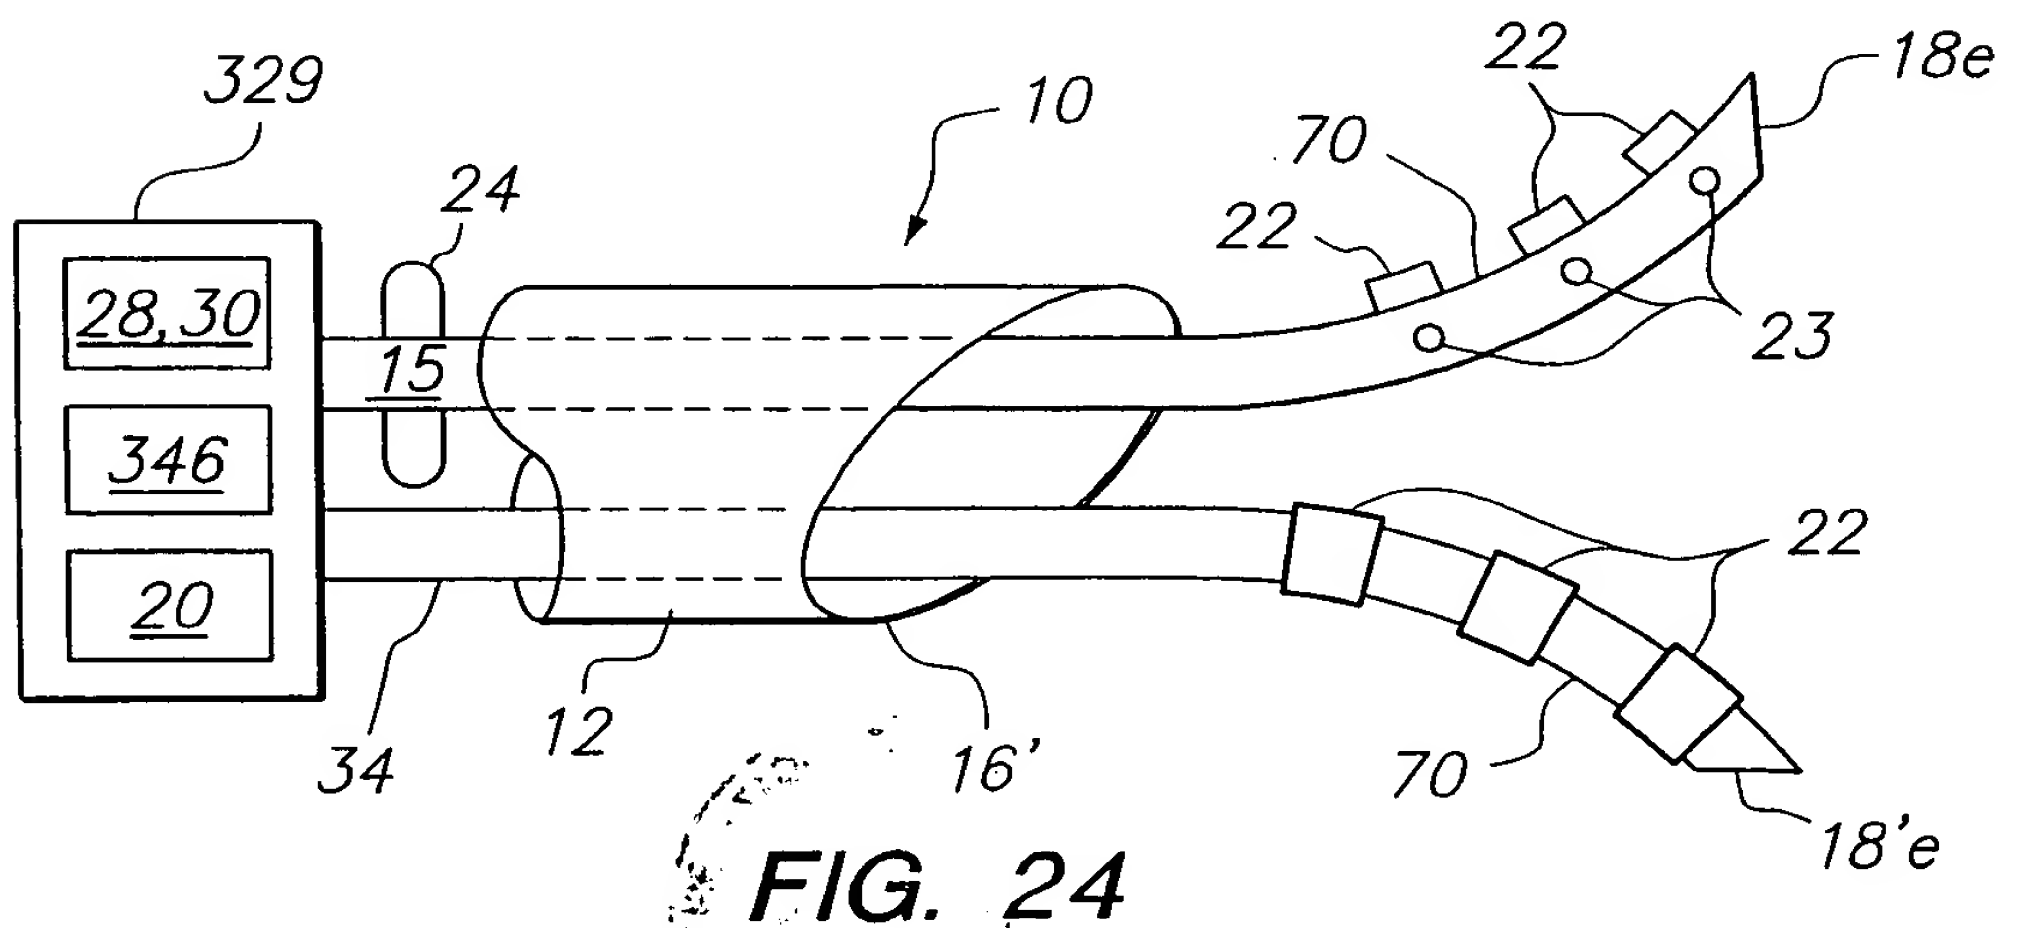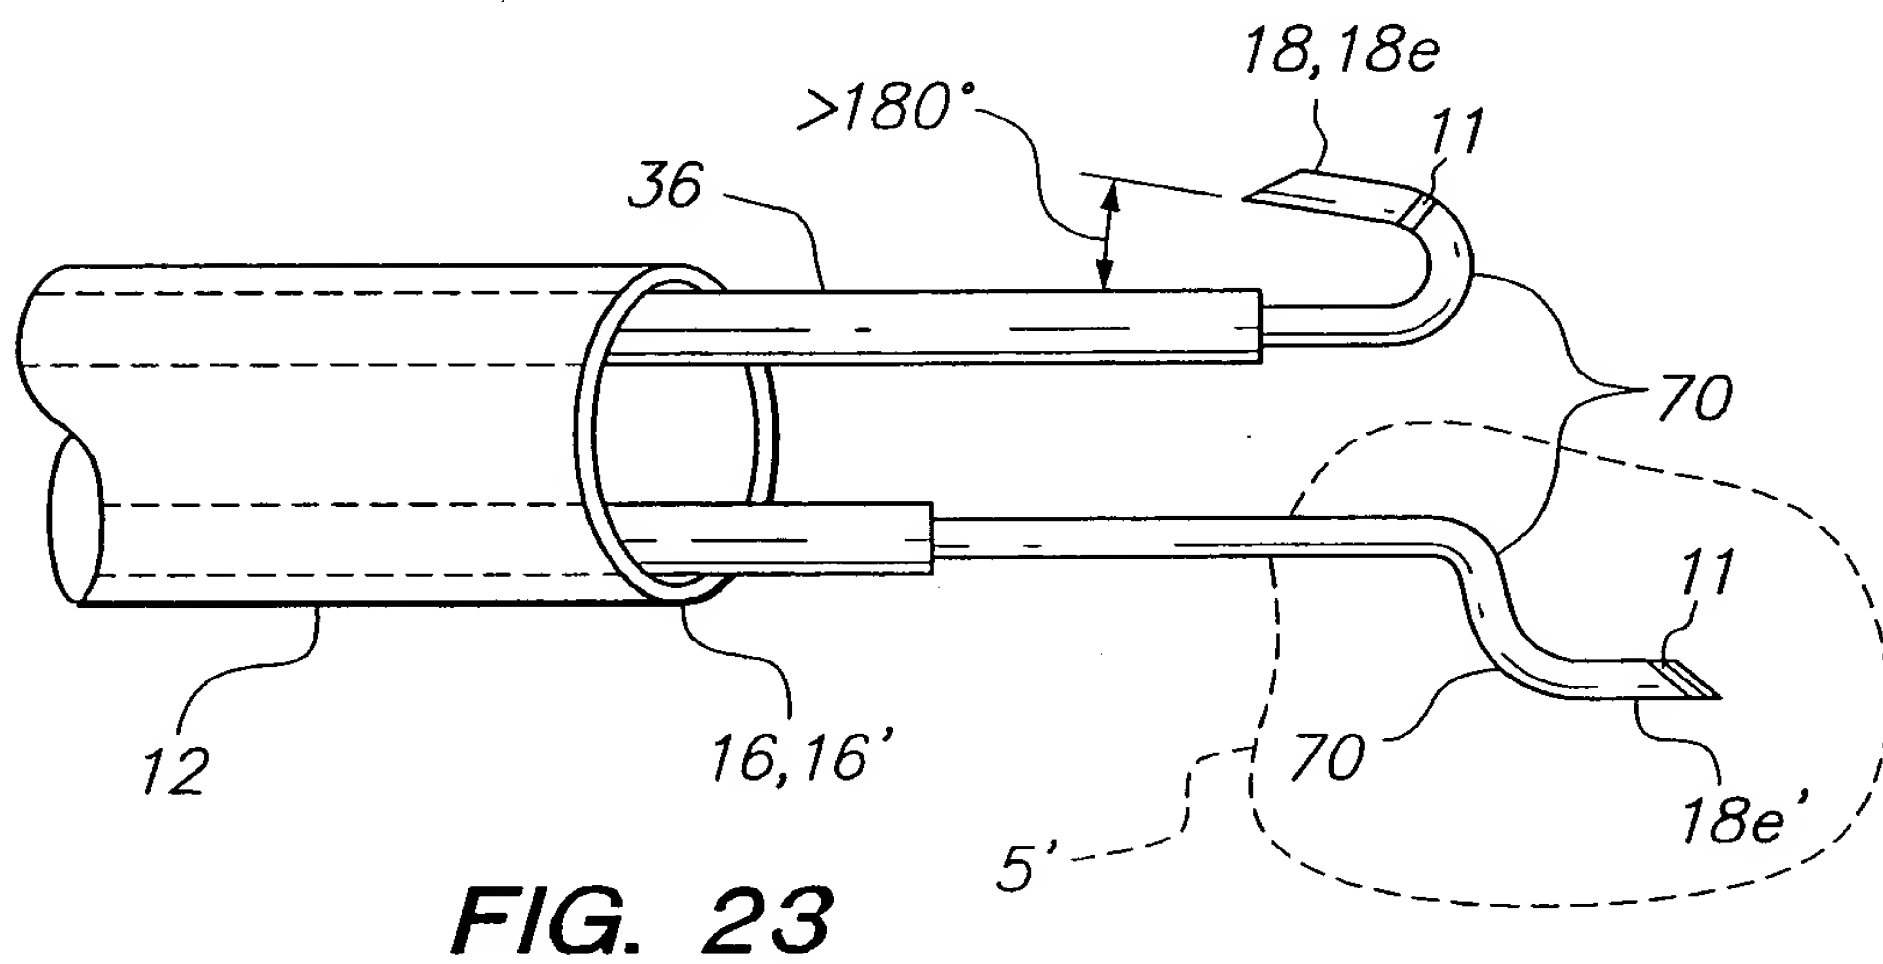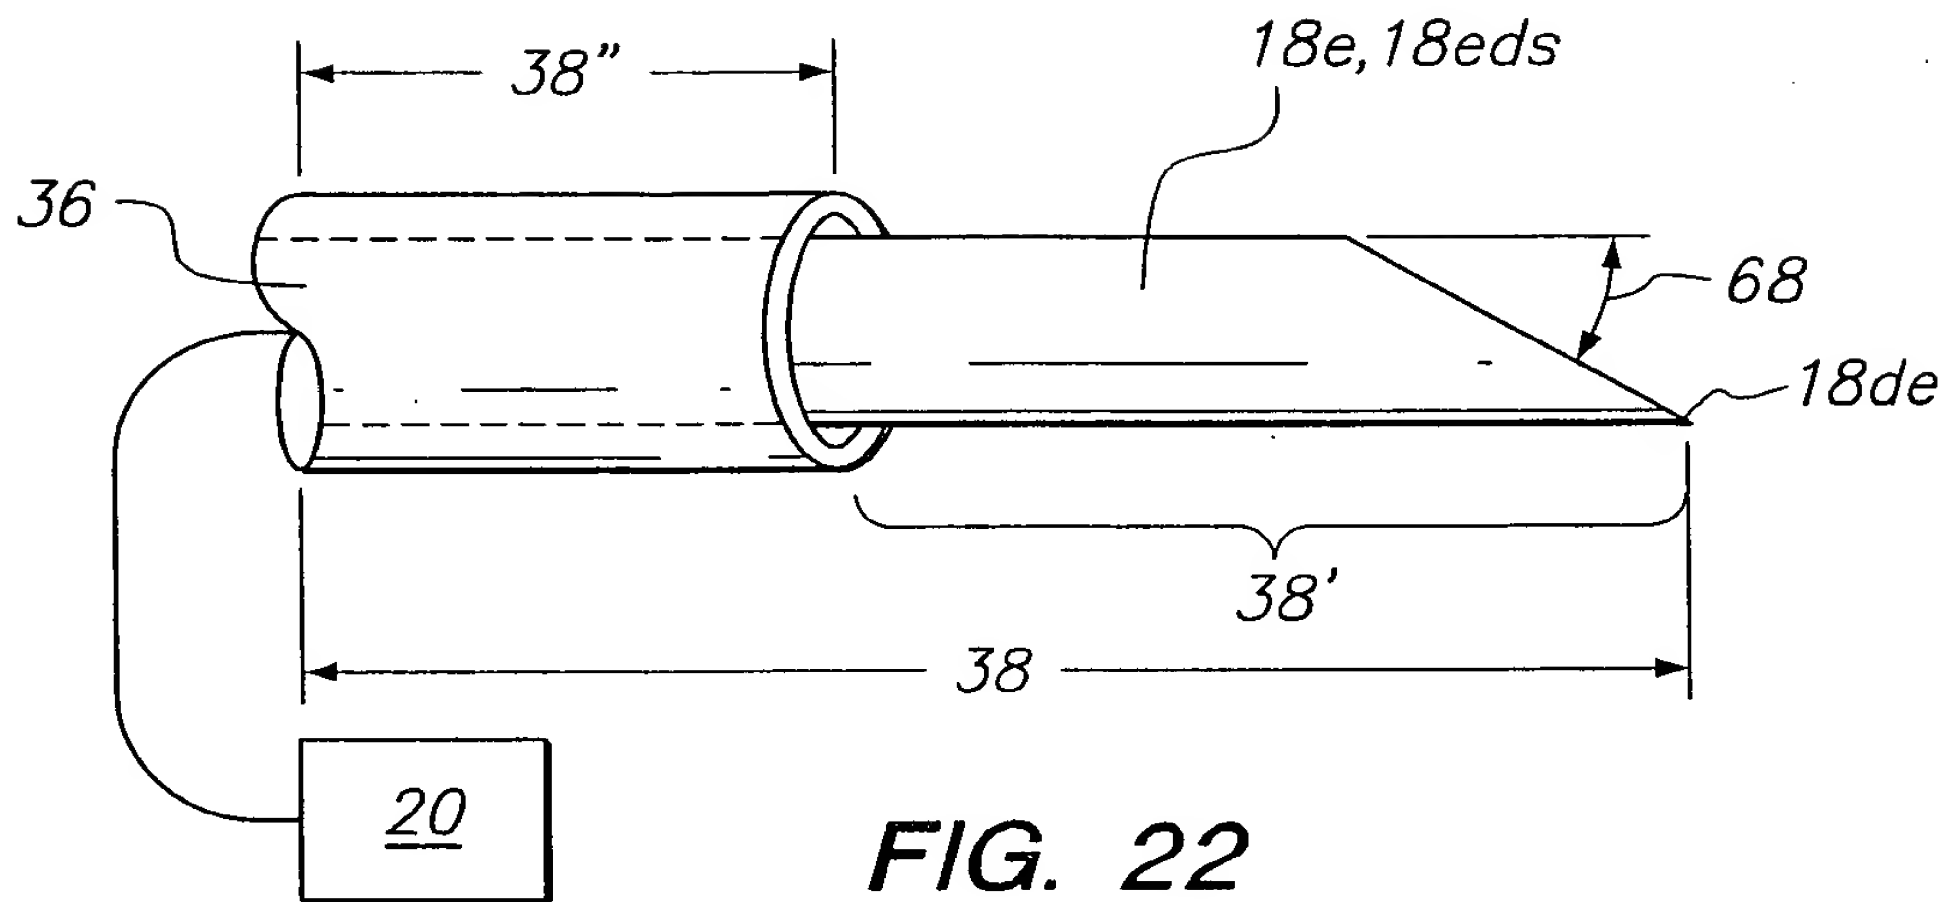

19/23



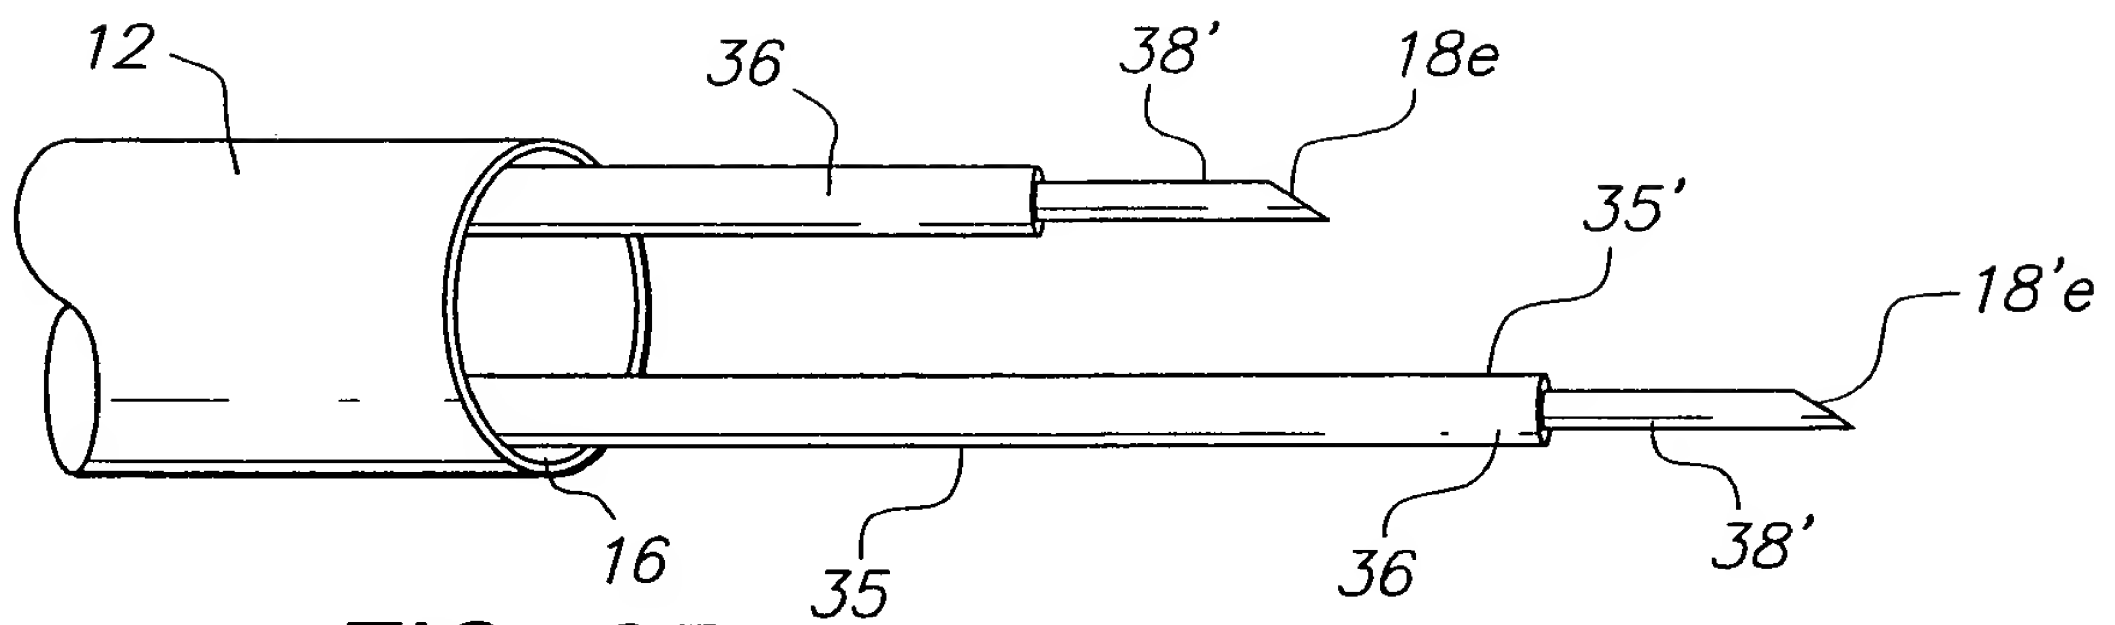


FIG. 25

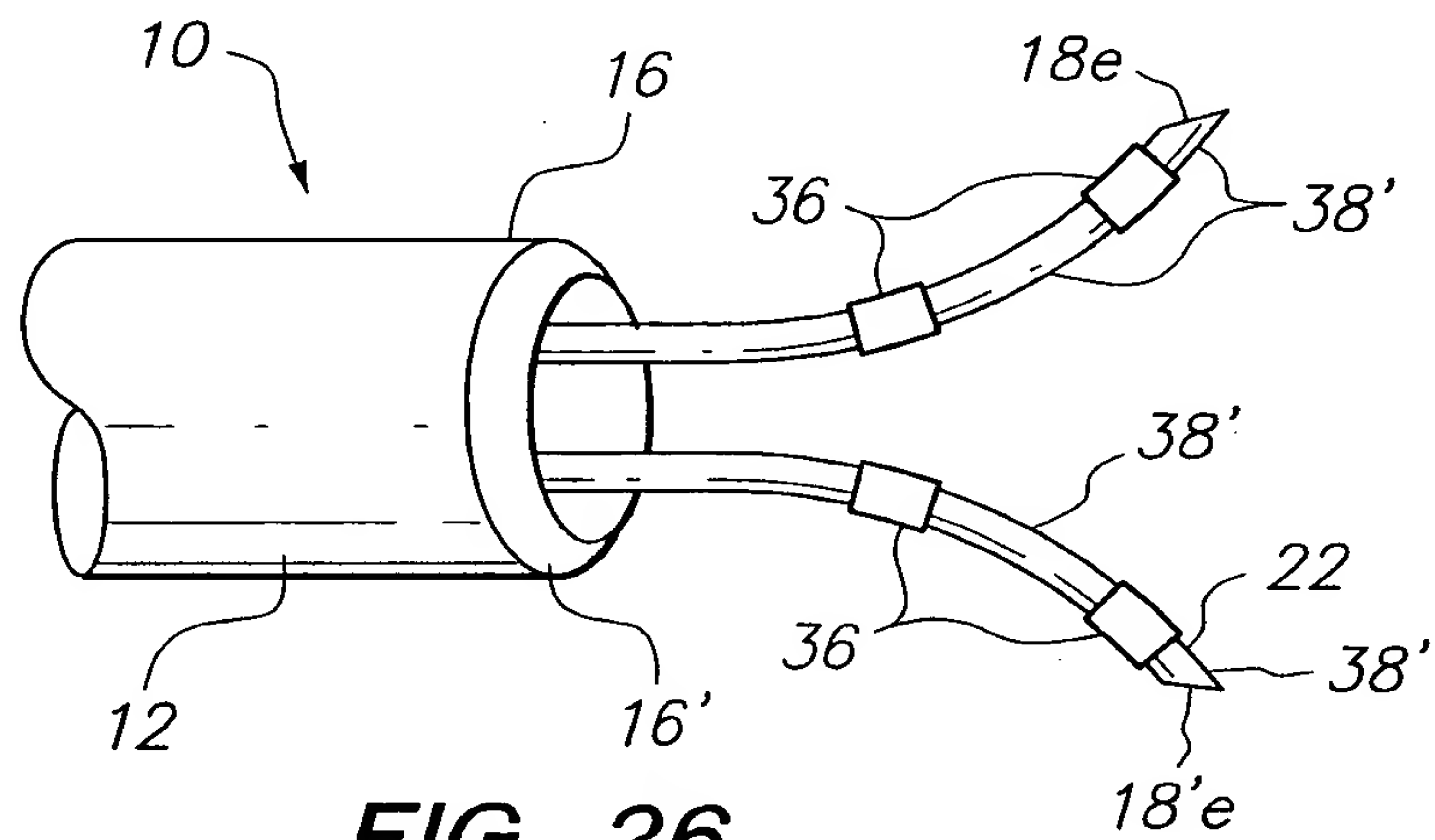


FIG. 26

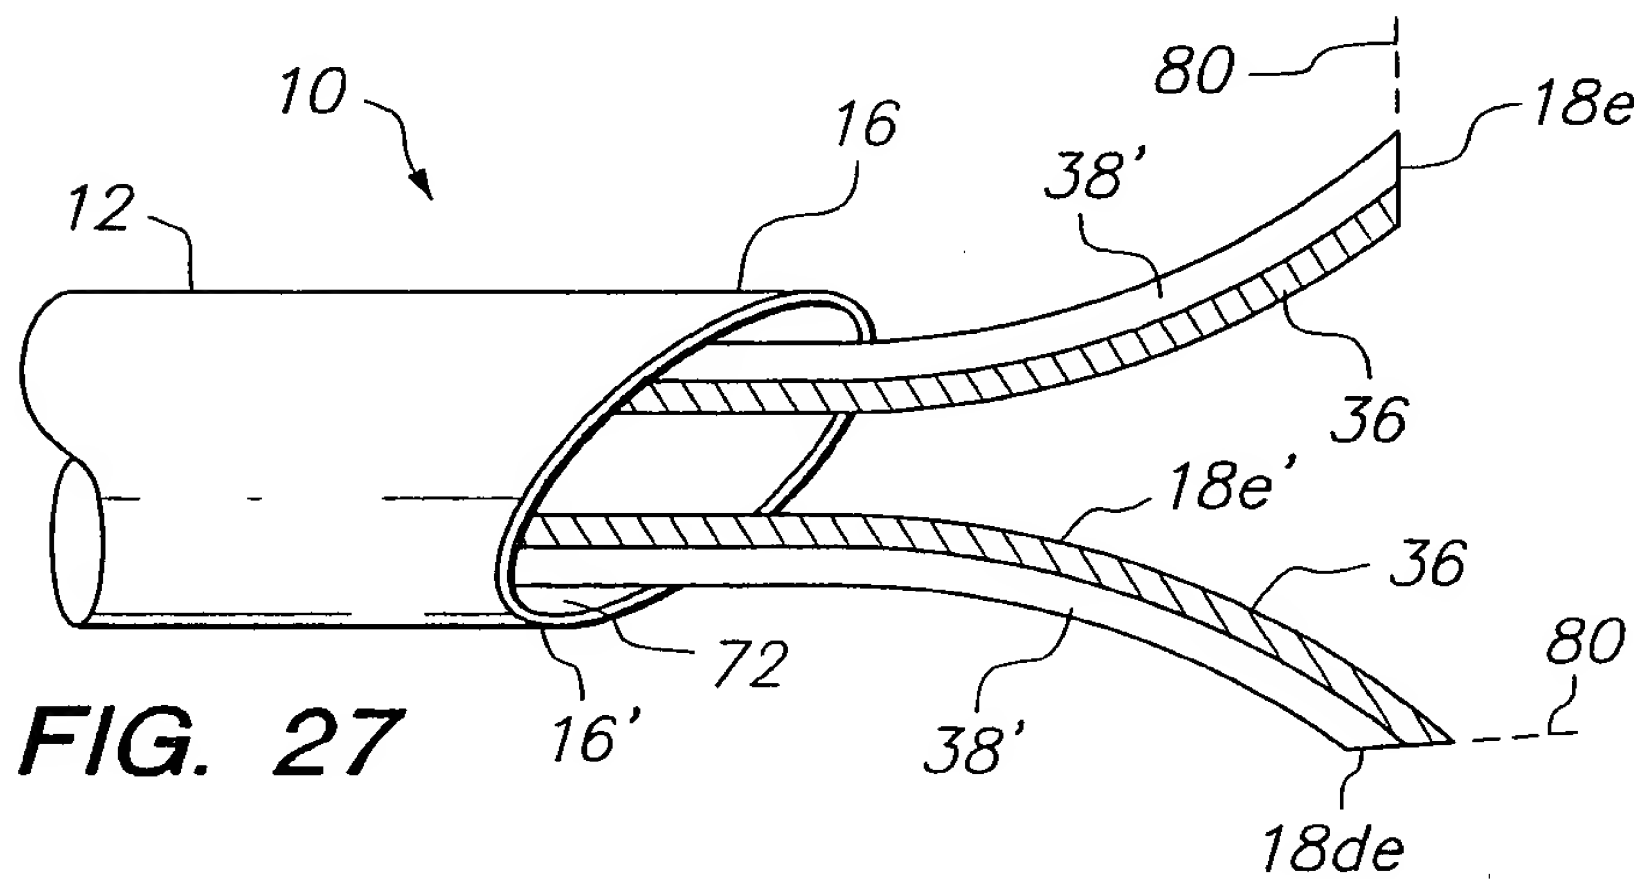


FIG. 27

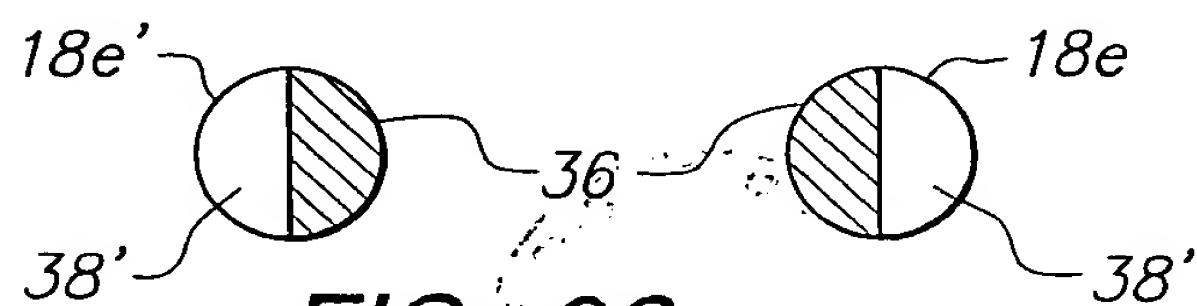


FIG. 28

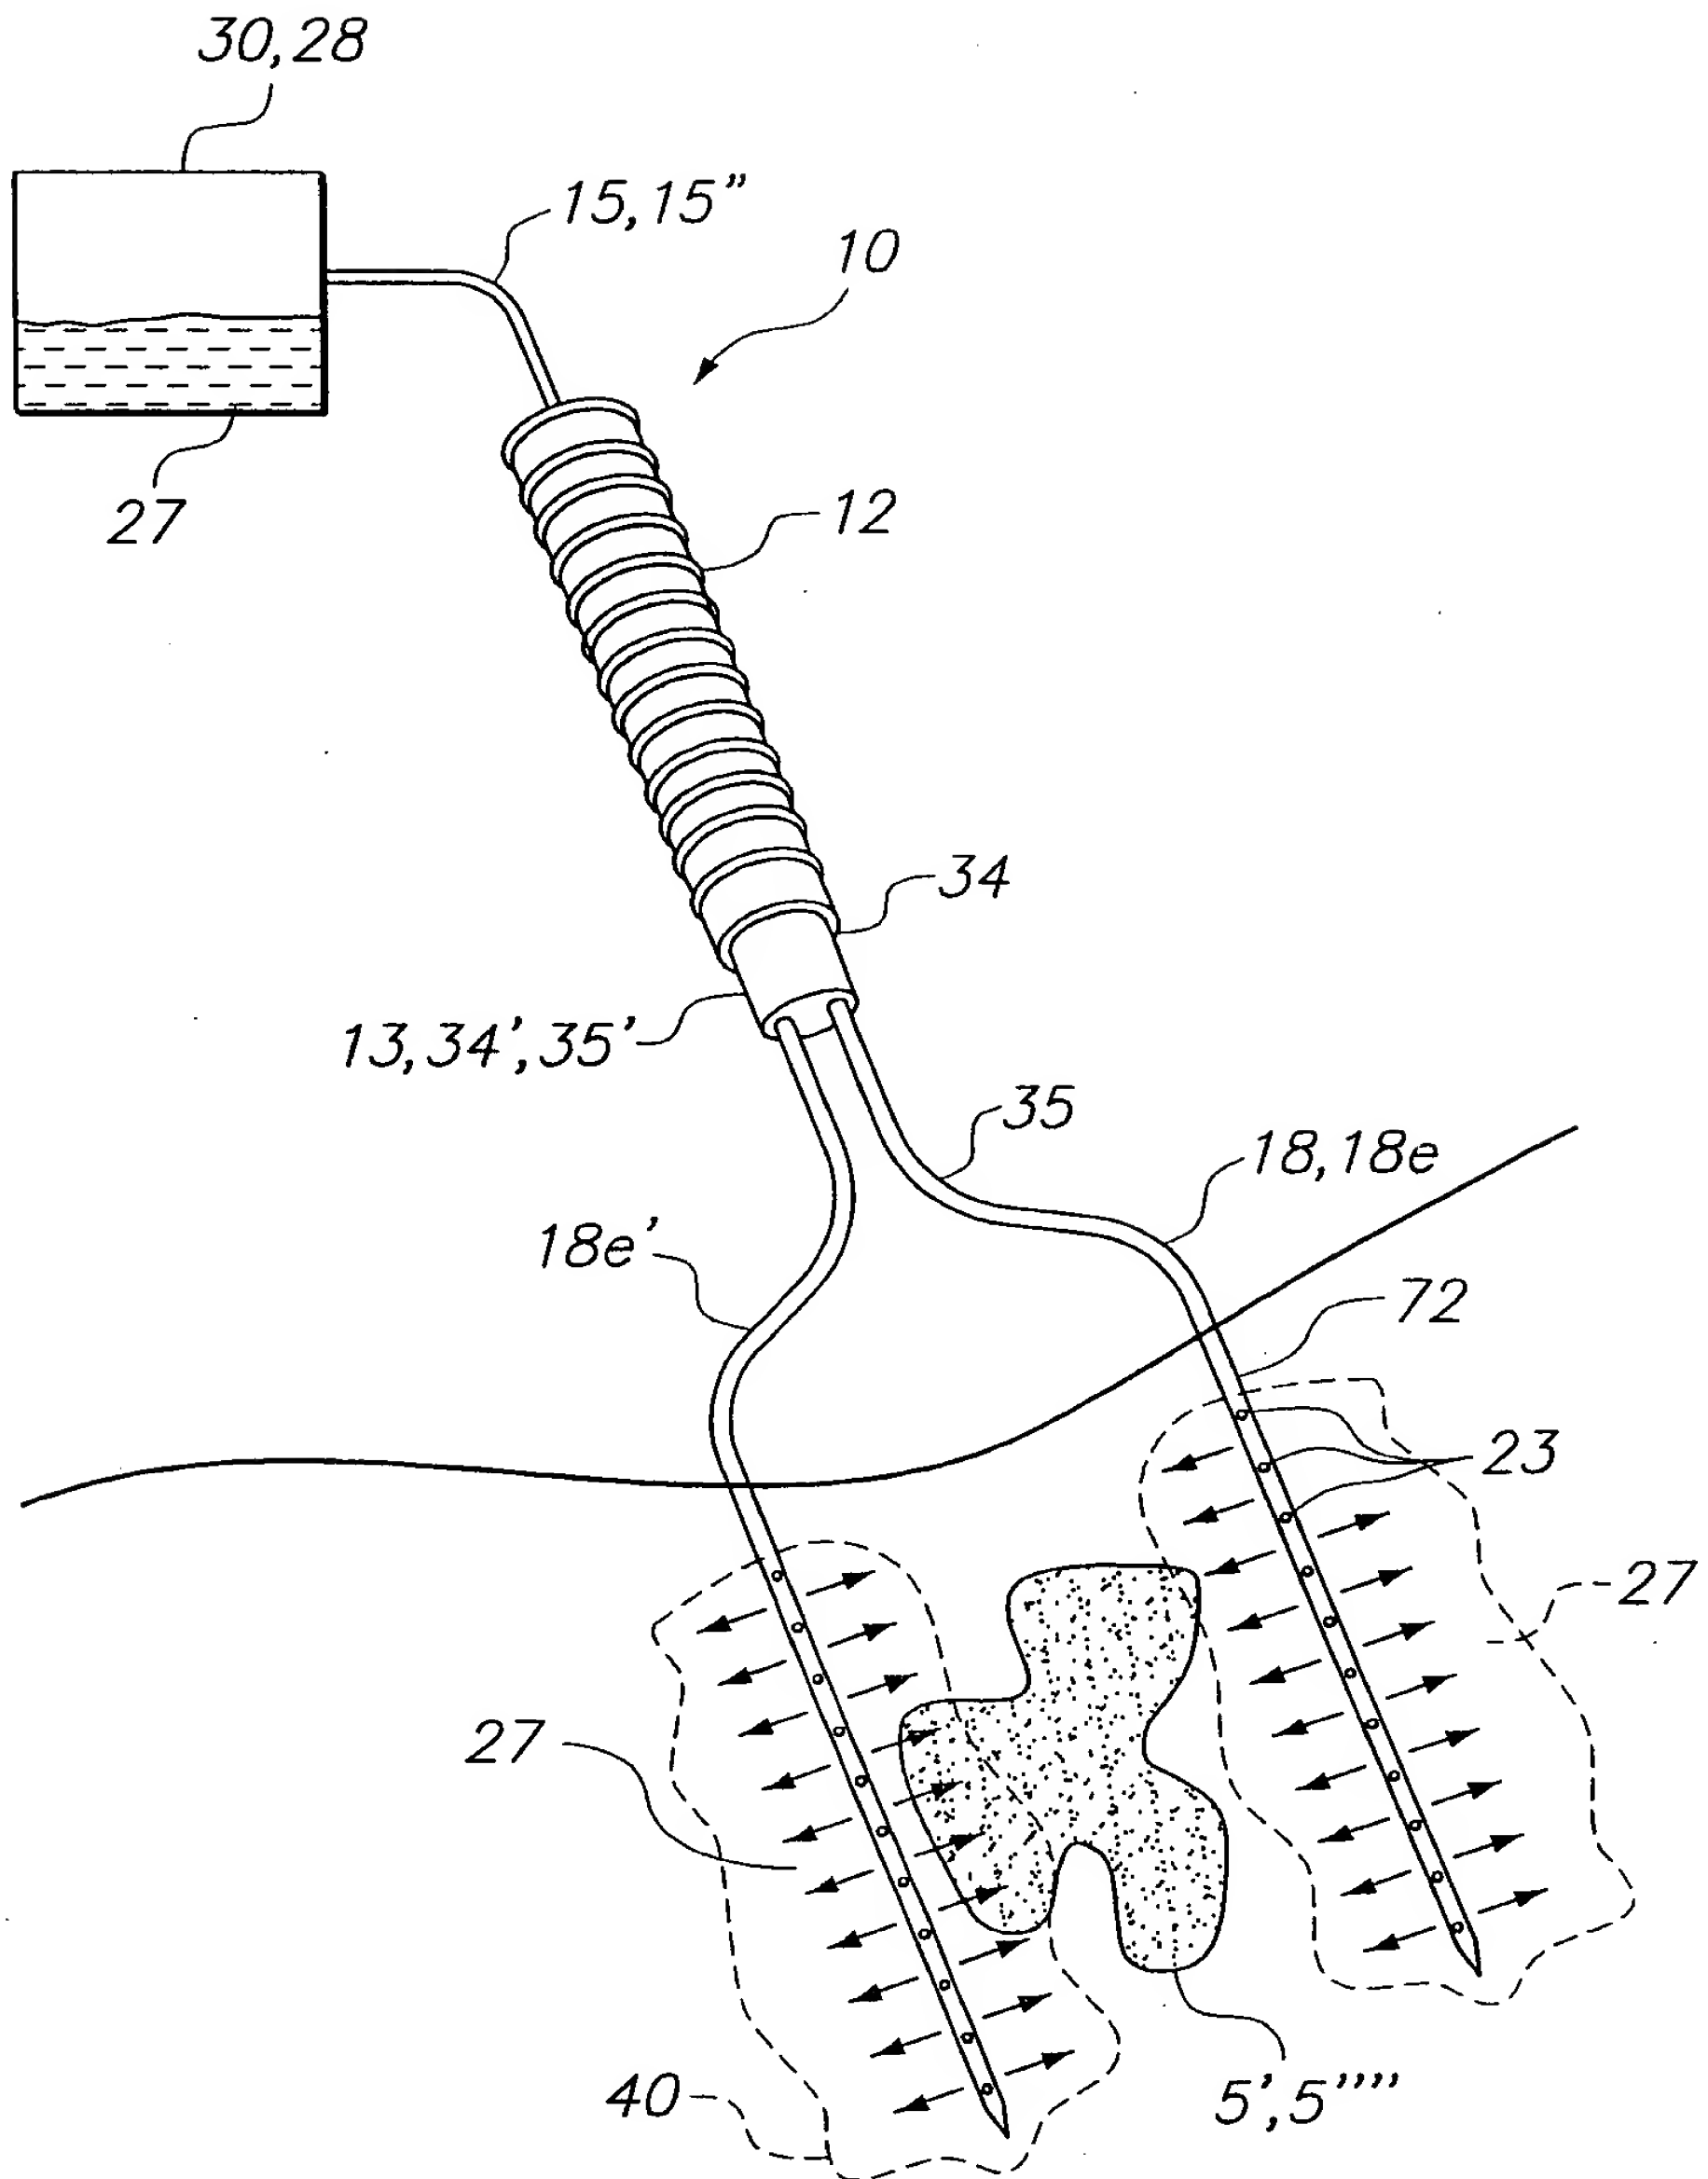


FIG. 29



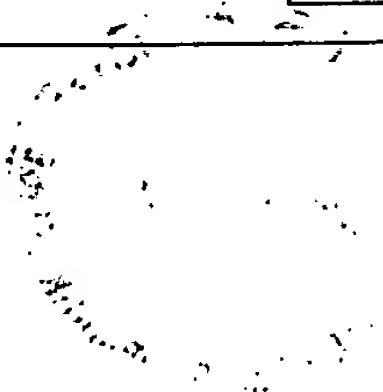


FIG. 30

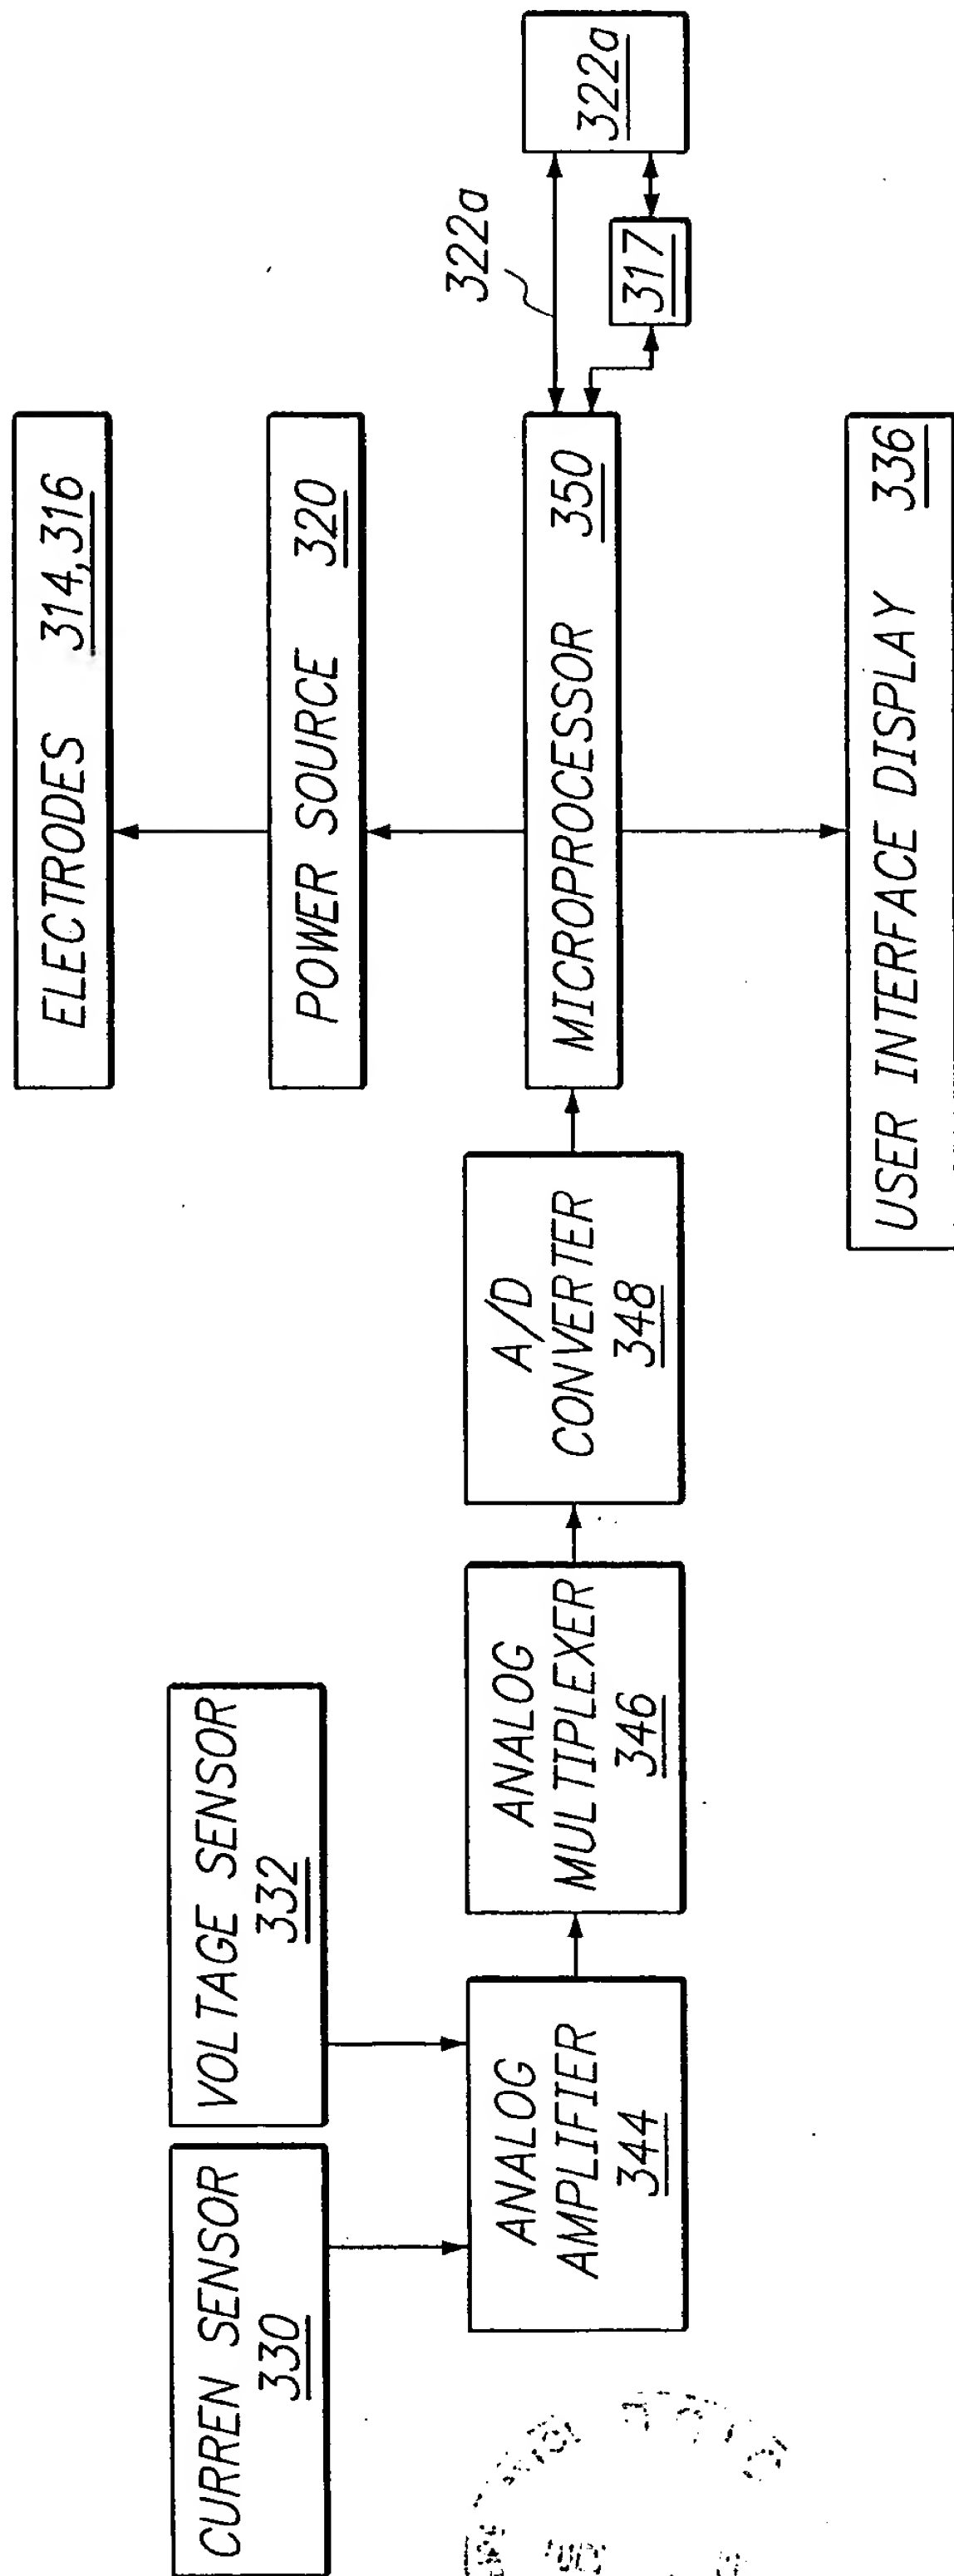


FIG. 31